

Butterfly iQ/ iQ+/ iQ+ Bladder/ iQ3 Osobisty system do bada ultrasonograficznych

Podr cznik u ytkownika



950-20002-PL
Recenzja: BM
2024-07-30

Uwaga

Firma Butterfly Network, Inc. (BNI) nie odpowiada za błędy tu występujące lub za szkody dodatkowe będące wynikiem w związku z organizacją, działaniem lub użyciem tego materiału.

Informacje zastrzeżone

Niniejszy dokument zawiera informacje zastrzeżone, chronione prawem autorskim.

Ograniczona gwarancja

„Ograniczona gwarancja” dostarczana wraz z produktami BNI służy jako jedyna i wyłączna gwarancja dostarczana przez BNI w odniesieniu do produktów tutaj wymienionych.

Prawo autorskie

Prawa autorskie © 2024 Butterfly Network, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

O wiadczenia dotyczące znaków towarowych

Nazwy produktów wymienione w niniejszym podręczniku mogą być znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.

iPad®, iPad Air®, iPad Pro®, iPhone®, iPod® i Lightning® to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.

Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

Nota prawna

Emblemat „Made for iPhone| iPad | iPod” oznacza, że elektroniczne akcesorium zostało opracowane z myślą o podłączeniu tylko do urządzenia iPhone, iPad lub iPod, a jego projektant oświadczył, że spełnia ono normy wydajności Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami. Należy pamiętać, że użycie niniejszego akcesorium z produktem marki Apple może wpływać na działanie bezprzewodowe.

Producent

Butterfly Network, Inc. 1600 District Ave, Burlington, MA 01803 USA

Nr telefonu: +1 (855) 296-6188

Zapytania ogólne: info@butterflynetwork.com

Wsparcie i serwis: support@butterflynetwork.com

Witryna internetowa: www.butterflynetwork.com



Autoryzowani przedstawiciele



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Holandia

CH REP

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Szwajcaria

Emergo Australia
Level 20, Tower II
Darling Park
201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000
Australia

Importerzy



Butterfly Network Netherlands B. V.
Edisonweg 17
4207 HE Gorinchem
Holandia



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Szwajcaria

Patenty w USA

Zestawienie odno nych patentów ameryka skich zgodnie z par. 287 Działu 35. Kodeksu Stanów Zjednoczonych (U.S.C.): www.butterflynetwork.com/patents

Zastrze enie

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia. Niektóre zestawy funkcji mog by niedost pne dla pewnych grup u ytkowników w zale no ci od platformy i ogranicze w lokalnych przepisach. Imiona i nazwiska oraz dane u yte w przykldach s fikcyjne, chyba e podano inaczej.

Aby otrzyma wydrukowany egzemplarz niniejszego podr cznika bez dodatkowych kosztów, skontaktuj si z dziaem wsparcia pod adresem support@butterflynetwork.com. Wy lemy podr cznik w ci gu 7 dni od otrzymania pro by.

Spis treści

1. Wprowadzenie	7
1.1. Omówienie	7
1.2. Przeznaczenie	7
1.3. Ustawienia korzystania	7
1.4. Wskazania do stosowania	8
1.5. Szkolenie	9
1.5.1. Caption AI™	9
2. Informacje o bezpieczeństwie	10
2.1. Oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa	10
2.2. Korzyści i ryzyko związane z ultradźwiękami	10
2.2.1. Korzyści związane z ultrasonografią	10
2.2.2. Ryzyko związane z ultradźwiękami	10
2.3. Bezpieczeństwo Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3	11
2.4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa / środowiska użytkownika	11
2.5. Bezpieczeństwo elektryczne	14
2.6. Bezpieczeństwo związane z defibrylacją	15
2.7. Ochrona sprężutku	16
2.8. Bezpieczeństwo biologiczne	16
2.9. Bezpieczeństwo operatora	17
3. Omówienie systemu	18
3.1. Omówienie	19
3.1.1. Tryby	19
3.1.2. Pomiar	19
3.1.3. Rodzaje głowic	19
3.1.4. Ochrona danych pacjenta	19
3.1.5. Połączenie z Internetem	20
3.2. Elementy systemu	20
3.2.1. Aplikacja Butterfly iQ	22
3.2.2. Głowica	23
3.2.3. Ładowarka akumulatora głowicy	24
3.3. Omówienie interfejsu użytkownika	25
3.4. Presets	25
3.5. Ustawienia wstępne	25
4. Konfiguracja systemu	26
4.1. Pobieranie i instalacja aplikacji	26
4.2. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	26
4.3. Zarządzanie aktualizacjami aplikacji	27
4.4. Ładowanie głowicy	27
4.4.1. Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora głowicy	30
5. Używanie systemu	31
5.1. Przeprowadzanie badania	31
5.2. Przesyłanie badań do Butterfly Cloud	32
5.3. Korzystanie z funkcji przycisku głowicy	32
5.3.1. Korzystanie z funkcji przechwytywania obrazów za pomocą przycisku głowicy	32
5.3.2. Korzystanie z funkcji odblokowania obrazu za pomocą przycisku głowicy	33
6. Korzystanie z trybów	34
6.1. Korzystanie z trybu B	34
6.2. Korzystanie z trybu kolorowego Dopplera lub Dopplera mocy	34
6.3. Używanie trybu M	34
6.4. Korzystanie z trybu Dopplera spektralnego fali pulsacyjnej	35
6.5. Korzystanie z trybu Biplane Imaging™ (wyłączenie Butterfly iQ+/ iQ3)	37
6.6. Korzystanie z funkcji dźwięków bicia serca płodu	39
6.7. Korzystanie z iQ Slice	40
6.8. Korzystanie z trybu iQ Fan	41

7. Adnotacje	42
7.1. Dodawanie adnotacji	42
7.2. Korzystanie z protokołów	43
8. Pakiety obliczeniowe i czynniki	45
8.1. Obliczenia położeń	45
8.2. Różne obliczenia objętości	46
8.3. Obliczanie objętości ośrodka	47
8.4. Obliczanie redukcji rednicy tarczy szyjnej	48
8.5. Różne obliczanie kątów	49
8.6. Materiały referencyjne do pakietów obliczeniowych	50
9. Korzystanie z narzędzia Needle Viz™ (w płaszczyźnie)	52
10. Korzystanie z ustawienia wstępnego Igła: poza płaszczyznę (tylko iQ3)	54
11. Korzystanie z ustawienia wstępnego Przechylenie pod wyrostkiem mieczykowatym (tylko iQ3) ..	56
12. Narzędzia wspomagające AI	57
12.1. Automatyczny licznik linii B Butterfly	57
12.2. Automatyczne oszacowanie frakcji wyrzutowych	66
12.3. Automatyczne oszacowanie objętości pęcherza	68
12.4. Butterfly iQ Wskazówki edukacyjne dotyczące projekcji	72
13. Użytkowanie Butterfly Cloud	75
13.1. Omówienie	75
13.2. Dostęp do Butterfly Cloud	75
13.3. Przeglądanie i zarządzanie badaniami	75
14. Użytkowanie Butterfly TeleGuidance	77
14.1. Omówienie	77
15. Użytkowanie Butterfly iQ+ Care	78
16. Używanie systemu Butterfly iQ+ Bladder	80
16.1. Omówienie	80
16.2. Wskazania do stosowania	80
16.3. Przeciwwskazania	80
16.4. Określanie objętości pęcherza moczowego	81
16.5. Dostępne ustawienia	82
17. Konserwacja	84
17.1. Konserwacja głowicy	84
17.2. Czyszczenie i dezynfekcja głowicy w miejscu użycia	85
17.2.1. Czyszczenie głowicy	86
17.2.2. Dezynfekcja głowicy	86
17.3. Aktualizacja oprogramowania głowicy i aplikacji	90
17.4. Wykonywanie testu diagnostycznego głowicy	90
17.5. Wymiana kabla Butterfly iQ+/ iQ3	91
17.6. Zaplanowana konserwacja	94
17.7. Przewidywany okres eksploatacji urządzenia Butterfly iQ+/ iQ3	94
18. Rozwiązywanie problemów	96
18.1. Rozwiązywanie problemów	96
18.2. Rozwiązywanie problemów z przegrzaniem głowicy	98
18.3. Rozwiązywanie problemów z ładowaniem	99
19. Wsparcie	101
19.1. Kontakt z działem wsparcia firmy Butterfly	101
19.2. Kontakt z działem wsparcia za pośrednictwem aplikacji Butterfly iQ	101
20. Parametry	103
20.1. Wymagania dotyczące urządzenia mobilnego	103
20.2. Parametry systemu	103
20.3. Ładowarka akumulatora głowicy	105
20.4. Rodowiskowe warunki pracy	106
20.5. Zgodność elektromagnetyczna (EMC)	107
20.5.1. Odległość	109
20.6. Wyjściowa moc akustyczna	109
20.6.1. Wartości graniczne wyjściowej mocy akustycznej	113

20.6.2. Tabele z zestawieniem mocy akustycznej	113
20.7. Niezb dna wydajno	147
20.8. Dokładno pomiaru	147
20.9. Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny	147
20.10. Recykling i usuwanie	147
21. Symbole	149
21.1. Symbole	149
22. Uwagi	153

1. Wprowadzenie

Tre niniejszego rozdziału zawiera wprowadzenie do Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 osobistego systemu do badań ultrasonograficznych.

1.1. Omówienie

Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 Osobisty system do badań ultrasonograficznych jest urządzeniem łatwym w użyciu, przenośnym i zasilanym za pomocą akumulatora. Jego komercyjna, gotowa do użytku platforma mobilna (urządzenie mobilne) zapewnia prosty interfejs dla użytkownika.



UWAGA

Głowica Butterfly iQ+ Bladder jest konfiguracją platformy sprężądowej Butterfly iQ+, dlatego dzieli jej specyfikacje mechaniczne i elektryczne.

Niniejszy podręcznik służy jako źródło informacji pomagające wyszkolonym operatorom bezpiecznie i skutecznie obsługiwać oraz prawidłowo konserwować osobisty system Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 do badań ultrasonograficznych wraz z odpowiednimi akcesoriami. Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy zapoznali się z treścią wszelkich instrukcji podanych w tym podręczniku i zrozumieli je przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia i przestrogi występujące w treći podręcznika.



UWAGI

- W zależności od platformy, sprężąd, kraju i rodzaju subskrypcji niektóre ustawienia wstępne oraz funkcje mogą być niedostępne.
- Urządzenie Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 i jego akcesoria mogą być używane wielokrotnie u wielu pacjentów.

1.2. Przeznaczenie



PRZESTROGA!

Prawo federalne (Stanów Zjednoczonych) dopuszcza zakup tego urządzenia wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie.

Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 to uniwersalny diagnostyczny system obrazowania ultrasonograficznego do użytku przez przeszkolonych lekarzy umożliwiający diagnostykę obrazową, pomiary struktur anatomicznych i płynów. W skład systemu wchodzi inne odpowiednie narzędzia.

1.3. Ustawienia korzystania

Przenośny interfejs użytkownika systemu badań ultrasonograficznych Butterfly iQ3 umożliwia integrację z profesjonalnymi placówkami opieki zdrowotnej (np. szpital, klinika, hospicjum lub gabinet lekarski), karetkami pogotowia i/lub miejscami wypadków oraz innymi środowiskami, w których świadczona jest opieka zdrowotna

(np. opieka zdrowotna w domu prowadzona przez przeszkolonych pracowników służby zdrowia). Użytkownikami mogą być również studenci medycyny pracujący pod nadzorem lub z upoważnienia lekarza w trakcie kształcenia/szkolenia.

1.4. Wskazania do stosowania



UWAGA

Niektóre ustawienia wstępne oraz funkcje mogą być niedostępne. Należy wejść na stronę support.butterflynetwork.com, aby uzyskać informacje dotyczące określonego urządzenia i kraju.

Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 jest wskazany do stosowania przez przeszkolonych pracowników służby zdrowia w środowiskach, w których świadczona jest opieka zdrowotna, w celu umożliwienia diagnostycznego obrazowania ultrasonograficznego i pomiaru struktur anatomicznych i płynów u pacjentów dorosłych i dzieci w następujących zastosowaniach klinicznych:

- naczynia obwodowe (w tym badania tętnic szyjnych, zakrzepicy żył głębokich oraz tętnic)
- wskazówki dotyczące zabiegu,
- małe narządy (w tym tarczyca, moszna i piersi)
- Sercowy
- Jama brzuszna
- Płuca
- urologia,
- badania płodu / położnictwo,
- ginekologia,
- układ mięśniowo-szkieletowy (standardowo),
- układ mięśniowo-szkieletowy (powierzchniowo).
- Okulistyczny

Tryby pracy to między innymi:

Tryb	Butterfly iQ	Butterfly iQ+	Butterfly iQ3
Tryb B	✓	✓	✓
Tryb B + tryb M	✓	✓	✓
Tryb B + kolorowy Doppler	✓	✓	✓
Tryb B + Doppler mocy	✓	✓	✓
Doppler spektralny fali pulsacyjnej ^a .	✓	✓	✓
Długość bicia serca płodu ^a .	-	✓	✓
Tryb B + Tryb dwupłaszczyznowy	-	✓	✓
Tryb B + Needle Viz	-	✓	✓
Tryb B + Tryb dwupłaszczyznowy + Needle Viz	-	✓	✓
Tryb B + iQ Slice	-	-	✓
Tryb B + iQ Fan	-	-	✓

^aDostępny w określonych krajach.



OSTRZEŻENIE!

Systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 nie wolno stosować do wskazań innych niż zatwierdzone przez stosowny organ nadzorujący.

1.5. Szkolenie

W celu bezpiecznej i skutecznej obsługi systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 użytkownik musi spełniać następujące wymagania:

- Szkolenie zgodne z wymogami ujętymi w przepisach lokalnych, wojewódzkich i krajowych.
- Szkolenie dodatkowe zgodnie z potrzebami upoważnionego lekarza
- Dogłębna wiedza i pełne zrozumienie materiału przedstawionego w niniejszym podręczniku

1.5.1. Caption AI™



OSTRZEŻENIE

W przypadku używania akcesorium Caption AI™ z systemem do badań ultrasonograficznych Butterfly iQ+ należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać instrukcję obsługi akcesorium Caption AI™.



UWAGA

Caption AI™ jest dostępne tylko w USA i tylko na stronie Butterfly iQ+.



UWAGI

- W zależności od platformy, sprzętu, kraju i rodzaju subskrypcji niektóre ustawienia wstępne oraz funkcje mogą być niedostępne.
- Urządzenie Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 i jego akcesoria mogą być używane wielokrotnie u wielu pacjentów.

Odwiedź [witryn internetow](#) [Caption Health](#), aby uzyskać instrukcje użytkowania i inne ważne informacje na temat urządzenia Caption AI™.

2. Informacje o bezpieczeństwie

Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie posługiwania się Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 oraz obejmuje list ostrzeżeń i przestróg. Niniejszy podręcznik użytkownika jest dostępny z poziomu aplikacji Butterfly iQ oraz witryny internetowej support.butterflynetwork.com.

2.1. Oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Warunki, niebezpieczeństwo lub niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować poważnym urazem lub śmiercią.



PRZESTROGA:

Warunki, zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować drobnym urazem, uszkodzeniem urządzenia lub utratą danych.

Niniejszy podręcznik służy jako pomoc w bezpiecznej i skutecznej obsłudze Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3. Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy zapoznali się z treścią wszelkich instrukcji podanych w tym podręczniku i zrozumieli je przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia i przestrógi występujące w treści podręcznika. Wymienione poniżej oznaczenia stosowane w całym podręczniku w celu podkreślenia zagrożenia związanych z bezpieczeństwem:

2.2. Korzyści i ryzyko związane z ultradźwiękami

Ultradźwięki znajdują szerokie zastosowanie, ponieważ zapewniają wiele korzyści klinicznych i są wydajowo bezpieczne. Obrazowanie USG jest stosowane od ponad dwudziestu lat i nie są znane żadne długotrwałe negatywne skutki powiązane z tą technologią.

2.2.1. Korzyści związane z ultrasonografią

- Różnorodność zastosowań diagnostycznych
- Natychmiastowe wyniki
- Niski koszt
- Mobilność przenoszenia urządzenia
- Rejestr bezpieczeństwa

2.2.2. Ryzyko związane z ultradźwiękami

Fale ultradźwiękowe mogą lekko podwyższyć temperaturę tkanek. Podczas ładowania głowica może się nagrzać, co jest zjawiskiem normalnym. Po zdjęciu głowicy z podkładki do ładowania przed całkowitym naładowaniem lub bezpośrednio po jego zakończeniu zaleca się, aby przed użyciem głowicy poczekać na jej ostygnięcie. Ponieważ system ogranicza temperaturę podczas kontaktu głowicy z ciałem pacjenta i nie będzie skanować w temperaturze wynoszącej 43°C (109°F) lub więcej, ostygnięcie głowicy przed użyciem zoptymalizuje czas samego skanowania.

Każde poważne zdarzenie związane z urządzeniem należy zgłosić producentowi na stronie <http://support.butterflynetwork.com> (oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego UE, w którym doszło do zdarzenia, jeżeli ma to zastosowanie).

2.3. Bezpieczeństwo Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3



OSTRZEŻENIA!

- System Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 jest przeznaczony do obsługi przez kompetentnych użytkowników, którzy potrafią prawidłowo interpretować obraz i stawiać diagnozy, a także znać kliniczne zastosowanie systemu.
- Ruchy pacjenta podczas skanowania mogą wpływać na wyniki. Użytkownik powinien dokonać oceny klinicznej przy interpretacji wyników.
- Nie używaj systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 przed przeczytaniem i pełnym zrozumieniem treści niniejszego podręcznika. Nie używaj systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 do celów niezgodnych z przeznaczeniem opisanym w niniejszym podręczniku.
- Nie obsługuj Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 w niewłaściwy sposób. W przeciwnym razie może dojść do poważnego urazu lub śmierci.

2.4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa / środowisko użytkownika



OSTRZEŻENIE!

Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 sklasyfikowano jako MR UNSafe i może stwarzać niedopuszczalne ryzyko dla pacjenta, personelu medycznego lub innych osób znajdujących się w środowisku rezonansu magnetycznego.





OSTRZEŻENIA!

- Używaj wyłącznie przewodów, głowic, ładowarek i akcesoriów określonych do użytku z systemem Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3. Zastąpienie ich akcesoriami niezatwierdzonymi może prowadzić do wadliwego działania systemu lub urazów pacjenta bądź operatora.
- Jeśli głowica wydaje się nietypowo gorąca, wydziela zapach, wydostaje się z niej dym bądź następuje z niej wyciek, należy natychmiast przerwać korzystanie z niej. Należy odłączyć głowicę od urządzenia mobilnego lub od ładowarki (jeśli dotyczy). Należy skontaktować się z działem pomocy technicznej: support.butterflynetwork.com.
- Każde poważne zdarzenie związane z urządzeniem należy zgłosić producentowi na stronie <http://support.butterflynetwork.com> (oraz, w stosownych przypadkach, właściwemu organowi państwa członkowskiego UE, w którym doszło do zdarzenia): <https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/eu-partners/eu-member-states/national-competent-authorities-human>
- Nie używaj Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 w obecności łatwopalnych gazów lub rodków znieczulających. Może to prowadzić do pożaru lub wybuchu.
- System Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 został oceniony lub zatwierdzony do użytku w lokalizacjach niebezpiecznych, zgodnie z definicją ujętą w Krajowym Kodeksie Elektrycznym (NEC). Zgodnie z klasyfikacją IEC system Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 nie jest przeznaczony do stosowania w obecności palnych substancji lub ich mieszanin z powietrzem.
- Nie używaj aplikacji Butterfly iQ w urządzeniu mobilnym, które nie spełnia minimalnych wymagań. Korzystanie z aplikacji Butterfly iQ w urządzeniu mobilnym niespełniającym minimalnych wymagań może negatywnie wpływać na działanie systemu i jako obrazu, a co za tym idzie, przyczyni się do postawienia błędnego rozpoznania.
- Przedostanie się cieczy do wnętrza systemu może go uszkodzić lub grozić poważnym porażeniem prądem elektrycznym. Nie należy dopuścić do przedostania się płynów do urządzenia lub systemu ładowania.
- Przechowywanie systemu powinno odbywać się w zakresie warunków środowiskowych określonych w parametrach technicznych.
- Występują niebezpiecznie wysokie napięcia i prądy. System nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Nie otwiera, nie zdejmowa osłoni i nie podejmowa prób naprawy systemu.
- Przenośny i mobilny sprzęt dołączony do wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF) może wpływać na medyczne urządzenia elektryczne.
- Aby zapoznać się z podręcznikiem użytkownika oraz uzyskać dostęp do portalu wsparcia Butterfly, konieczny jest dostęp do Internetu. W przypadku korzystania z systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 bez połączenia z Internetem, należy pobrać podręcznik użytkownika lokalnie za pośrednictwem support.butterflynetwork.com.
- Używanie uszkodzonego sprzętu lub akcesoriów może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i/lub prowadzić do urazu pacjenta lub operatora. Wszelkie czynności serwisowe zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
- Wszelkie modyfikacje są niedozwolone. Nie modyfikować przewodów, głowic, ładowarek ani akcesoriów określonych do użytku z systemem Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3. Modyfikacje sprzętu mogą powodować wadliwe działanie systemu lub uraz pacjenta bądź operatora.
- W przypadku stosowania głowicy w środowisku domowym, należy ją przechowywać z dala od dzieci, zwierząt domowych lub szkodników w celu zapobiegania jej uszkodzenia.
- W przypadku stosowania głowicy w warunkach domowych, w celu uniknięcia ryzyka przypadkowego uduszenia niezbędne jest dopilnowanie, aby przewód był odpowiednio owinięty wokół głowicy, gdy urządzenie nie jest używane.



PRZESTROGI!

- Zaobserwowano zaburzenia rytmu serca podczas badań kardiologicznych z użyciem gazowych rodków kontrastowych USG w zakresie diagnostycznym wartości wskaźnika mechanicznego (MI). Szczegółowe informacje zawiera ulotka dołączona do opakowania stosowanego rodku kontrastowego.
- Butterfly Cloud umożliwia zdalne wyświetlanie obrazów USG na różnych platformach oraz w środowiskach niekontrolowanych (np. oświetlenie otoczenia). Decyzja o właściwym użyciu obrazów należy do lekarza.
- W przypadku wprowadzania igły urządzeniem mogą posługiwać się wyłącznie wyszkoleni operatorzy.
- Należy zachować szczególne środki ostrożności podczas używania głowicy u dzieci lub innych pacjentów, u których występują choroby przewlekłe lub wrażliwość na temperaturę.



UWAGI

Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 zaprojektowano tak, aby zapewnić, że limity akustyczne nie zostaną przekroczone w żadnym trybie obrazowania. Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 zaprojektowano i certyfikowano pod kątem zgodności z:

- IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 CSV Medyczne urządzenia elektryczne – cz. 1: wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego.
- IEC 60601-2-37:2007 Medyczne urządzenia elektryczne – cz. 2-37: wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń diagnostycznych i monitorujących.

2.5. Bezpieczeństwo elektryczne



OSTRZEŻENIA!

- Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić głowicę. Należy także dorazowo sprawdzać głowicę przed i po czyszczeniu, dezynfekcji i użyciu. Należy sprawdzić powierzchnię soczewki, przewód, obudowę, spójnienia i złuszczenia pod kątem oznak uszkodzenia, takich jak pęknięcia, złuszczenia, zarysowania i nieuszczelnienia. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy odstąpić od używania głowicy w razie wykrycia jakichkolwiek oznak wiadczących o uszkodzeniu. W przypadku głowicy Butterfly iQ+/ iQ3, należy sprawdzić, czy kabel jest całkowicie zamontowany.
- Upuszczenie głowicy może skutkować uszkodzeniem. Każdorazowo sprawdzać głowicę przed i po czyszczeniu, dezynfekcji i użyciu. Sprawdzić powierzchnię soczewki, przewód, obudowę, spójnienia i złuszczenia pod kątem oznak uszkodzenia, takich jak pęknięcia, złuszczenia, zarysowania i nieuszczelnienia. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie używać głowicy w razie wykrycia jakiegokolwiek objawu wiadczącego o uszkodzeniu.
- Stosuj dodatkowe sprzęty wraz z urządzeniem USG zapewni zgodnie z normą IEC 60601-1.
- Używanie akcesoriów, głowic i przewodów innych niż określone lub dostarczone przez producenta niniejszego sprzętu może skutkować zwiąszszonymi emisjami elektromagnetycznymi lub obniżeniem odporności elektromagnetycznej tego sprzętu, jak również prowadzić do jego wadliwego działania.
- Unikaj korzystania z tego urządzenia w charakterze uzupełnienia innego sprzętu lub w połączeniu z nim, ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowego działania. Jeżeli takie użycie jest nieodzwonane, niniejsze urządzenie i inny sprzęt obserwować, aby sprawdzić, czy działają normalnie.
- Jeżeli warto ci napięcia, określone normą IEC 60601-1 i odnoszące się do części wchodzących w kontakt z ciałem pacjenta, zostaną przekroczone, może dojść do porażenia pacjenta lub operatora prądem elektrycznym.
- Głowica została zaprojektowana jako urządzenie całkowicie szczelne. Nie podejmować prób otwarcia głowicy ani manipulowania częściami wewnętrznymi urządzenia, w tym akumulatorem. W przeciwnym razie może dojść do urazu pacjenta lub operatora.
- Użytkownikowi nie wolno zdejmować kabla stanowiącego wyposażenie Butterfly iQ. Użytkownik może zdejmować kabel stanowiący wyposażenie Butterfly iQ+/ iQ3 po uprzednim sprawdzeniu, czy kabel jest w pełni zamontowany, aby zapewnić ochronę głowicy przed wpływem czynników środowiska zewnętrznego.
- Nie zanurzać głowicy Butterfly iQ/ iQ+ powyżej określonego poziomu. Zanurzenie powyżej określonego poziomu może skutkować porażeniem prądem elektrycznym.
- Butterfly iQ3 jest urządzeniem o stopniu ochrony IPX7, co oznacza, że jest wodoodporne i może być w pełni zanurzone w wodzie o głębokości 1 metra przez maksymalnie 30 minut; po tym czasie nadal będzie w stanie działać.



OSTRZEŻENIA!

- Przenośny sprzęt dołączony do sieci radiowej (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak przewody antenowe i anteny zewnętrzne) powinien być używany w odległości co najmniej 30 cm od dowolnej części systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3, w tym przewodów określonych przez producenta. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia jakości działania tego urządzenia.

**PRZESTROGI!**

- Powiadomienia i alerty generowane przez aplikacje innych producentów działających w urządzeniu mobilnym mogą zakłócać badanie.

Oznaczenie klasy	Butterfly iQ	Butterfly iQ+	Butterfly iQ3	Uwagi
CISPR 11 Group 1 Class A	✓	✓	✓	Charakterystyka sprężarki tej klasy pozwala na użycie go w środowisku przemysłowym i szpitalnym. Jeśli sprężarka ta jest używana w środowisku mieszkalnym (dla którego zwykle wymaga się klasy B CISPR 11), może nie zapewnić adekwatnej ochrony w odniesieniu do usług łączności opartych na częstotliwościach radiowych. Może zachodzić konieczność podjęcia działań łagodzących skutki braku adekwatnej ochrony, takich jak przeniesienie lub zmiana ustawienia sprężarki.
CISPR 11 Group 1 Class B	-	✓	✓	Charakterystyka sprężarki tej klasy pozwala na użycie go w środowisku mieszkalnym. Jeśli urządzenie nie posiada tego oznaczenia, może ono nie zapewnić adekwatnej ochrony w odniesieniu do usług łączności opartych na częstotliwościach radiowych. Może zachodzić konieczność podjęcia działań łagodzących skutki braku adekwatnej ochrony, takich jak przeniesienie lub zmiana ustawienia sprężarki.

- Nie należy używać głowicy z kablem, który jest w widoczny sposób uszkodzony. Uszkodzenia obejmują między innymi pęknięcia izolacji kabla, odsłonięte przewody, postrzępioną izolację lub inne widoczne objawy zużycia.
- Korzystanie z urządzenia z widocznym uszkodzeniem kabla może skutkować obrażeniami ciała użytkownika lub pacjenta.

2.6. Bezpieczeństwo związane z defibrylacją**OSTRZEŻENIA!**

- Przed zastosowaniem u pacjenta impulsu defibrylacyjnego wysokiego napięcia usunąć z ciała pacjenta wszystkie urządzenia wchodzące z nim w kontakt, które nie są określone jako odporne na defibrylację.
- Osłony głowicy nie zapewniają ochrony przed defibrylacją.

2.7. Ochrona sprz tu



PRZESTROGI!

- Nie zgina ani nie skrca nadmiernie przewodu głowicy. Każdorazowo sprawdza głowicę przed i po czyszczeniu, dezynfekcji i uyciu. Sprawdza powierzchnię soczewki, przewód, obudowę, spójność i złaczenia pod kątem oznak uszkodzenia, takich jak pęknięcia, złuszczenia, zarysowania i nieszczelności. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie używa głowicy w razie wykrycia jakiegokolwiek objawu świadczącego o uszkodzeniu. Nie zanurza głowicy w wodzie ani innych cieczach powyżej określonego poziomu.
- Aby uniknąć możliwości kondensacji wewnątrz urządzenia i ewentualnego uszkodzenia sprzętu, nie przechowywa urządzenia w warunkach wykraczających poza określone środowiskowe warunki pracy.
- Nieprawidłowa konserwacja może spowodować, że Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 przestanie działać. Sprzęt konserwować wyłącznie w sposób opisany w części dotyczącej konserwacji.
- Nie poddawa sterylizacji (w tym sterylizacji w autoklawie) systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 ani jego akcesoriów.

2.8. Bezpieczeństwo biologiczne



OSTRZEŻENIA!

- Wykonując badanie USG, należy każdorazowo kierować się zasadą ALARA (tak nisko, jak jest to realnie możliwe). Dodatkowe informacje na temat zasady ALARA można znaleźć w sekcji „Medical Ultrasound Safety” (Bezpieczeństwo medycznych badań ultradźwiękowych) [Wyjściowa moc akustyczna \[109\]](#).
- Nie istnieje adekwatna procedura dezynfekcji w przypadku skażenia systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 po ekspozycji na priony wywołujące choroby Creutzfeldta i Jakoba.
- Używanie prawidłowych ustawień wstępnych, właściwych dla danego zastosowania klinicznego, do badania powięzanej części ciała. Niektóre zastosowania wymagają niższych limitów mocy akustycznej.
- Głowica nie zawiera elementów wykonanych z lateksu. Jednak niektóre koszulki głowicy mogą zawierać lateks naturalny wywołujący u niektórych osób reakcje alergiczne.
- W przypadku wykonywania procedur, które wymagają osłon przetwornika, postępuwać zgodnie z protokołem obowiązującym w placówce medycznej i/lub instrukcją dostarczoną wraz z osłonami.
- Niniejszy produkt może być przyczyną narażenia operatora na chemikalia, w tym sadzonki, która w stanie Kalifornia uważana jest za rakotwórczą. Aby uzyskać więcej informacji, należy wejść na stronę: www.P65Warnings.ca.gov.
- Agencja Leków i Preparatów (FDA) ustaliła niższe wartości graniczne mocy akustycznej do zastosowań okulistycznych. Podczas wykonywania badania okulistycznego należy stosować wyłącznie ustawienia wstępne przeznaczone do badania okulistycznego, aby uniknąć obrażenia ciała pacjenta.



PRZESTROGA!

Unika kontaktu z błonami łożowymi (np. oko, nos, usta) i nienaruszonymi obszarami skóry, gdzie doszło do przerwania ciągłości skóry poprzez skaleczenia, otarcia, stan zapalny, pęknięcia itp., chyba że głowica została zdezynfekowana i zabezpieczona sterylnie, legalnie wprowadzona do obrotu osłon głowicy zgodnie z protokołem obowiązującym w danej instytucji i/lub instrukcjami stosowania takich osłon.

2.9. Bezpieczeństwo operatora



OSTRZEŻENIA!

- Używanie uszkodzonego sprzętu lub akcesoriów może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i/lub prowadzić do urazu pacjenta lub operatora.
- Nie używaj, nie podłączaj ani nie obsługuj systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 za pomocą niezatwierdzonych lub nieokreślonych urządzeń lub akcesoriów. W przeciwnym razie może dojść do urazu pacjenta lub operatora.
- Nie używaj aplikacji Butterfly iQ w urządzeniu mobilnym, które nie spełnia minimalnych wymagań. Korzystanie z aplikacji Butterfly iQ w urządzeniu mobilnym niespełniającym minimalnych wymagań może negatywnie wpływać na działanie systemu i jako obrazu, a co za tym idzie, przyczyni się do postawienia błędnego rozpoznania.



PRZESTROGI!

- Aby do minimum ograniczyć ryzyko wystąpienia zespołu cieśni nadgarstka (CTS) i powiązanych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, należy utrzymywać odpowiedni postaw ciała, robić częste przerwy i unikać chwytania lub trzymania głowicy z nadmierną siłą.
- Podczas obsługi, czyszczenia i dezynfekcji urządzenia postępuj zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej placówce medycznej, a dotyczącymi środków ochrony indywidualnej (PPE) i kontroli zakażeń.

3. Omówienie systemu


Niniejszy rozdział zawiera opis systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3. Obejmuje informacje na temat jego funkcji, elementów wchodzących w skład systemu, wymagań niezbędnych do pobrania, instalacji i użycia aplikacji Butterfly iQ, a ponadto zawiera omówienie interfejsu użytkownika.



UWAGI

- W zależności od platformy, sprzętu, kraju i rodzaju subskrypcji niektóre ustawienia wstępne oraz funkcje mogą być niedostępne.
- Urządzenie Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 i jego akcesoria mogą być używane wielokrotnie u wielu pacjentów.

Rysunek 1. Omówienie systemu

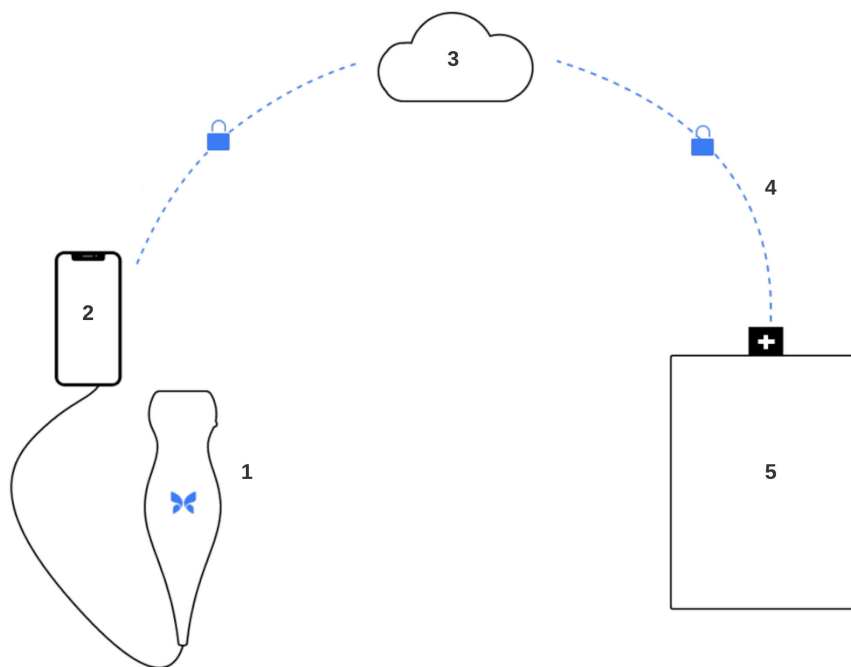

1. Głowica Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3.
2. Aplikacja Butterfly iQ.
3. Butterfly Cloud.
4. Łącze szpitalne Butterfly Cloud.
5. HL7, DICOM, PACS.

3.1. Omówienie

Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 jest r cznym urz dzeniem do diagnostyki ultrasonograficznej ogólnego zastosowania. System składa si z trzech elementów:

- Kompatybilne osobiste urz dzenia elektroniczne Apple® lub Android, w tym telefony i tablety (urz dzenie mobilne)
- aplikacji Butterfly iQ pobranej i zainstalowanej na kompatybilnym urz dzeniu mobilnym,
- głowicy systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 podł czanej do urz dzenia mobilnego w celu generowania i odbierania sygnałów ultrad wi kowych.



UWAGA

Urz dzenie mobilne nie jest doł czzone do systemu ultrad wi kowego Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3; nale y je naby oddzielnie.

3.1.1. Tryby

Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 zapewnia dost p do nast puj cych trybów:

Tryb	Butterfly iQ	Butterfly iQ+	Butterfly iQ3
Tryb B	✓	✓	✓
Tryb B + tryb M	✓	✓	✓
Tryb B + kolorowy Doppler	✓	✓	✓
Tryb B + Doppler mocy	✓	✓	✓
Doppler spektralny fali pulsacyjnej ^a .	✓	✓	✓ ^b .
D wi ki bicia serca płodu ^a .	-	✓	✓
Tryb B + Tryb dwupłaszczyznowy	-	✓	✓
Tryb B + Needle Viz	-	✓	✓
Tryb B + Tryb dwupłaszczyznowy + Needle Viz	-	✓	✓
Tryb B + iQ Slice	-	-	✓
Tryb B + iQ Fan	-	-	✓

^aDost pny w okre lonych krajach.

^bDoppler spektralny fali pulsacyjnej + D wi k dost pny w Butterfly iQ3

3.1.2. Pomiary

Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 umo liwia wykonanie pomiarów klinicznych w ka dym dost pnym trybie. Dost pne pomiary to mi dzy innymi pomiary odległ o ci, czasu, obszaru oraz t tna.

3.1.3. Rodzaje głowic:

System Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 zapewnia pojedyncz głowic , z której mo na korzystać w przypadku wszystkich wskazanych zastosowa klinicznych.

3.1.4. Ochrona danych pacjenta



PRZESTROGA!

Wymagana jest ochrona danych pacjenta poprzez zabezpieczenie urz dzenia mobilnego hasłem lub kodem dost pu. Nie mo na korzystać z aplikacji Butterfly iQ, je li urz dzenie mobilne nie ma wł czonego i skonfigurowanego hasła. Skonsultuj si z działem IT/bezpiecze stwa, aby upewni si , czy zapewniane bezpiecze stwo oraz ochrona danych pacjentów s zgodne z polityk obowi zuj c w placówce.

Firma Butterfly zaleca ustawienie okresu autoblokady w ustawieniach urządzenia mobilnego w celu zapobieżenia nieupoważnionemu dostępowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawienia autoblokady, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.

Jeśli podejrzewasz, że doszło do próby phishingu lub innych zagrożeń cyberbezpieczeństwa, lub jeśli masz jakiegokolwiek obawę dotyczącą bezpieczeństwa i integralności urządzenia, skontaktuj się z działem IT lub zespołem ds. bezpieczeństwa w organizacji. Problemy związane z bezpieczeństwem produktu Butterfly można zgłaszać naszemu zespołowi wsparcia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie [Wsparcie \[101\]](#). Problemy bezpieczeństwa związane z głowicami i aplikacją Butterfly, a także wskazówki dotyczące ich usuwania, będą przekazywane pocztą e-mail użytkownikom mającym aktywne konto, a także publikowane w portalu wsparcia Butterfly pod adresem support.butterflynetwork.com.

3.1.5. Połączenie z Internetem

W celu pobrania, instalacji lub aktualizacji aplikacji Butterfly iQ ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store potrzebne jest połączenie z Internetem. Ponadto połączenie z Internetem jest wymagane do logowania się i archiwizacji danych w Butterfly Cloud. W innych sytuacjach używanie urządzenia mobilnego nie wymaga połączenia z Internetem ani łącznie z bezprzewodowej.

Aby mieć pewność, że aplikacja zawiera najnowsze aktualizacje i informacje dotyczące bezpieczeństwa, aplikacja wymaga połączenia z Internetem co 30 dni. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wymagań i ustawień łącznie z Internetem, należy odwiedzić stronę support.butterflynetwork.com.

Szyfrowanie za pomocą protokołu Transport Layer Security (TLS) umożliwia zabezpieczanie danych przesyłanych z aplikacji mobilnej.

3.2. Elementy systemu



OSTRZEŻENIE!

Po otrzymaniu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 dokładnie sprawdź sondę. Każdorazowo sprawdza głowicę przed i po czyszczeniu, dezynfekcji i użyciu. Sprawdź powierzchnię soczewki, przewód, obudowę, spoiny i złaczenia pod kątem oznak uszkodzenia, takich jak pęknięcia, złuszczenia, zarysowania i nieszczelności. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie używaj głowicy w razie wykrycia jakiegokolwiek objawu wiadczenia o uszkodzeniu.

W skład systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 wchodzi głowica i ładowarka głowicy. Przed rozpoczęciem pracy z systemem zidentyfikuj każdy element i upewnij się, że zawartość opakowania jest kompletna.

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie elementów systemu znajdujących się w opakowaniu:

Tabela 1. Podsumowanie komponentów systemu – wewnątrz opakowania

	Butterfly iQ	Butterfly iQ+	Butterfly iQ3
	Głowica (1)	Głowica (1)	Głowica (1)
Komponent (ilość)	System ładowania (1)	System ładowania (1)	System ładowania (1)
	-	-	Kabel akcesoriów sondy (2)

Kompatybilność ładowarki Butterfly iQ3 została podsumowana na stronie [Tabela 2, „kompatybilność z ładowarką Butterfly iQ3.” \[21\]](#).

Tabela 2. kompatybilno z ładowark Butterfly iQ3.

Ładowarka akcesoryjna	Numer modelu	Numer SKU opakowania
Zestaw ładowarki Butterfly iQ3 (typ A)	815-20054-00 - Kabel ładowarki	900-20030-00
	815-20023-00 - adapter (Typ I)	900-20030-01
	815-20058-00 - Adapter zasilania	
Zestaw ładowarki Butterfly iQ3 (typ C)	815-20054-00 - Kabel ładowarki	900-20031-00
	815-20019-00 - adapter (Typ C)	900-20031-01
	815-20058-00 - Adapter zasilania	
Zestaw ładowarki Butterfly iQ3 (typ I)	815-20054-00 - Kabel ładowarki	900-20032-00
	815-20022-00 - adapter (Typ I)	900-20032-01
	815-20058-00 - Adapter zasilania	
Zestaw ładowarki Butterfly iQ3 (typ G)	815-20054-00 - Kabel ładowarki	900-20033-00
	815-20021-00 - Adapter (typ G)	900-20033-01
	815-20058-00 - Adapter zasilania	

**UWAGA**

Urządzenie mobilne nie jest dołączone do systemu ultradźwiękowego Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3; należy je nabyć oddzielnie.

3.2.1. Aplikacja Butterfly iQ

Główną funkcją aplikacji Butterfly iQ jest diagnostyka obrazowa ogólnego zastosowania. Aplikacja jest przeznaczona dla wykwalifikowanych i przeszkolonych lekarzy i umożliwia wizualizację i pomiar struktur anatomicznych organizmu ludzkiego.

Aplikację można bezpłatnie pobrać ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store. Aplikacja i konto Butterfly służy do stosowania osobistego systemu ultradźwiękowego Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3.



UWAGA

- Jeśli urządzenie mobilne nie spełnia wymagań koniecznych do pobrania, instalacji lub uruchomienia aplikacji Butterfly iQ, urządzenie mobilne wyświetli stosowne powiadomienie. Aby uzyskać najnowszy list kompatybilnych urządzeń, odwiedź stronę support.butterflynetwork.com.
- Bezpieczeństwo danych: Postępuj zgodnie z wszelkimi politykami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa cybernetycznego obowiązującymi w placówce. Jeśli treść tych przepisów jest nieznana, skontaktuj się z działem technologii informacyjnych (IT). Aby używać aplikacji Butterfly iQ, konieczne jest ustawienie hasła, kodu dostępu lub innego zabezpieczenia w celu blokowania ekranu urządzenia mobilnego. Jeśli czynność ta nie została wcześniej wykonana lub nie wiadomo, jak ją wykonać, zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa dotyczącymi urządzenia mobilnego.



PRZESTROGA!

Aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność danych, aplikacja mobilna Butterfly iQ powinna być uruchamiana wyłącznie na urządzeniach, które nie zostały poddane operacji odblokowania systemu operacyjnego (tzw. jailbreak lub dostęp do konta root). Aplikacja mobilna Butterfly iQ sprawdza oprogramowanie, aby upewnić się, że urządzenie nie zostało poddane operacji jailbreak lub dostępu do konta root.



UWAGA

- Wersje listy składowej oprogramowania (SBOM) do odczytu maszynowego (SPDX) można uzyskać, kontaktując się z naszym zespołem wsparcia technicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie [Wsparcie \[101\]](#).
- Rejestrowane są szczegóły sprzętowe głowicy, takie jak jej identyfikator, warunki pracy (np. temperatura itp.). Wszystkie czynności wykonywane przez użytkownika w aplikacji Butterfly są rejestrowane z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz daty/godziny wykonania czynności. Rejestrowane działania obejmują logowanie, nieudane próby logowania, a także tworzenie/przeładowanie/modyfikowanie/usuwanie obrazów i badań.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby przywrócić je do ustawień fabrycznych lub skontaktuj się z organizacją, aby uzyskać instrukcje prawidłowego resetowania urządzenia mobilnego zarządzanego za pomocą aplikacji MDM.

3.2.2. Głowica




OSTRZEŻENIE!


Nie podłączaj głowic innych producentów do urządzenia mobilnego Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 i nie podejmuj prób użycia głowicy Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 z innymi systemami ultradźwiękowymi.

Głowica Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 jest przeznaczona wyłącznie do użytku z aplikacją Butterfly iQ. Nie wolno podejmować prób podłączenia głowicy do innych systemów ultrasonograficznych. [Poniższy rysunek \[23\]](#) przedstawia elementy głowicy i opisuje jej części.

Butterfly iQ/ iQ+

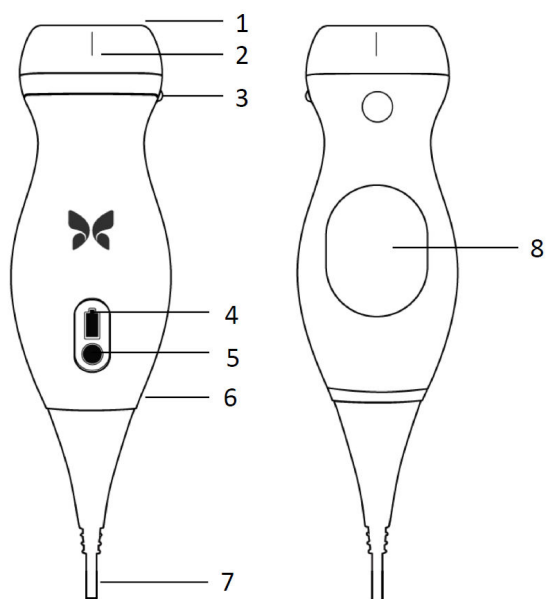

Butterfly iQ3

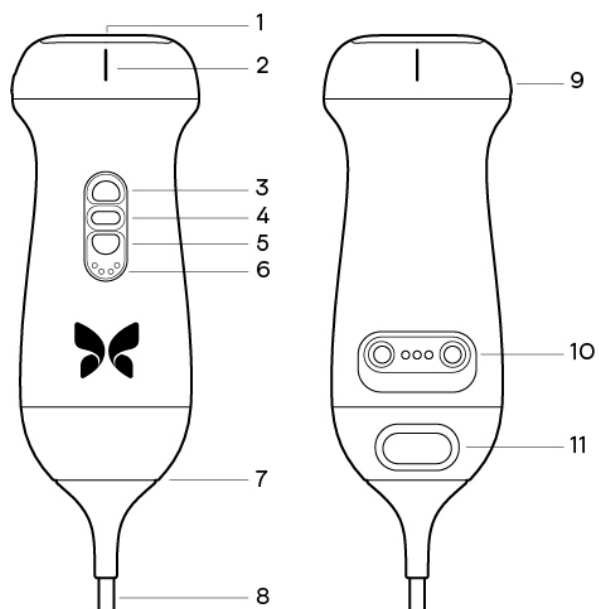

Elementy głowicy.

Tabela 3. Elementy głowicy

Butterfly iQ/ iQ+	Butterfly iQ3
1. Soczewka	1. Soczewka
2. Znacznik linii rodkowej	2. Znacznik linii rodkowej
3. Znacznik orientacji	3. Przycisk (w górę)
4. Kontrolki poziomu naładowania akumulatora	4. Przycisk rodkowy
5. Przycisk wskaźnika akumulatora	5. Przycisk (w dół)
6. Granica głowicy/przewodu	6. Kontrolki poziomu naładowania akumulatora
7. Przewód urządzenia mobilnego	7. Granica głowicy/przewodu
8. Różdło ładowania	8. Przewód urządzenia mobilnego
	9. Znacznik orientacji
	10. Różdło ładowania
	11. Zatrząsk demontażu kabla

**UWAGA**


Butterfly iQ3 zawiera pasywny chip RFID przeznaczony wyłącznie do serwisowania i zarządzania flotą.

3.2.3. Ładowarka akumulatora głowicy


Używaj wyłącznie ładowarki dostarczonej wraz z głowicą.

Poniższy rysunek przedstawia akcesoria do ładowania akumulatora.

Ładowarka Butterfly iQ/ iQ+

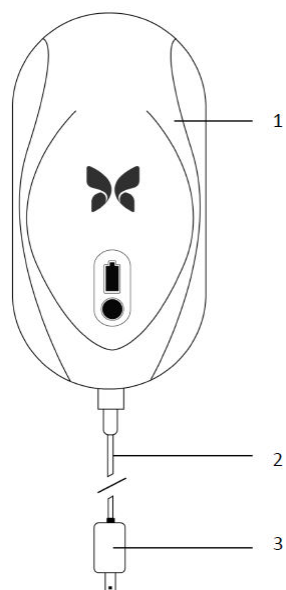

Ładowarka Butterfly iQ3

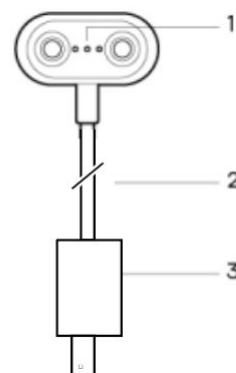

Komponenty systemu ładowania.

Tabela 4. Komponenty systemu ładowania

Butterfly iQ/ iQ+	Butterfly iQ3
1. Podkładka do ładowania	1. Ładowanie stykowe
2. Przewód do ładowania	2. Przewód do ładowania
3. Adapter wtyczki	3. Adapter wtyczki

**UWAGI**

- Najnowsza ładowarka Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 ma matowe czarne wykończenie i zaokrąglone oprawy głowicy. W przypadku poprzedniego modelu należy uzyskać dodatkowe informacje na temat ładowania głowicy za pośrednictwem [Ładowarka akumulatora głowicy \[105\]](#).
- Elektroniczny interfejs/panel sterowania nie służy do sterowania działaniem innego urządzenia ani akcesorium medycznego.

3.3. Omówienie interfejsu u ytkownika

Niniejsza cz zawiera informacje dotycz ce wy wietlacza obrazów przedstawionego w interfejsie u ytkownika aplikacji Butterfly iQ.

Interfejs u ytkownika aplikacji zawsze wy wietla informacje o indeksie mechanicznym (MI) i indeksie termicznym (TI) u góry ekranu.

W zale no ci od statusu subskrypcji Butterfly i wersji aplikacji mobilnej pasek narz dzi u dołu ekranu mo e si ró ni .

Pasek narz dzi u dołu ekranu słu y do wyboru ustawie wst pnych, zamra ania obrazu, przechwytywania obrazu oraz wyboru trybu/narz dzia.

3.4. Presets


Ustawienia wst pne s predefiniowanym zestawem warto ci parametrów obrazowania. Po wybraniu tej opcji aplikacja Butterfly iQ automatycznie dziaa w oparciu o odpowiedni zestaw warto ci parametrów obrazowania. Dost pne ustawienia wst pne odpowiadaj szczegółowym zastosowaniom klinicznym w [Wskazania do stosowania \[8\]](#). Dost pne ustawie wst pnych mo e si ró równie ró ni w zale no ci od rodzaju głowicy, statusu subskrypcji Butterfly i lokalizacji geograficznej.

Poni sza tabela przedstawia dost pne ustawienia wst pne dla ka dej głowicy.

Tabela 5. Dost pne ustawie wst pnych dla ka dej głowicy

Głowica	Presets
Butterfly iQ	Jama brzuszna, jama brzuszna: gł b., aorta i p cherzyk óciowy, p cherz moczowy, kardiologiczny, sercowy: gł b., FAST, płuca, MSK – tkanka mi kka, mi niowo-szkieletowy, nerwowy, POŁ1/GIN, OB 2/3, okulistyczny, jama brzuszna u dzieci, kardiologiczny u dzieci, płuca u dzieci, małe narz dy, naczyniowy: doj cie, naczyniowy: szyjny, naczyniowy: gł boka yła
Butterfly iQ+	Jama brzuszna, jama brzuszna: gł b., aorta i p cherzyk óciowy, p cherz moczowy, kardiologiczny, koherencja rytmu serca, sercowy: gł b., FAST, płuca, tkanka płucna, MSK – tkanka mi kka, mi niowo-szkieletowy, nerwowy, POŁ1/GIN, OB 2/3, okulistyczny, jama brzuszna u dzieci, kardiologiczny u dzieci, płuca u dzieci, małe narz dy, naczyniowy: doj cie, naczyniowy: szyjny, naczyniowy: gł boka yła, naczyniowy: powierzchownie
Butterfly iQ3	Jama brzuszna, jama brzuszna: gł b., aorta i p cherzyk óciowy, p cherz moczowy, kardiologiczny, koherencja rytmu serca, sercowy: gł b., FAST, płuca, tkanka płucna, MSK – tkanka mi kka, mi niowo-szkieletowy, igła: poza płaszczyzn , nerwowy, POŁ1/GIN, OB 2/3, okulistyczny, jama brzuszna u dzieci, kardiologiczny u dzieci, płuca u dzieci, małe narz dy, przechylenie pod wyrostkiem mieczykowatym, naczyniowy: doj cie, naczyniowy: szyjny, naczyniowy: gł boka yła, naczyniowy: powierzchownie

3.5. Ustawienia wst pne

Niektóre ustawienia wst pne, które s przeznaczone do tych samych lub podobnych zastosowa klinicznych, s zgrupowane w ramach jednego ogólnego ustawienia wst pnego, co ma na celu ułatwienie dost pu do ró nych ustawie wst pnych w przypadku danego pacjenta obj tego badaniem USG oraz ich ocen . Aby uzyska dost p do innych ustawie wst pnych z tej samej kategorii, stuknij ekran. Dodatkowe elementy steruj ce pojawi si w lewym dolnym rogu ekranu badania. Je li ustawieniu wst pnemu towarzyszy inne ustawienia wst pne w tej samej kategorii, stukni cie przycisku filtra ustawie wst pnych  pozwoli u ytkownikowi przeła si mi dzy ró nymi ustawieniami wst pnymi w ramach danej kategorii.

4. Konfiguracja systemu

Niniejszy rozdział zawiera informacje i instrukcje dotyczące pobierania i instalacji aplikacji Butterfly iQ, rejestracji głowicy, konfiguracji aplikacji Butterfly iQ oraz ładowania głowicy.

4.1. Pobieranie i instalacja aplikacji

Aplikację Butterfly iQ można pobrać i zainstalować na urządzeniu mobilnym, odwiedzając sklep Apple App Store lub Google Play Store. W odpowiednim sklepie z aplikacjami wyszukać „Butterfly iQ”.

Przed pobraniem i instalacją aplikacji należy się upewnić, czy urządzenie mobilne spełnia lub przekracza minimalne wymagania w zakresie wydajności. Dodatkowe informacje na temat najbardziej aktualnych wymagań dotyczących urządzeń można znaleźć na stronie support.butterflynetwork.com.



UWAGA

Jeżeli nie można zainstalować aplikacji, może to wskazywać na fakt, że urządzenie mobilne nie spełnia minimalnych wymagań w zakresie wydajności. Szczegółowe informacje na temat wymagań, patrz support.butterflynetwork.com.

4.2. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe urządzenia mobilnego musi być aktualne, aby możliwe było wykonywanie obrazowania. Niektóre aktualizacje aplikacji mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego zostaną uruchomione przy pierwszym połączeniu głowicy Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 po aktualizacji aplikacji.

Zalecamy włączyć powiadomienie z Butterfly na urządzeniu mobilnym, co umożliwi bieżące aktualizowanie oprogramowania sprzętowego. W przypadku konieczności aktualizacji oprogramowania sprzętowego, wyślemy powiadomienie push, co pozwoli użytkownikowi podjąć stosowne działania przed użyciem głowicy.

Aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Na urządzeniu z systemem iOS

1. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Butterfly iQ.
2. W aplikacji Butterfly iQ kliknij swój awatar w prawym dolnym rogu ekranu, aby uzyskać dostęp do Profilu i przejść do opcji Powiadomienia.
3. Przełącz „Push”, aby włączyć powiadomienia push.
4. Przejdź do ustawień urządzenia mobilnego.
5. Wybierz opcję „Butterfly iQ” i włącz opcję „Zezwalaj na powiadomienia”.

Na urządzeniu z systemem Android

1. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Butterfly iQ.
2. W aplikacji Butterfly iQ kliknij swój awatar w prawym dolnym rogu ekranu, aby uzyskać dostęp do Profilu i przejść do opcji Powiadomienia.
3. Przełącz „Push”, aby włączyć powiadomienia push.
4. Przejdź do ustawień urządzenia mobilnego.

- Wybierz „Aplikacje i powiadomienia”.
- Wybierz Butterfly iQ i zezwól na powiadomienia.

4.3. Zarządzanie aktualizacjami aplikacji



PRZESTROGI!

- Butterfly obsługuje obecnie dwie poprzednie wersje aplikacji. Aktualizacja wielu wersji aplikacji może oznaczać konieczność odinstalowania i ponownej instalacji aplikacji, co może spowodować utratę danych.
- Jeżeli system nie był podłączony do sieci bezprzewodowej lub komórkowej w ciągu ostatnich 30 dni, generuje komunikat o podłączeniu do sieci Internet w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji.
- Zignorowanie obowiązkowych aktualizacji wiąże się z ryzykiem odcięcia dostępu do systemu.

Aktualizacje aplikacji Butterfly iQ są dostępne w sklepie Apple App Store lub Google Play Store.

W ustawieniach urządzenia można skonfigurować aplikację Butterfly iQ, włączając opcję aktualizowania automatycznego lub ręcznego.

Jeżeli urządzenie mobilne zostało skonfigurowane pod kątem automatycznego aktualizowania aplikacji, wówczas aplikacja Butterfly iQ będzie aktualizowana automatycznie po udostępnieniu aktualizacji.

Jeżeli urządzenie mobilne nie zostało skonfigurowane pod kątem automatycznego aktualizowania, należy sprawdzić, czy pewien czas aktualizacji w witrynie Apple App Store lub Google Play Store.

4.4. Ładowanie głowicy



OSTRZEŻENIA!

- Unikaj wyłączenia przewodów, głowic, ładowarek i akcesoriów określonych do użytku z systemem Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3. Zastąpienie tych akcesoriów niezatwierdzonymi może prowadzić do wadliwego działania systemu lub urazów pacjenta bądź operatora.
- Jeżeli głowica wydaje się nietypowo gorąca, wydziela zapach lub wydostaje się z niej dym bądź następuje z niej wyciek, natychmiast przerwać korzystanie z niej. Odłącz głowicę od urządzenia mobilnego lub odłącz ją od bezprzewodowej ładowarki (jeżeli dotyczy). Skontaktuj się z działem pomocy technicznej: support.butterflynetwork.com.
- Głowica została zaprojektowana jako urządzenie całkowicie szczelne. Nie podejmować prób otwarcia głowicy ani manipulowania częściami wewnętrznymi urządzenia, w tym akumulatorem. W przeciwnym razie może dojść do urazu pacjenta lub operatora.
- Użytkownikowi nie wolno zdejmować kabla stanowiącego wyposażenie Butterfly iQ. Użytkownik może zdejmować kabel stanowiący wyposażenie Butterfly iQ+/ iQ3 po uprzednim sprawdzeniu, czy kabel jest w pełni zamontowany, aby zapewnić ochronę głowicy przed wpływem czynników środowiska zewnętrznego.
- Akumulator głowicy nie jest przeznaczony do wymiany przez użytkownika. Wymiana akumulatora przez osoby niebędące pracownikami działu wsparcia firmy Butterfly może grozić niebezpieczeństwem, takim jak podwyższona temperatura, pożar lub wybuch.
- Korzystać z zasilania klasy niemedycznej poza środowiskiem pacjenta, co oznacza odległość od pacjenta wynoszącą co najmniej 1,5 m.



PRZESTROGI!

- Zapewnienie prawidłowego działania głowicy wymaga ładowania jej akumulatora co najmniej raz w miesiącu.
- Jeśli głowica nie włącza się po ładowaniu, może to wskazywać na awarię akumulatora. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej: support.butterflynetwork.com.

Ważne jest, aby głowica była zawsze naładowana. Do ładowania głowicy używaj dostarczonych akcesoriów do ładowania akumulatora.

Akcesoria do ładowania akumulatora obejmują podkładki do ładowania, przewód do ładowania i adapter wtyczki.

Położenie głowicy na ładowarce w takim położeniu, jak pokazano poniżej

Ładowarka głowicy trzeciej generacji dla Butterfly iQ/ iQ+



Butterfly iQ3 ładowarka głowicy



Ładowarka głowicy



UWAGA

- Najnowsza ładowarka Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 ma matowe czarne wykończenie. W przypadku posiadania poprzedniego modelu, należy uzyskać dodatkowe informacje na temat ładowania głowicy za pośrednictwem support.butterflynetwork.com.
- Dokładny model podkładki ładowalnej/kabla ładowalnego może się różnić.
- Butterfly iQ/ iQ+ wykorzystuje system ładowania bezprzewodowego. Nie należy podejmować prób umieszczania przewodu głowicy w podkładce do ładowania ani ładować za pomocą kabla głowicy.
- Butterfly iQ3 wykorzystuje system ładowania stykowego. Nie należy podejmować prób umieszczania przewodu głowicy w podkładce do ładowania ani ładować za pomocą kabla głowicy.

Używana podkładka do ładowania może być inna. Szczegółowe informacje na temat parametrów podkładki, patrz: support.butterflynetwork.com.

Aby naładować głowicę :

1. Odłącz głowicę od urządzenia mobilnego. Obrazowania nie można wykonać podczas ładowania.
2. W przypadku Butterfly iQ/ iQ+ podłącz kabel ładowający do podkładki ładowającej, a kable USB do zasilacza ściennego. W przypadku głowicy Butterfly iQ3 podłącz kabel USB do ładowania styków do zasilacza ściennego.
3. Włóż adapter wtyczki do gniazda elektrycznego. W przypadku Butterfly iQ/ iQ+ ładowarka za wskaźnik, aby pokazać, że jest włączona. W przypadku Butterfly iQ3 na samym stykowym kablu ładowanym nie ma wskaźnika, że jest on podłączony do zasilania, jednak kontrolki akumulatora powinny świecić na samej głowicy.
4. W przypadku Butterfly iQ/ iQ+ umieść głowicę na podkładce ładowającej tak, aby leżała płasko i poczekaj, aż za wskaźnik baterii głowicy. W przypadku Butterfly iQ3 umieść głowicę na stykowym kablu ładowanym tak, aby głowica sondy spoczywała na płaskiej powierzchni i poczekaj, aż za wskaźnik baterii sondy.

W czasie ładowania akumulatora głowicy jego kontrolki wskazują aktualny poziom naładowania. Gdy ładowanie głowicy dobiegnie końca, kontrolka akumulatora głowicy zgaśnie. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat lampek stanu konkretnej ładowarki, patrz: support.butterflynetwork.com.



UWAGA

Podczas ładowania głowica może się nagrzać, co jest zjawiskiem normalnym. Po zdjęciu głowicy z podkładki do ładowania przed całkowitym naładowaniem lub bezpośrednio po jego zakończeniu zaleca się, aby przed użyciem głowicy poczekać na jej ostygnięcie. Ponieważ system ogranicza temperaturę podczas kontaktu głowicy z ciałem pacjenta i nie będzie skanować w temperaturze wynoszącej 43°C (109°F) lub więcej, ostygnięcie głowicy przed użyciem zoptymalizuje czas samego skanowania.

4.4.1. Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora głowicy

Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora umożliwia przycisk wskaźnika akumulatora i kontrolki akumulatora. Więcej informacji, patrz: [Głowica \[23\]](#)

Tabela 6. Kontrolki poziomu naładowania akumulatora głowicy

Wzorzec wieczenia	Przybliżony poziom naładowania akumulatora
Wszystkie 4 kontrolki wiec	87.5% - 100%
3 kontrolki wiec	67.5% - 87.4%
2 kontrolki wiec	37.5% - 67.4%
1 kontrolka wieci	12.5% - 37.4%
1. kontrolka miga	<12%

Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora głowicy za pomocą głowicy:

- Naciśnij przycisk wskaźnika akumulatora, aby zobaczyć kontrolki poziomu naładowania akumulatora.
- Jeżeli pierwszy przycisk miga, oznacza to, że poziom naładowania akumulatora głowicy jest zbyt niski, aby możliwe było wykonanie badania.
- Jeżeli diody w ogóle nie migają:
 - Otwórz aplikację Butterfly iQ.
 - Przejdź do ekranu badania.
 - Poczekaj 10 sekund, a pojawi się przycisk „Uruchom procedurę rozwiązywania problemów”.
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów.

Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora głowicy za pomocą aplikacji Butterfly iQ:




- Poziom naładowania akumulatora głowicy wyświetlany jest w górnej części ekranu obrazowania.
- Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, wykonanie badania nie będzie możliwe do momentu ponownego naładowania akumulatora. O ile to możliwe, akumulator powinien być w pełni naładowany.


5. Używanie systemu

Niniejszy rozdział zawiera informacje i instrukcje dotyczące obsługi systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 mające na celu rozpoczęcie i zakończenie badania. Rozdział zawiera ponadto informacje i instrukcje dotyczące zamrażania i odmrażania w czasie obrazowania na żywo, wykonywania pomiarów oraz innych narzędzi do obrazowania.


5.1. Przeprowadzanie badania

Po podłączeniu głowicy do urządzenia mobilnego postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć nowe badanie. Nie ma wymogu wprowadzenia danych pacjenta, aby rozpocząć badanie.

Z głównego ekranu badania można zamrozić obraz , przechwytywać obrazy  oraz nagrywać sekwencje obrazów  za pomocą paska narzędzi znajdującego się na dole ekranu. Aby przechwytywać nieruchomy obraz, obraz na żywo musi najpierw zostać zamrożony.

Przechwycone obrazy można przeglądać na rolce przechwyconych obrazów znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu  przed zakończeniem badania.

Aby zakończyć badanie pacjenta, należy kliknąć rolkę przechwyconych obrazów i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu przesłania badania.

Podczas badania można przesunąć głowicę, w poziomie w celu regulacji wzmocnienia, lub w pionie – w celu regulacji głębi. Przycisk sterujący zasięgiem regulacji wzmocnienia (TGC) jest wyświetlany po stuknięciu ekranu pod dodatkowymi elementami sterującymi w lewym dolnym rogu .



UWAGA

- Istnieje możliwość wykonywania gestów, takich jak zbliżenie palców czy podwójne dotknięcie, w celu powiększenia lub pomniejszenia obrazu. Gdy obraz pozostaje w stanie powiększenia, można za pomocą palca obrócić obraz (przemieścić go na ekranie).
- Możliwość zmiany orientacji z pionowej na poziomą jest dostępna tylko na tablecie.

Jeśli operator chce wprowadzić dane pacjenta do badania, może to zrobić za pomocą rolki przechwyconych obrazów. W zależności od konfiguracji dane pacjenta można dodać ręcznie, z listy roboczej lub skanując kod kreskowy.

Aby dodać lub przeglądać dodatkowe dane dotyczące badania, takie jak wyniki obliczeń, należy skorzystać z pola notatek w rolce przechwyconych obrazów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przeprowadzania badania, należy odwiedzić stronę support.butterflynetwork.com.

5.2. Przesyłanie bada do Butterfly Cloud



UWAGI

- W zależności od platformy, sprytu, kraju i rodzaju subskrypcji niektóre ustawienia wstępne oraz funkcje mogą być niedostępne.
- Urządzenie Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 i jego akcesoria mogą być używane wielokrotnie u wielu pacjentów.

Aby zarchiwizować badanie:

1. Po zakończeniu przechwytywania obrazów ultrasonograficznych dotknij opcji **Rolka przechwyconych obrazów** w prawym górnym rogu ekranu. Nastąpi wyświetlenie ekranu **Badanie**.
2. OPCJONALNIE: Powiadomienie informacji o pacjencie
3. Dotknij opcji Save (Zapisz), aby zainicjować przesłanie.
4. Wybierz archiwum i naciśnij **Przełij**.
5. Aby usunąć wszystkie elementy z lokalizacji Rolka przechwyconych obrazów, dotknij opcji **Wyczyść obrazy**. System wygeneruje komunikat o potwierdzenie usunięcia. Czyszczenie serii powoduje usunięcie wszystkich obrazów i sekwencji obrazów z lokalizacji Rolka przechwyconych obrazów.

5.3. Korzystanie z funkcji przycisku głowicy

Podczas korzystania z głowicy Butterfly iQ+ naciśnięcie przycisku na głowicy skutkuje jednym z następujących działań: przechwycenie obrazu, przechwycenie filmu lub odblokowanie obrazu. Funkcja przycisku na głowicy jest domyślnie wyłączona. Można ją skonfigurować za pomocą menu preferencji w aplikacji Butterfly iQ.

Na głowicy Butterfly iQ3 znajdują się trzy przyciski: środkowy, w górę i w dół. Naciśnięcie środkowego przycisku będzie funkcjonować w taki sam sposób, jak naciśnięcie przycisku na Butterfly iQ/ iQ+, tj. przechwyci nieruchomy obraz, rozpocznie/zatrzyma nagrywanie, albo odblokuje obraz. Pozostałe dwa przyciski (w górę i w dół) służą do regulacji głośności, wzmocnienia lub zmiany trybów. Działanie można skonfigurować w menu preferencji. Aby zmienić działanie, przejdź do preferencji a następnie wybierz opcję „Działania przycisków głowicy”. W menu „Działania przycisków” wybierz ustawienie opcji „DZIAŁANIE PRZYCISKU W GÓRĘ I W DÓŁ”.

5.3.1. Korzystanie z funkcji przechwytywania obrazów za pomocą przycisku głowicy:

Aby skonfigurować przycisk do przechwytywania obrazów:

1. Podłącz głowicę Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 i przejdź do menu Profil w prawym dolnym rogu ekranu, klikając inicjały lub swój awatar.
2. Wybierz pozycję „Działania przycisku głowicy”.
3. Funkcja przechwytywania jest domyślnie wyłączona. Aby ją wyłączyć, przesuwaj przełącznik „Wyłącz działanie przycisku” w lewo. Aby ją ponownie włączyć, przesuwaj przełącznik w prawo.
4. Na tej samej stronie można wybrać działanie związane z naciśnięciem przycisku głowicy Butterfly iQ/ iQ+ lub przycisku środkowego Butterfly iQ3 podczas obrazowania na żywo: dostępne opcje to „Przechwyć obraz” i „Uruchom/zatrzymaj sekwencję obrazów”.
5. Wróć do ekranu badania i rozpocznij lub wznow badanie.
6. Aby skorzystać z funkcji głowicy Butterfly iQ/ iQ+, należy naciśnąć przycisk na głowicy. Aby skorzystać z niej na głowicy Butterfly iQ3, należy naciśnąć przycisk środkowy.

5.3.2. Korzystanie z funkcji odblokowania obrazu za pomocą przycisku głowicy:

Aby dostosować działania związane z przyciskiem Button Push (naciśnięcie okrągłego przycisku na stronie Butterfly iQ3) w celu odmrożenia obrazu:

1. Podłącz głowicę Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 i przejdź do menu Profil w prawym dolnym rogu ekranu, klikając inicjały lub swój awatar.
2. Wybierz pozycję „Działania przycisku głowicy”.
3. Funkcja odblokowania jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć, przesunij przełącznik „Włącz czynność przycisku” w lewo. Aby ją ponownie wyłączyć, przesunij przełącznik w prawo.
4. Wróć do ekranu badania i rozpocznij lub wznow badanie.
5. Aby odblokować obraz przy aktywnej funkcji automatycznego odblokowywania, należy nacisnąć przycisk na głowicy Butterfly iQ/ iQ+ lub okrągły przycisk na Butterfly iQ3.

6. Korzystanie z trybów


Niniejszy rozdział zawiera informacje i instrukcje dotyczące korzystania z trybów podczas badania USG.



UWAGA

- Zaawansowane funkcje obrazowania mogą się różnić w zależności od wybranego ustawienia wstępnego i statusu płatnej subskrypcji. Należy wejść na stronę support.butterflynetwork.com, aby uzyskać najnowsze informacje na temat tego, jakie ustawienie wstępne ma dostęp do poszczególnych trybów.
- Butterfly iQ/ iQ+ lub jakiegokolwiek system ultradźwiękowy stosowany do przesiewowego badania pod kątem pęknięcia implantów piersi wypełnionych elementem silikonowym jest odpowiedni tylko dla pacjentów bezobjawowych. W przypadku pacjentek z objawami lub niejednoznacznymi wynikami badania ultrasonograficznego pod kątem pęknięcia w którymkolwiek momencie po operacji, zaleca się wykonanie rezonansu magnetycznego.

6.1. Korzystanie z trybu B

Tryb B jest domyślnym obrazem wyświetlanym po wybraniu danego ustawienia wstępnego. Jasno poszczególnych pikseli wskazuje na natężenie fali akustycznej odbitej od tkanki. Niektóre ustawienia wstępne, np. te przeznaczone do badania kardiologicznego, mają wiele wersji trybu B, do których można uzyskać dostęp za pomocą przycisku filtra ustawień wstępnych . Jedno z tych ustawień nosi nazwę **Koherencja**¹. W ustawieniu tym wykorzystuje się odmienną metodę obliczania jasności pikseli na podstawie stopnia podobieństwa różnych sygnałów mierzonych za pomocą aparatury, co powoduje dalsze tłumienie zakłóceń. Ponowne wybranie przycisku filtra zmienia obraz w trybie B na standardowy tryb B, zapewniając użytkownikowi kontrolę nad wybranym obrazem wykorzystywanym do celów diagnostycznych.

6.2. Korzystanie z trybu kolorowego Dopplera lub Dopplera mocy

W trybie kolorowego Dopplera lub Dopplera mocy można:

- Dostosowywać wielkość i pozycję obszaru zainteresowania (ROI).
- dostosować głośność i wzmocnienie;
- Dostosować skalę (określaną jako częstotliwość powtarzania impulsu (PRF)) w celu optymalizacji pod kątem wysokiego lub niskiego przepływu poprzez dotknięcie elementu sterowania **Wysoki/Niski**, który znajduje się u dołu ekranu

ROI jest wyświetlany na obrazie. Aby przesunąć ROI, należy dotknąć i przeciągnąć pole. Aby dostosować kształt i rozmiar, trzeba użyć przycisków strzałek.


Elementy sterowania, takie jak wzmocnienie koloru i głośność, są dostępne w czasie obrazowania w trybie Dopplera mocy.

6.3. Używanie trybu M

Na wyświetlaczu trybu M znajdują się elementy sterowania (Fast (Szybko) i Slow (Wolno)), linia trybu M, obraz w trybie B i punkt przemieszczania słuchaczy do zmiany miejsca położenia linii trybu M.

¹Koherencja serca jest opcją dostępną tylko w wybranych krajach.

Uwaga: w trybie M, można:

- Dostosować linię skanowania promieniowego poprzez dotknięcie i przeciągnięcie punktu: 
- dostosować prędkość przemieszczania w wietlaczu trybu M, dotykając elementu sterowania Fast (Szybko) / Slow (Wolno) po rodku ekranu;
- dostosować parametry, takie jak **Głębokość** i **Wzmocnienie**
- wykonać na wietlaczu obliczenia czasu, odległości i tnia.

Dostęp do trybu M

1. Wybierz odpowiednie ustawienie wstępne i określ obszar, który ma zostać poddany obrazowaniu. Należy pamiętać, że obrazowanie rozpocznie się w trybie B.
2. Wybierz opcję Actions (Czynności) u dołu ekranu obrazowania.
3. W zakładce Modes (Tryby) wybierz M-mode (Tryb M).

6.4. Korzystanie z trybu Dopplera spektralnego fali pulsacyjnej

Doppler spektralny fali pulsacyjnej (Doppler pulsacyjny) to metoda ilościowa, która pozwala w sposób graficzny przedstawić pomiary prędkości przepływu krwi w czasie.



W trybie Dopplera pulsacyjnego można:

- Wyświetlać i regulować pozycję objętości próbki, przytrzymując i przeciągając bramki.
- Wyświetlać i regulować korekcję kąta, przytrzymując i przeciągając biały wskaźnik pomiaru.
- Przełączyć pomiary trybem Dopplera pulsacyjnego na tryb B na żywo, wybierając przycisk Start Spectrum/Update B-mode (Rozpocznij zapis widma/Aktualizuj tryb B).
- Regulować wzmocnienie ładunku spektralnego, przesuwając palcem w lewo i prawo po ładzie, gdy jest on na żywo.
- Dostosować skalę w celu optymalizacji pod kątem wysokiego lub niskiego przepływu poprzez dotknięcie elementu sterowania **Niski przepływ/Wysoki przepływ** na rodku ekranu. Należy pamiętać, że element sterowania wskazuje bieżący stan.
- Dostosować prędkość przemieszczania ładunku spektralnego Dopplera za pomocą elementu sterowania **Wolne/Szybkie przemieszczanie** na rodku ekranu. Należy pamiętać, że element sterowania wskazuje bieżący stan.
- Jeśli korzystasz z Butterfly iQ3, dodaj kolor do obrazu, dotykając kontrolki **Włącz kolorowego Dopplera** na rodku ekranu.

Aby wyregulować wzmocnienie i głębię obrazu odniesienia w trybie B, należy wyjść z trybu Dopplera pulsacyjnego i zoptymalizować obraz w trybie B, kolorowego Dopplera lub Dopplera mocy.

Umieszczenie objętości próbki

1. Należy przytrzymać i przeciągnąć bramki objętości próbki (kwadratowy obszar w rodku strzałki) w wybrane miejsce w obrębie naczynia, które stanowi przedmiot zainteresowania. W przypadku korzystania z głowicy Butterfly iQ3 można włączyć tryb kolorowego Dopplera, aby pomóc w umieszczeniu objętości próbki, dotykając przycisku „Włącz kolorowego Dopplera” na rodku ekranu.
2. Po ustawieniu dostosować kierunek strzałki do kierunku przepływu. Jeśli przepływ w naczyniu jest dogłówny, skieruj strzałkę w kierunku dogłównym. Przykład odpowiednio wyrównanego przepływu w tętnicy szyjnej (po lewej) i tętnicy szyjnej wewnętrznej (po prawej) podano poniżej.

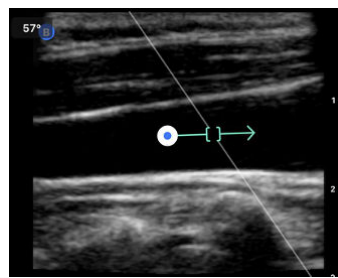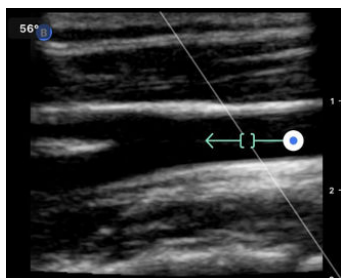

PRZESTROGA!

Kierunkowo przepływu jest przedstawiona w odniesieniu do kierunku strzałki. Nieprawidłowe ustawienie strzałki może prowadzić do błędnej interpretacji kierunku przepływu. Należy dokładnie sprawdzić, czy strzałka wskazuje oczekiwany kierunek przepływu krwi.




UWAGA

Przepływ zgodnie z kierunkiem strzałki zostanie wyświetlony powyżej linii bazowej. Przepływ w kierunku przeciwnym do kierunku strzałki zostanie wyświetlony poniżej linii bazowej.

3. Należy wybrać przycisk Start Spectrum (Rozpocznij zapis widma), aby rozpocząć ledzenie spektralne. Jeśli ład nie jest widoczny, należy dostosować objętość próbki. W przypadku używania głowicy Butterfly iQ3 powinien być emitowany dźwięk powiadamiający ze ładem wizualnym. Głośność można kontrolować lub wyciszyć, zmieniając poziom głośności w urządzeniu. Jeśli nie słyszysz dźwięku powiadamiającego ze ładem widmowym, spróbuj zwiększyć głośność w urządzeniu.
4. Aby wyregulować lokalizację objętości próbki:
 - a. Przytrzymaj i przeciągnij strzałkę, co automatycznie zatrzyma widmo i ponownie wyświetli obraz odniesienia w trybie B.
 - b. Naciśnij przycisk Update B-mode (Aktualizuj tryb B), aby raz jeszcze zatrzymać widmo i ponownie uruchomić tryb B. W przypadku korzystania z głowicy Butterfly iQ3 można włączyć i wyłączyć tryb kolorowego Dopplera po ponownym uruchomieniu trybu B.

Umieszczenie pola próbnego z włączonym kolorowym dopplerem w Butterfly iQ3.

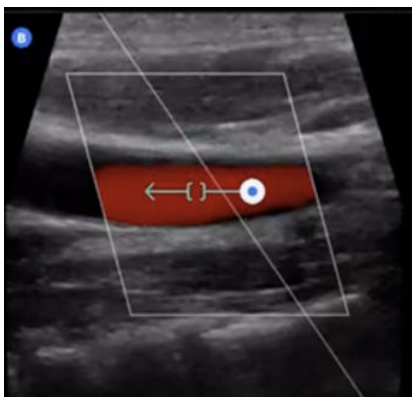

5. Aby regulować prędkość przemieszczania widma, wybierz przycisk **Slow Scroll/Fast Scroll** („Powolne przemieszczanie/szybkie przemieszczanie”).
6. Aby regulować skalę prędkości, wybierz przycisk **Low Flow/High Flow** (niski przepływ/wysoki przepływ) lub przeciągnij linię bazową.

7. Aby dodać adnotacje, zamroź obraz i wybierz przycisk adnotacji.
8. Aby dodać pomiary, zamroź obraz i zaznacz pomiary liniowe.



UWAGA

Adnotacje i pomiary można dodawać tylko do obszaru, w którym występuje ład spektralny.

9. Pomiary prędkości podane są w cm/s jako szczytowa prędkość skurczowa (PSV), wartość odległości pionowej od linii bazowej pierwszego punktu wskaźnika pomiaru, oraz prędkość końcowo-rozkurczowa (EDV), wartość odległości pionowej od linii bazowej drugiego punktu wskaźnika pomiaru.
10. Różnica czasu pomiędzy lewym a prawym kołcem wskaźnika pomiaru jest przedstawiona jako czas (t) w sekundach.
11. Aby zapisać obraz Dopplera pulsacyjnego, należy go zamrozić, a następnie nacisnąć przycisk przechwytywania obrazu.




UWAGA

Aby automatycznie obrócić strzałkę o 180 stopni, stuknij przycisk odwracania, gdy widmo jest widoczne. Po stuknięciu przycisku, jeżeli widmo nie jest widoczne, zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu rejestracji widma.


Doppler fali pulsacyjnej w badaniu jamy brzusznej

W przypadku badania jamy brzusznej i głębokiego badania jamy brzusznej tryb Dopplera fali pulsacyjnej charakteryzuje się następującymi różnicami w porównaniu z tym, co omówiono wcześniej:

- Brak korekcji kąta.
- Brak funkcji odwrócenia.
- Aby przesunąć obiekt próbki, ułtykownik może przytrzymać niebieski kropkę . Uwaga: Przytrzymanie próbki w ogólnej okolicy niebieskiej kropki powoduje również przesunięcie bramki.

Doppler fali pulsacyjnej w badaniu kardiologicznym

W przypadku ustawień przeznaczonych do badania serca tryb Dopplera fali pulsacyjnej charakteryzuje się następującymi funkcjami dostosowanymi do zastosowań kardiologicznych:

- Brak korekcji kąta.
- Brak funkcji odwrócenia.
- Podobnie jak w przypadku funkcji dźwięków bicia serca płodu, aby przesunąć obiekt próbki, ułtykownik może przytrzymać niebieski kropkę . Uwaga: przytrzymanie próbki w ogólnej okolicy niebieskiej kropki również powoduje przesunięcie bramki.
- Ponieważ pomiary w obrębie spektrum mogą być użyte dla dowolnego z pików, prędkości są ogólne: v_1 i v_2 .
- Zgodnie z konwencją stosowaną w badaniu serca z użyciem Dopplera fali pulsacyjnej, pokazana jest tylko wartość bezwzględna mierzonych prędkości.


6.5. Korzystanie z trybu Biplane Imaging™ (wyłącznie Butterfly iQ+/ iQ3)

Tryb Biplane Imaging to tryb jako ciowy, za pomocą którego wyświetlane są dwie płaszczyzny obrazowania: wzdłuż osi podłużnej oraz wzdłuż osi poprzecznej głowicy. O podłużnej, zwana „płaszczyzną odniesienia”, jest wyświetlana w dolnej części ekranu, a o poprzecznej, zwana „płaszczyzną prostopadłą”, jest wyświetlana w górnej części ekranu.

Tryb Biplane Imaging jest dostępny w ramach ustawień wstępnych przeznaczonych do badania kardiologicznego standardowego, koherencji serca, badania układu mięśniowo-szkieletowego, tkanek miękkich, nerwów oraz dostępu naczyniowego.

Korzystając z trybu Biplane, można:

- Wyświetla i koryguje położenie płaszczyzny prostopadłej w stosunku do płaszczyzny odniesienia
- Optymalizować wzmocnienie i głębię jednocześnie w obu płaszczyznach
- Zamrażać obrazy i dokonywać pomiarów w obydwóch projekcjach
- Przechwytywać filmy i obrazy
- Aktywować narzędzie Needle Viz (w płaszczyźnie)

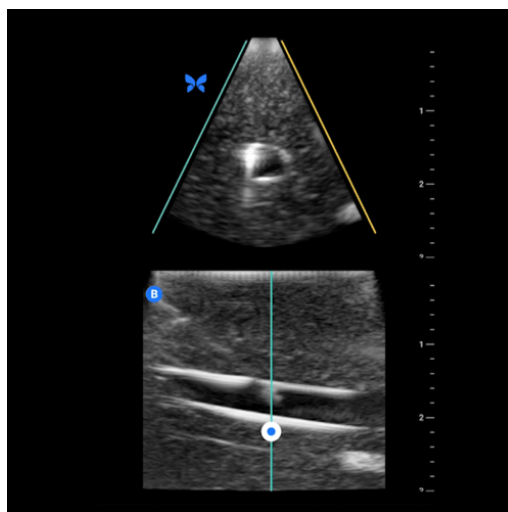

Aby rozpocząć korzystanie z trybu Biplane Imaging:

1. Wprowadź ustawienie wstępne, w którym dostępne jest narzędzie Biplane Imaging. Aktywuj narzędzie Biplane za pomocą menu czynności.
2. Nałóż czep na głowicę i rozpocznij badanie.
3. Aby korygować położenie płaszczyzny prostopadłej, dotknij i przeciągnij biały punkt z jednej strony na drugą w płaszczyźnie podłużnej (dolnej).
4. W trybie Biplane dostępne są narzędzia do zamrażania, mierzenia, opisywania i przechwytywania, a także regulacja wzmocnienia i głębi.
5. Aby jednocześnie używać narzędzia Needle Viz (w płaszczyźnie), włóż je za pomocą menu czynności. W płaszczyźnie odniesienia widoczny będzie obszar zainteresowania, w obrębie którego igła w płaszczyźnie zostanie podświetlona. Ponadto, jeśli igła przekroczy wskaźnik płaszczyzny prostopadłej, pozycja igły w projekcji poza płaszczyznę będzie wyświetlona na płaszczyźnie prostopadłej. Aby odwrócić pozycję obszaru zainteresowania, wybierz przycisk odwracania.

Tryb Biplane w ustawieniach wstępnych kardiologicznych

Tryb Biplane jest dostępny w ustawieniach wstępnych do badania kardiologicznego, takich jak ustawienie standardowe oraz koherencja. W porównaniu z liniowymi ustawieniami wstępnymi tryb Biplane charakteryzuje się następującymi cechami:

1. Aby korygować położenie płaszczyzny prostopadłej, dotknij i przeciągnij biały punkt wokół wierzchołka płaszczyzny podłużnej (dolnej). Przesuń biały punkt w obrębie płaszczyzny odniesienia; można go przeciągnąć względem płaszczyzny podłużnej (odniesienia lub dolnej), a płaszczyzna prostopadła będzie obracać się wokół wierzchołka (górnego boku obrazu biegunowego) płaszczyzny odniesienia.

2. Obie płaszczyzny są nieruchome, funkcja odwrócenia jest wyłączona, orientacja jest zoptymalizowana pod kątem dwuwymiarowej projekcji przymostkowej w osi długiej zgodnie z Wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego (ASE)².

6.6. Korzystanie z funkcji dźwięków bicia serca płodu

Dźwięki bicia serca płodu to tryb, za pomocą którego osoba przeprowadzająca badanie i pacjentka słyszą dźwięki bicia serca płodu. Jednocześnie wyświetla się widmo fali pulsacyjnej. Dźwięki serca płodu są dostępne w ustawieniu wstępnym OB 2/3.

Korzystając z trybu Dźwięków bicia serca płodu, można:

- Wyświetla i regulować pozycję obiektów próbek, przytrzymując i przeciągając bramki.
- Słucha dźwięków bicia serca płodu po włączeniu dźwięku.
- Przełącza pomiary funkcji audio na żywo a trybem B na żywo, wybierając przycisk „Włącz dźwięki/Aktualizuj tryb B”.
- Regulować głośność dźwięków bicia serca płodu i wzmocnienie ładunku widmowego, przeciągając palcem w lewo i w prawo po ładowaniu, gdy ładunek jest na żywo.
- Dostosować skalę w celu optymalizacji pod kątem wysokiego lub niskiego przepływu poprzez dotknięcie elementu sterowania Niski przepływ/Wysoki przepływ na rodunku ekranu. Należy pamiętać, że element sterowania wskazuje stan bieżący.
- Dostosować prędkość przemiatania ładunku dźwięków bicia serca płodu za pomocą elementu sterowania „Wolne/Szybkie przemiatanie” na rodunku ekranu. Należy pamiętać, że element sterowania wskazuje stan bieżący.

Aby wyregulować wzmocnienie i głośność obrazu odniesienia w trybie B, należy wyjść z trybu Dźwięków bicia serca płodu i zoptymalizować obraz w trybie B.

Umieszczenie obiektów próbek

1. Należy przytrzymać i przeciągnąć bramki obiektów próbek (kwadratowy obszar wzdłuż linii Dopplera) w dane miejsce w obrębie serca płodu.
2. Po ustawieniu stuknięciem „Włącz dźwięki”, aby uruchomić zarówno dźwięki serca płodu, jak i ładunek widmowy. Jeśli ładunek nie jest widoczny lub nie słychać dźwięków bicia serca płodu, należy dostosować obiekt próbki.
3. Aby wyregulować lokalizację obiektów próbek:
 - a. Przytrzymaj i przeciągnij bramki obiektów próbek, co automatycznie zatrzyma widmo i ponownie uruchomi obraz odniesienia w trybie B.
 - b. Naciśnij przycisk Update B-mode (Aktualizuj tryb B), aby również zatrzyma widmo i ponownie uruchomi tryb B.
4. Aby regulować prędkość przemiatania widma, należy wybrać przycisk Slow Scroll/Fast Scroll („Powolne przemiatanie/szybkie przemiatanie”).
5. Aby regulować skalę prędkości, wybierz przycisk Low Flow/High Flow (niski przepływ/wysoki przepływ) lub przeciągnij linię bazową.
6. Aby dodać adnotacje, zamroź obraz i wybierz przycisk adnotacji.
7. Aby dodać pomiary, zamroź obraz i zaznacz pomiary liniowe.



UWAGA

Adnotacje i pomiary można dodawać tylko do obszaru, w którym występuje ładunek spektralny.

²Wytyczne ASE.

8. Pomiary prędkości są przedstawione w cm/s.
9. Różnica czasu pomiaru lewym a prawym kołkiem wskaźnika pomiaru jest przedstawiona jako czas (t) w sekundach.
10. Aby zapisać obraz Dopplera pulsacyjnego, należy go zamrozić, a następnie nacisnąć przycisk przechwytywania obrazu.



UWAGA

- Obecnie promuje się stosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w pierwszym trymestrze ciąży jako metody pomocniczej w badaniach przesiewowych i diagnostyce niektórych wad wrodzonych. Procedura ta wymaga znacznych umiejętności i narządów na dłuższe okresy relatywnie wysokich poziomów ekspozycji na ultradźwięki. Ze względu na zwiększoną moc akustyczną Dopplera spektralnego należy zachować ostrożność podczas jego stosowania w I trymestrze ciąży. Obrazowanie metod Dopplera spektralnego powinno być stosowane tylko wtedy, gdy korzyść wyraźnie przewyższa ryzyko, a zarówno TI, jak i czas trwania badania są ograniczone. Protokoły, które zazwyczaj obejmują wartości TI nie większe niż 1,0, odzwierciedlają minimalne ryzyko.

6.7. Korzystanie z iQ Slice



UWAGA

Dostępność trybów iQ Slice i iQ Fan może się różnić w zależności od rodzaju głowicy, statusu subskrypcji Butterfly i lokalizacji geograficznej.

iQ Slice to tryb przechwytywania, który wykonuje pojedynczy pomiar wolumetryczny, pozyskując wiele przekrojów obszaru zainteresowania.

Korzystaj z trybu iQ Slice, możesz:

- Dostosować **wzmocnienia i głębię bokości**
- Wykonać pojedynczy pomiar wolumetryczny, aby wygenerować wiele przekrojów
- Wykonać pomiary liniowe i eliptyczne na przekrojach
- Wybierz przekrój do zapisania jako zdjęcie
- Zapisz wszystkie przekroje jako wiele zdjęć
- Zapisz wszystkie przekroje jako klip wideo

Korzystanie z trybu iQ Slice

1. Wybierz ustawienie wstępne i określ obszar, który ma zostać poddany obrazowaniu. Należy pamiętać, że obrazowanie będzie się odbywać w trybie B.
2. Wybierz opcję Actions (Działania) u dołu ekranu obrazowania.
3. W sekcji Modes (Tryby) wybierz iQ Slice.

6.8. Korzystanie z trybu iQ Fan



UWAGA

Dostępność trybów iQ Slice i iQ Fan może się różnić w zależności od rodzaju głowicy, statusu subskrypcji Butterfly i lokalizacji geograficznej.

iQ Fan to tryb obrazowania na żywo, który wykonuje ciągłe, dwukierunkowe przesuwanie wysokości w czasie rzeczywistym nad danym obszarem. Kąt wzniesienia przesuwania będzie oscylował w zakresie +/- 20°.

Korzystając z trybu iQ Fan, możesz:

- Dostosować **wzmocnienia i głośność**
- Zatrzymać i przechwycić nieruchomy obraz
- Nagrać klip wideo

Korzystanie z trybu iQ Fan

1. Wybierz ustawienie wstępne i określ obszar, który ma zostać poddany obrazowaniu. Należy pamiętać, że obrazowanie będzie się odbywać w trybie B.
2. Wybierz opcję Actions (Działania) u dołu ekranu obrazowania.
3. W sekcji Modes (Tryby) wybierz iQ Fan.


7. Adnotacje

Niniejszy rozdział zawiera informacje i instrukcje dotyczące tworzenia adnotacji na obrazach w aplikacji Butterfly iQ. Adnotacje mogą obejmować pomiary liniowe, pomiary elipsy i adnotacje tekstowe.

7.1. Dodawanie adnotacji

Podczas przeprowadzania badania USG można dodawać adnotacje za pomocą menu Actions (Czynności) albo z zamroźonego obrazu. Po przechwyceniu można dodawać adnotacje do obrazów oraz sekwencji obrazów na rolce USG.

Dodawanie adnotacji podczas badania na żywo

Podczas obrazowania na żywo otwórz menu Actions (Czynności)  i wybierz adnotację, którą chcesz dodać do obrazu na żywo.


Dodawanie adnotacji do zamroźonych obrazów

Dotknij ikony zamrożenia, , aby najpierw zamrozić obraz. Następnie wybierz menu Czynności .


Dodawanie adnotacji tekstowej

1. W sekcji **Etykiety** wybierz wstępnie skonfigurowaną adnotację z listy lub opcję „+ Dodaj nową”, aby wyświetlić ekran opcji Wyszukaj lub utwórz nową adnotację.
2. Aby użyć wstępnie skonfigurowanej adnotacji z ekranu opcji wyszukiwania, wybierz adnotację.
3. Aby wprowadzić własną adnotację, wpisz ją za pomocą klawiatury tekst adnotacji.
4. Na klawiaturze urządzenia mobilnego wybierz Done (Gotowe).
5. Przecignij adnotację do wybranej lokalizacji na obrazie.
6. Aby usunąć adnotację, zaznacz ją, a następnie wybierz symbol X. Wybierz opcję Delete Annotation (Usuń adnotację), aby zatwierdzić.
7. Na każdym obrazie istnieje możliwość dodania maksymalnie pięciu adnotacji tekstowych.


Wykonywanie pomiaru liniowego

1. Wybierz przycisk **Linia** .
2. Zaznacz białe kropki i za ich pomocą przeciągnij ołówki do pozycji początkowej lub końcowej pomiaru. Manipulując końcami linii, długość (w cm) jest wyświetlana w polu znajdującym się u dołu obrazu. Istnieje możliwość przecięcia tego pola do danej lokalizacji na obrazie.
3. Aby dodać kolejną linię, kliknij przycisk Annotation (Adnotacja) i ponownie wybierz symbol linii. Następna linia zostanie wyświetlona w innym kolorze z przypisaną jej literą umieszczoną obok. Na każdym obrazie istnieje możliwość wykonania maksymalnie czterech pomiarów liniowych.
4. Aby usunąć linię, wybierz linię lub pomiar linii. Wybierz symbol X obok odpowiedniego pomiaru, a następnie wybierz Delete Line (Usuń linię), aby zatwierdzić.

Wykonywanie pomiaru powierzchni

1. Wybierz przycisk **Elipsa** .
2. Wybierz i przeciągnij ikony wskaźnika pomiaru w celu wyskalowania i obrotu elipsy. Pole z obwodem i obszarem elipsy (wyświetlanymi odpowiednio w centymetrach i centymetrach kwadratowych) wyświetlane jest u dołu obrazu. Istnieje możliwość przecięcia tego pola do danej lokalizacji na obrazie.
3. Aby usunąć elipsę, wybierz elipsę lub jej pomiar, a następnie zaznacz symbol X obok odpowiedniego wskaźnika pomiaru. Wybierz Delete Ellipse (Usuń elipsę), aby zatwierdzić.

Dodawanie adnotacji do obrazów lub klipów w rolce przechwyconych obrazów


1. Po przechwyceniu obrazu lub pliku filmowej kliknij na  w prawym górnym rogu ekranu badania.
2. Kliknij obraz lub klip, który chcesz opatrzyć adnotacją.
3. Kliknij „Edytuj”.
4. Wybierz „Etykietowanie przechwyconego obrazu”.
5. Kliknij „Aa”, a następnie kliknij wstępnie zdefiniowaną etykietę albo wpisz własną.
6. Przenieś etykiety w odpowiednie miejsce na obrazie.
7. Kliknij „Zapisz”

7.2. Korzystanie z protokołów

Dzięki protokołom Butterfly można obserwować popularne rodzaje badań i z łatwością oznaczać przechwycone obrazy w określonych widokach. Protokoły wraz ze stosownymi ustawieniami wstępnymi są dostępne poniżej:

- Protokół badania płuc:
 - Ustawienie wstępne badania płuc
 - Ustawienie wstępne badania płuc u dzieci
- Protokół badania aorty
 - Ustawienia wstępne badania tętnicy głównej i pcherzyka płucowego
 - Ustawienie wstępne badania jamy brzusznej
 - Ustawienie wstępne badania głębokiego jamy brzusznej
- Protokół kardiologiczny
 - Ustawienie wstępne badania kardiologicznego
 - Ustawienie wstępne badania głębokiego kardiologicznego
 - Ustawienie wstępne badania kardiologicznego u dzieci
- Protokół eFAST
 - Ustawienie wstępne FAST
 - Ustawienie wstępne badania jamy brzusznej
 - Ustawienie wstępne badania głębokiego jamy brzusznej
- Protokół DVT
 - Ustawienie wstępne badania żył głębokich

Dodawanie etykiet za pośrednictwem protokołów



1. Na ekranie obrazowania wybierz odpowiednie ustawienie wstępne.
2. Otwórz menu Czynności  i naciśnij przycisk danego protokołu. Na ekranie pojawi się opcja wyboru widoku wyświetlająca odpowiednie widoki dla tego protokołu.
3. Wybierz widok, który chcesz poddać obrazowaniu.
4. Etykieta pojawi się automatycznie u dołu ekranu obrazowania dla wybranego widoku.
5. Nagraj film lub przechwyń nieruchomy obraz.
6. Po przechwyceniu obrazu funkcja umożliwiająca wybór widoku wyświetli się ponownie. Znacznik wyboru wskazuje, że obraz został już przechwycony i oznaczony etykietą.
7. Stuknij dany widok, aby kontynuować etykietowanie.



UWAGA

Wszystkie widoki protokołów są opcjonalne. Możesz wybrać dowolny widok, w tym już ten przechwycony, jeżeli chcesz przechwytać wiele obrazów w tym widoku.

Edytowanie etykiety widoku protokołu

1. Stuknij etykietę widoku, aby aktywować jej edycję. Obok etykiety pojawia się symbol ołówka .
2. Aby przesunąć etykietę widoku, przeciągnij ją w dane miejsce, gdy funkcja edytowania jest włączona.
3. Aby zmienić widok, kliknij symbol ołówka . Funkcja umożliwi wybór widoku wyświetli się ponownie, co pozwoli wybrać nowy widok.

Zamknięcie protokołu

Protokół badania można zamknąć w następujący sposób:

1. Klikaj c „Zamknij przepływ pracy” w zakładce umożliwiającej wybór widoku
2. Zmieniaj c ustawienia wstępne
3. Przesyłanie badania
4. Stukaj c symbol „X” obok przycisku „Protokół”



UWAGA

Po zamknięciu protokołu obrazy przechwycone za jego pomocą pozostają zapisane w rolce przechwyconych obrazów, co umożliwia ich przeglądanie i przesłanie. Niemniej jednak dane dotyczące wyboru widoku zostaną zresetowane.

8. Pakiety obliczeń r cznych

Niniejszy rozdział zawiera informacje i instrukcje dotyczące korzystania z różnych dostępnych pakietów obliczeniowych za pomocą Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 urządzenia i aplikacji mobilnej.






UWAGI

- W zależności od platformy, sprzętu, kraju i rodzaju subskrypcji niektóre ustawienia wstępne oraz funkcje mogą być niedostępne.
- Urządzenie Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 i jego akcesoria mogą być używane wielokrotnie u wielu pacjentów.

8.1. Obliczenia poło nicze

Wykonywanie obliczeń w badaniu poło niczym

1. Na ekranie skanowania wybierz ustawienie wstępne OB1/GYN lub ustawienie wstępne OB2/3.
2. Wybierz menu Actions (Czynności)  w prawym dolnym rogu ekranu.
3. W zakładce „Obliczenia” w ustawieniu wstępnym OB1/GYN dostępne są: pakiety do określenia wymiaru ciemieniowo-poładkowego oraz średniej średnicy pcherzyka ciowego. W ustawieniu wstępnym OB2/3 znajdują się pakiety do określenia indeksu płynu owodniowego oraz danych biometrycznych płodu. Wybierz opcję, z której chcesz skorzystać.
4. Do tych obliczeń można użyć dowolnego trybu obrazowania innego niż tryb M. Po wyświetleniu obszaru zainteresowania, wybierz przycisk zamrożenia .
5. Dotknij menu Czynności  na dole ekranu. Dostępne będą nowe narzędzia pomiarowe odpowiadające dostępnym danym wejściowym do pakietów obliczeniowych.
6. Wybierz dany pomiar, a wskaźniki pomiaru (liniowe lub eliptyczne) pojawią się na ekranie badania.
 - a. W pakiecie przeznaczonym do obliczania danych biometrycznych płodu dostępne pomiary obejmują wymiar dwuciemieniowy główki (BPD), obwód główki (HC), obwód brzuszka (AC) i długość kości udowej płodu (FL).
 - b. W pakiecie obliczeniowym przeznaczonym do określenia indeksu płynu owodniowego dostępne pomiary to Q1, Q2, Q3 i Q4.
 - c. W pakiecie przeznaczonym do obliczenia odległości ciemieniowo-poładkowej dostępne pomiary to CRL1, CRL2 i CRL3.
 - d. W pakiecie do obliczania średniej średnicy pcherzyka ciowego dostępne pomiary to GSD1, GSD2 i GSD3.
7. Wyreguluj odpowiednio wskaźniki pomiaru. Po regulacji wskaźników pomiaru nastąpi dostosowanie się etykiety pomiaru w celu pokazania danych wejściowych, oraz, w stosownych przypadkach, wieku ciowego (GA).

8. Po umieszczeniu wskaźników pomiaru, wybierz przycisk potwierdzenia, aby dodać pomiar do raportu i przechylić obraz.
9. Pomiar można usunąć przed potwierdzeniem lub odmroźeniem, wybierając „x” obok etykiety pomiaru lub ikon kosza w raporcie.
10. Można dodać wyłącznie jeden rodzaj danych wejściowych. Aby edytować dane wejściowe, usuń je z raportu i dokonaj ponownego pomiaru.

11. W każdym pakiecie obliczeniowym można uzyskać dostęp do raportu obliczeniowego podczas zamknięcia ekranu badania.
12. W przypadku pakietu przeznaczanego do obliczania parametrów biometrycznych płodu raport zawiera:
 - a. AUA: średni wiek cięży na podstawie badania ultrasonograficznego według formuły Hadlocka
 - b. EDD (przybliżona data porodu) według formuły Hadlocka: oszacowanie przewidywanego terminu porodu według formuły Hadlocka
 - c. EFW (przybliżona waga płodu): szacowana waga płodu obliczona według formuły Hadlocka
 - d. Pomiarowe dane wejściowe odpowiadające wiekowi cięży (GA)
 - e. Daty zgłoszone przez pacjenta
13. W przypadku pakietu przeznaczanego do określenia indeksu płynu owodniowego raport zawiera:
 - a. AFI: wskaźnik ilości płynu owodniowego
 - b. Dane wejściowe służące do wykonania pomiaru
 - c. Daty zgłoszone przez pacjenta
14. W przypadku pakietu przeznaczanego do określenia odległości ciemieniowo-podłaskowej raport zawiera:
 - a. Wiek cięży
 - b. Dane wejściowe służące do wykonania pomiaru
 - c. Daty zgłoszone przez pacjenta
15. W pakiecie średniej średnicy pcherzyka cięgowego elementy raportu to:
 - a. Wiek cięgowy obliczony na podstawie wymiarów średniej średnicy pcherzyka cięgowego
 - b. Przewidywana data porodu określana na podstawie wymiarów średniej średnicy pcherzyka cięgowego



UWAGA


Wymiary średniej średnicy pcherzyka cięgowego nie mogą stanowić jedyne go wskaźnika określającego przewidywaną datę porodu.


16. Po przesłaniu badania następuje zamknięcie pakietu obliczeniowego stosowanego w badaniu położniczym. Aby wyjść z pakietu obliczeniowego przeznaczanego do badania położniczego jeszcze przed przesłaniem badania, wybierz X u dołu ekranu lub wejdź w menu Actions (Czynności) i zamknij, klikając X znajdujący się poniżej. Zostanie wyświetlony komunikat o potwierdzenie eksportu lub usunięcia zarejestrowanych pomiarów, jeżeli zamykasz narzędzie za pomocą menu Actions (Czynności) lub przycisku u dołu ekranu.
17. Po wyeksportowaniu określonego pakietu obliczeniowego dane wejściowe będą dostępne w polu notatek badania. Dane te można pobrać i edytować w rolce badania przed jego przesłaniem. Po przesłaniu badania notatki pozostają dostępne w archiwum i chmurze.

8.2. R czne obliczenie obj to ci

Pakiet przeznaczony do ręcznego obliczania objętości można wykorzystać do wygenerowania pomiaru objętości przy użyciu metody wydołu jednej elipsoidy. Funkcja ta wykorzystuje wzór $0,52 * (D1) * (D2) * (D3)$ w celu obliczenia objętości.

R czne obliczanie obj to ci

1. Na ekranie skanowania wybierz jedno z następujących ustawień: jama brzuszna, jama brzuszna: głębia pcherz, MSK—tkanka miękką, mięśniowo-szkieletowy, nerwowy lub małe narządy.
2. Wybierz przycisk Actions (Czynności)  w prawym dolnym rogu ekranu.
3. W zakładce „Obliczenia” wybierz opcję Obj to obliczona ręcznie.

4. Po zidentyfikowaniu widoku, który chcesz przechwycić, wybierz przycisk zatrzymania, aby zamrozić obraz.
5. Dotknij przycisku Czynności  na dole ekranu
6. Wybierz jeden z przycisków pomiaru, aby rozpocząć pomiar. Dostępne są trzy opcje: D1, D2 lub D3.
7. Wyreguluj odpowiednio wskaźniki pomiaru. Po regulacji wskaźników pomiaru nastąpi dostosowanie się etykiety pomiaru w celu przedstawienia danych wejściowych.
8. Po umieszczeniu wskaźników pomiaru, wybierz przycisk potwierdzenia, aby dodać pomiar do raportu i przechwycić obraz.
9. Można dodać wyłącznie jeden rodzaj danych wejściowych. Aby edytować dane wejściowe, usuń je z raportu i dokonaj ponownego pomiaru.
10. Pomiar będzie widoczny u dołu ekranu. Po wykonaniu wszystkich trzech pomiarów u dołu ekranu wyświetli się szacunkowa obj to .
11. Pomiar można usunąć przed potwierdzeniem lub odmrozić, wybierając „X” obok etykiety pomiaru lub ikon kosza w raporcie.
12. Po przesłaniu badania nastąpi zamknięcie pakietu obliczeniowego. Aby zamknąć pakiet obliczeniowy jeszcze przed przesłaniem badania, wybierz X u dołu ekranu lub wejdź w menu Actions (Czynności) i zamknij, klikając X znajdujący się poniżej. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie eksportu lub usunięcia zarejestrowanych pomiarów, jeżeli zamykasz narzędzie za pomocą menu Actions (Czynności) lub przycisku u dołu ekranu.



UWAGA



Po zamknięciu pakietu obliczeniowego nie ma możliwości edycji danych wejściowych.

13. Po wyeksportowaniu określonego pakietu obliczeniowego przeznaczonego do wskazania obj to ci dane wyjściowe będą dostępne w polu notatek badania. Dane te można pobrać i edytować w rolce badania przed jego przesłaniem. Po przesłaniu badania notatki pozostają dostępne w archiwum i chmurze.

8.3. Obliczanie obj to ci oł dka

Funkcja obliczania obj to ci oł dka pozwala użytkownikowi ocenić obj to treść ci oł dkowej.

Ręczne obliczanie obj to ci oł dka

1. Na ekranie skanowania wybierz ustawienie wstępne Jama brzuszna, Jama brzuszna: gł. b. lub Jama brzuszna u dzieci.
2. Wybierz przycisk Actions (Czynności)  w prawym dolnym rogu ekranu.
3. W zakładce „Obliczenia” wybierz opcję **Obj to oł dka**.
4. Po zidentyfikowaniu widoku, który chcesz przechwycić, wybierz przycisk zatrzymania, aby zamrozić obraz.
5. Dotknij przycisku Czynności  na dole ekranu
6. Wybierz przycisk pomiaru, aby rozpocząć pomiar. Będzie miało miejsce wybranie redniej rednicy przednio-tylnej (MAD) i czaszkowo-bocznej (MCD) oraz wieku.
7. Wyreguluj odpowiednio wskaźniki pomiaru. Po regulacji wskaźników pomiaru nastąpi dostosowanie się etykiety pomiaru w celu przedstawienia danych wejściowych.
8. Po umieszczeniu wskaźników pomiaru, wybierz przycisk potwierdzenia, aby dodać pomiar do raportu i przechwycić obraz.
9. Można dodać wyłącznie jeden rodzaj danych wejściowych. Aby edytować dane wejściowe, usuń je z raportu lub ekranu i dokonaj ponownego pomiaru.
10. Pomiar będzie widoczny u dołu ekranu. Po wykonaniu wszystkich trzech pomiarów u dołu ekranu wyświetli się szacunkowa obj to .

11. Pomiar można usunąć przed potwierdzeniem lub odmroeniem, wybierając symbol „x” obok etykiety pomiaru lub ikon kosza w raporcie.
12. Po przesłaniu badania następuje zamknięcie pakietu obliczeniowego obrotów. Aby zamknąć pakiet obliczeniowy jeszcze przed przesłaniem badania, wybierz X u dołu ekranu lub wejdź w menu Actions (Czynności) i zamknij, klikając X znajdujący się poniżej. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie eksportu lub usunięcia zarejestrowanych pomiarów, jeżeli zamykasz narzędzie za pomocą menu Actions (Czynności) lub przycisku u dołu ekranu.



UWAGA

Podczas zamknięcia pakietu obliczeniowego obrotów nie ma możliwości edycji danych wejściowych.

13. Po wyeksportowaniu określonego pakietu obliczeniowego przeznaczonego do wskazania obrotów dane wyjściowe będą dostępne w polu notatek badania. Dane te można pobrać i edytować w rolce badania przed jego przesłaniem. Po przesłaniu badania notatki pozostają dostępne w archiwum i chmurze.



UWAGA



Podczas obliczania obrotów uywane są następujące dwa równania w zależności od wieku:

Tabela 7. Równania obrotów

Zakres wieku	Równanie
>= 18 lat	obrotów (ml) = 27 + 14 * (MAD * MCD * pi / 4) - 1,28 * Wiek (w latach)
4-18 lat	obrotów (ml) = -7,8 + 3,5 * (MAD * MCD * pi / 4) + 0,127 * wiek (w miesiącach)

8.4. Obliczanie redukcji tętnicy tęczowej szyjnej

Mierz pełną tętnicę tęczową szyjną i tętnicę drożną, można obliczyć redukcję tętnicy tęczowej szyjnej, a następnie wykorzystać ten wynik do określenia procentowej redukcji tętnicy tęczowej lub dowolnego innego naczynia.

1. Na ekranie skanowania wybierz opcję "Badanie naczyniowe: tętnica szyjna".
2. Wybierz przycisk Actions (Czynności)  w prawym dolnym rogu ekranu.
3. W sekcji „Obliczenia” wybierz opcję **Redukcja tętnicy lewej** lub **Redukcja tętnicy prawej**. Oba narzędzia działają w ten sam sposób, z tym, że jedno automatycznie oznacza przechwycone obrazy jako „Lewe”, a druga jako „Prawe”.
4. Najlepsze efekty można uzyskać, wykonując zdjęcie w widoku poprzecznym.
5. Po zamroeniu odpowiedniego widoku wybierz przycisk Czynności  na dole ekranu.
6. Można wybrać opcję tętnica tęczowa (AD), aby zmierzyć pełną tętnicę tęczową lub tętnicę wiatła (LD), aby zmierzyć tętnicę drożną czy tętnicę.
7. Ustaw odpowiednio suwaki i wybierz „Potwierdź”. Po potwierdzeniu następuje automatyczne przechwycenie obrazu, a pomiar zostaje dodany do sekcji notatek bieżącego badania.
 - a. Aby usunąć pomiar, wybierz etykiety, a następnie wybierz „x”.
 - b. Aby edytować pomiar, usuń go z raportu i dodaj ponownie, wykonując powyższe kroki.
8. Po dodaniu obu pomiarów u dołu ekranu pojawi się szacunkowa redukcja tętnicy.
9. Po przesłaniu badania zamknij pakiet przeznaczony do obliczania redukcji tętnicy. Aby zamknąć pakiet obliczeniowy przed przesłaniem badania, zaznacz „x” obok opcji „Redukcja tętnicy lewej” lub „Redukcja

rednicy prawej” na dole ekranu badania. Zostanie wy wietlony monit o potwierdzenie eksportu lub usuni cia przechwyconych pomiarów w przypadku zamkni cia pakietu przed przestaniem badania.



UWAGA

Po zamkni ciu pakietu obliczeniowego redukcji rednicy t tniczy szyjnej nie ma mo liwo ci edycji danych wej ciowych.

- Po wyeksportowaniu wyników obliczenia redukcji rednicy dane wyj ciowe b d dost pne w polu notatek badania. Dane te mo na pobra i edytowa na ekranie badania przed przestaniem.



UWAGA



Narz dzie obliczania redukcji rednicy t tniczy szyjnej wykorzystuje wzór:

$$\text{Redukcja rednicy (procentowo)} = (1 - LD / AD)$$

8.5. R czne obliczanie k tów

Pakiet r cznego obliczania k tów (alfa/beta) mo e by u ywany do obliczania k ta ostrego mi dzy dwiema prostymi (k t mniejszy ni 90 stopni).

R czne obliczanie k tów

- Z ekranu badania wybierz ustawienie wst pne przeznaczone do badania układu mi niowo-szkieletowego.
- Wybierz przycisk Czynno ci  w prawym dolnym rogu ekranu.
- Pod nagłówkiem „Obliczenia” wybierz opcj „Prawo — alfa/beta” albo „Lewo — alfa/beta”. Strony prawa i lewa ułatwiają oznaczenie strony ciała. Poza t ró nic oba narz dzia działaj w ten sam sposób.
- Po zidentyfikowaniu widoku, który chcesz przechwyci , wybierz przycisk zatrzymania, aby zamrozi obraz.
- Ponownie dotknij przycisku Czynno ci  w prawym dolnym rogu ekranu.
- Wybierz jeden z pomiarów, aby rozpoc . Dost pne opcje to: **Linia bazowa**, **Linia alfa** i **Linia beta**. W celu pełnego obliczenia k ta (alfa lub beta) nale y wstawi **lini bazow** i **lini alfa** lub **lini bazow** i **lini beta**.
- Wyreguluj odpowiednio wska niki pomiaru. Po wyregulowaniu wska ników pomiaru, je li wybrano zarówno **lini bazow** , jak i jedn z dwóch pozostałych linii, nast pi dostosowanie etykiety pomiaru w celu przedstawienia obliczonego k ta.
- Po umieszczeniu wska ników pomiaru, wybierz przycisk potwierdzenia, aby doda pomiar do raportu i przechwyci obraz.
- Teraz mo na ustawi wska nik dla kolejnego k ta.
- Mo na doda wył cznie jeden rodzaj danych wej ciowych. Aby edytowa dane wej ciowe, usu je z raportu i dokonaj ponownego pomiaru.
- Pomiary b d widoczne u dołu ekranu.
- Pomiar mo na usun przed potwierdzeniem lub odmro eniem, wybieraj c symbol „x” obok etykiety pomiaru lub ikon kosza w raporcie. Po odblokowaniu lub wybraniu innego obrazu z bufora filmu zostanie wy wietlony monit o wyeksportowanie wyniku do sekcji notatek.
- Po przestaniu badania nast puje zamkni cie pakietu obliczeniowego k ta. Aby zamkn pakiet obliczeniowy jeszcze przed przestaniem badania, wybierz symbol „x” u dołu ekranu lub przejd do menu Czynno ci i zamknij pakiet, klikaj c symbol „x” znajduj cy si poni ej. W przypadku zamykania narz dzia za pomoc menu Czynno ci lub przycisku u dołu ekranu zostanie wy wietlony monit o potwierdzenie eksportu lub usuni cia zarejestrowanych pomiarów.

14. Po wyeksportowaniu określonego pakietu obliczeniowego karta danych wyjściowych dostępna w polu notatek badania. Dane te można pobrać i edytować w rolce badania przed jego przesłaniem. Po przesłaniu badania notatki pozostają dostępne w archiwum i chmurze.



UWAGA

Jeśli istnieją dwie linie, jedna o współrzędnych $(x00, y00)$ i $(x01, y01)$ i druga o współrzędnych $(x10, y10)$ i $(x11, y11)$, kąt ostrości między tymi dwiema liniami obliczany jest następująco:

$$Dx0 = x00 - x01$$

$$Dy0 = y00 - y01$$

$$Dx1 = x10 - x11$$

$$Dy1 = y10 - y11$$

$$L0 = \sqrt{Dx0^2 + Dy0^2}$$

$$L1 = \sqrt{Dx1^2 + Dy1^2}$$

$$\text{Kąt} = \arccos\left(\frac{Dx0 * Dx1 + Dy0 * Dy1}{L0 * L1}\right) * 180 / \pi$$

8.6. Materiały referencyjne do pakietów obliczeniowych

1. Wiek ciąży i szacunkowa masa płodu na podstawie biometrycznych wymiarów płodu
 - a. Hadlock FP, Deter RL, Harrist RB, Park SK. Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters. *Radiology*. 1984 Aug;152(2):497-501.
 - b. Hadlock FP, Harrist RB, Carpenter RJ, Deter RL, Park SK. Sonographic estimation of fetal weight. The value of femur length in addition to head and abdomen measurements. *Radiology*. 1984 Feb;150(2):535-4.
 - c. Anderson NG, Jolley IJ, Wells JE. Sonographic estimation of fetal weight: comparison of bias, precision and consistency using 12 different formulae. *Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: The Official Journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology*. 2007 Aug;30(2):173-9.
2. Wskaźnik ilości płynu owodniowego
 - a. Phelan JP, Ahn MO, Smith CV, Rutherford SE, Anderson E. Amniotic fluid index measurements during pregnancy. *The Journal of reproductive medicine*. 1987 Aug;32(8):601-4.
3. Odległość ciemieniowo-pośladkowa
 - a. Hadlock FP, Shah YP, Kanon DJ, Lindsey JV. Fetal crown-rump length: reevaluation of relation to menstrual age (5-18 weeks) with high-resolution real-time US. *Radiology*. 1992 Feb;182(2):501-5.
4. średnica przedniej części szyi
 - a. Daya S, Woods S, Ward S, Lappalainen R, Caco C. Early pregnancy assessment with transvaginal ultrasound scanning. *CMAJ*. 1991 Feb 15;144(4):441-6. PMID: 1993291; PMCID: PMC1452794.
 - b. Equation for gestational age in days: $(0.882(GS1+GS2+GS3)/3)+ 33.117$
5. Objętość pęcherza — elipsoida wydłużona
 - a. Dicuio M, Pomara G, Menchini Fabris F, Ales V, Dahlstrand C, Morelli G. Measurements of urinary bladder volume: comparison of five ultrasound calculation methods in volunteers. *Archivo Italiano di Urologica e Andrologica*. 2005 Mar;77(1):60-2.
 - b. Wzór na objętość elipsoidy wydłużonej: $\text{objętość} = 0,52 * (D1) * (D2) * (D3)$.
6. Objętość okrągła

- a. Objętość dka w przypadku osób ≥ 18 lat: Van de Putte, P., i A. Perlas. „Ultrasound assessment of gastric content and volume”. *British Journal of Anaesthesia* 113.1 (2014): 12-22.
 - b. Objętość dka w przypadku osób w wieku 4–18 lat: Miller, Andrew F., et al. „Does Point-of-Care Gastric Ultrasound Correlate With Reported Fasting Time?”. *Pediatric Emergency Care* 37.12 (2021): e1265-e1269.
7. Redukcja średnicy tętnicy szyjnej
- a. Larsson, Annika C., i Stefan Rosfors. „Diameter-based measurements of the degree of carotid artery stenosis using ultrasonography”. *Clinical Physiology and Functional Imaging* 41.2 (2021): 217-220.

9. Korzystanie z narz dzia Needle Viz™(w płaszczy nie)



OSTRZE ENIE!


Zastosowanie wył cznie narz dzia igły Viz (w płaszczy nie) NIE poprawi wizualizacji igieł wprowadzonych poza płaszczyzn .

Narz dzie Needle Viz (w płaszczy nie) pozwala na o y obraz w trybie B zoptymalizowany w zakresie wizualizacji igieł wprowadzonych pod k tem 20-40 stopni na powierzchni zwykłego trybu B. Obszar zainteresowania, w którym igła mo e by wizualizowana, reprezentuje niebieski kolor, a poło enie obszaru zainteresowania (ROI) mo na regulowa za pomoc przycisku przeł czania.

Narz dzie igły Viz (w płaszczy nie) jest dost pne w jednym z ustawie wst pnych przeznaczonych do badania układu mi niowo-szkieletowego, tkanek mi kkich, nerwów oraz naczy .

Korzystaj c z narz dzia igły Viz (w płaszczy nie) mo na:

- Dostosuj gł boko naprowadzania igły oraz wzmocnienie
- Dostosuj gł boko badania
- Dostosuj wzmocnienie igły
- Wł cz tryb Biplane Imaging

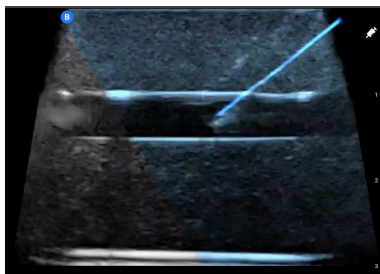

Korzystanie z narz dzia igły Viz (w płaszczy nie)

Aby zacz korzystać z narz dzia igły Viz (w płaszczy nie):



UWAGA

Korzystaj c z narz dzia Needle Viz (w płaszczy nie) w trybie Biplane Imaging, pozycja igły w płaszczy nie prostopadłej jest pod wietlona tylko wtedy, gdy igła jest widoczna w płaszczy nie odniesienia, a zatem w linii rodkowej płaszczyzny prostopadłej. Igła b dzie widoczna w płaszczy nie prostopadłej, ale nie zostanie pod wietlona, je li nie nast pi jej uwidocznienie w płaszczy nie odniesienia.

1. Na ekranie badania wybierz jedno z ustawie wst pnych przeznaczonych do badania układu mi niowo-szkieletowego, tkanek mi kkich, nerwów lub naczy .
2. Wybierz przycisk Actions (Czynno ci) w prawym dolnym rogu ekranu.
3. W zakładce „Narz dzia” wybierz opcj Needle Viz (w płaszczy nie).
4. U dołu ekranu wybierz opcj „Od lewej” lub „Od prawej”, aby wskaza kierunek naprowadzania igły.

5. Na dole ekranu wybierz 40°, 30° lub 20°, aby dostosować kąt na podstawie kąta naprowadzania igły.
6. Aby dostosować wzmocnienie igły, przesuwaj palcem w prawo lub w lewo na ekranie. Jeśli chcesz dostosować wzmocnienie obrazu, zamknij narzędzie Needle Viz, dostosuj wzmocnienie stosownie do potrzeb, a następnie ponownie włóż narzędzie Needle Viz.
7. Aby jednocześnie korzystać z trybu Biplane Imaging, aktywuj tryb Biplane za pomocą menu czynności. W płaszczyźnie odniesienia widoczny będzie obszar zainteresowania, w obrębie którego igła w płaszczyźnie zostanie podświetlona. Dodatkowo, jeśli igła przekroczy wskaźnik płaszczyzny prostopadłej, pozycja igły w projekcji poza płaszczyznę będzie wyświetlana na płaszczyźnie prostopadłej. Aby korygować pozycję obszaru zainteresowania, stuknij przycisk odwracania.

10. Korzystanie z ustawienia wst pnego Igła: poza płaszczyzn (tylko iQ3)



NOTATKI

W zależności od platformy, sprz tu, kraju i rodzaju subskrypcji niektóre ustawienia wst pne oraz funkcje mog by niedost pne.



UWAGI

- Sprawdź , czy rozumiesz orientacj płaszczyzny skanowania, przyciskaj c palec do sondy głowicy przed wprowadzeniem igły. Aktywna strefa skanowania w tym ustawieniu wst pnym ró ni si od innych ustawie wst pnych, gdy płaszczyzna skanowania jest przesuni ta w stron przycisków głowicy.
- Ustawienie wst pne Igła: poza płaszczyzn jest przeznaczone wył cznie do procedur wprowadzania igieł poza płaszczyzn . Nie jest przeznaczone do wprowadzania igieł w płaszczy nie i nie poprawia widoczno ci igły w płaszczy nie.


Ustawienie wst pne Igła: poza płaszczyzn umo liwia wcze niej sz wizualizacj igły podczas wykonywania wkłu igł poza płaszczyzn , zwanych równie wkłuwaniem w osi krótkiej. Odbywa si to poprzez przesuni cie aktywnej płaszczyzny skanowania od rodka sondy głowicy w stron przycisków głowicy.

Aby u y tego ustawienia wst pnego, nale y wybra opcj Igła: poza płaszczyzn z menu ustawie wst pnym. Domy lna płaszczyzna skanowania dla tego ustawienia wst pnego jest ustawiona w kierunku przycisku głowicy Butterfly iQ3 i nie mo na jej przesun . Płaszczyzna skanowania wróci do poło enia centralnego po wybraniu innego ustawienia wst pnego.

W sekcji ustawienia wst pnego Igła: poza płaszczyzn :

- Wł cz kolorowego Dopplera
- Wł cz Dopplera mocy
- Wł cz lini rodkow
- Optymalizuj wzmocnienie i gł boko
- Przechwytywa filmy i obrazy
- Wykonuj pomiary odległo ci na wy wietlaczu

Je li potrzebujesz dalszych wskazówek dotycz cych ruchu płaszczyzny skanowania, u y rozwijanej karty referencyjnej w prawym dolnym rogu ekranu skanowania, aby wy wietli diagram.

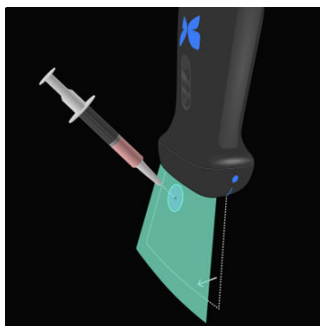

11. Korzystanie z ustawienia wst pnego Przechylenie pod wyrostkiem mieczykowatym (tylko iQ3)




NOTATKI


W zale no ci od platformy, sprz tu, kraju i rodzaju subskrypcji niektóre ustawienia wst pne oraz funkcje mog by niedost pne.

Ustawienie wst pne Przechylenie pod wyrostkiem mieczykowatym przechyla płaszczyzn skanowania o 20° wzgl dem przycisków głowicy Butterfly iQ3, aby ułatwi uzyskanie widoku pod wyrostkiem mieczykowatym. Przechylona płaszczyzna skanowania jest stała i nie mo na jej regulowa . Płaszczyzna skanowania wróci do poło enia centralnego po wybraniu innego ustawienia wst pnego.

Aby u y tego ustawienia wst pnego:

1. Uzyskaj dost p do ustawie wst pnych Sercowy lub Szybkie
2. Dotknij przycisku  na ekranie skanowania, aby przeł cza si mi dzy ustawieniami wst pnymi w rodzinie ustawie wst pnych.
3. Po wybraniu ustawienia Przechylenie pod wyrostkiem mieczykowatym mo na przechwytywa zdj cia, filmy i pomiary liniowe. W tym ustawieniu wst pnym nie s dost pne adne dodatkowe tryby.

Je li potrzebujesz dalszych wskazówek dotycz cych ruchu płaszczyzny skanowania, u yj rozwijanej karty referencyjnej w prawym dolnym rogu ekranu skanowania, aby wy wietli diagram.

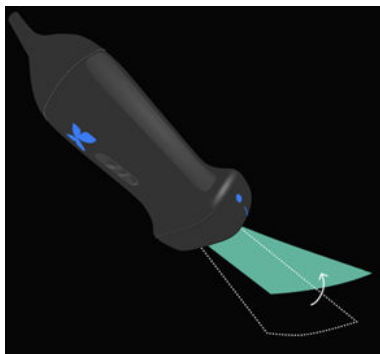

12. Narzędzia wspomagające AI

Niniejszy rozdział zawiera informacje i instrukcje dotyczące korzystania z narzędzi wspomaganych AI (sztucznej inteligencji) z systemem Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3.



UWAGI

- W zależności od platformy, sprzętu, kraju i rodzaju subskrypcji niektóre ustawienia wstępne oraz funkcje mogą być niedostępne.
- Urządzenie Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 i jego akcesoria mogą być używane wielokrotnie u wielu pacjentów.

12.1. Automatyczny licznik linii B Butterfly



UWAGI

- W zależności od platformy, sprzętu, kraju i rodzaju subskrypcji niektóre ustawienia wstępne oraz funkcje mogą być niedostępne.
- Urządzenie Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 i jego akcesoria mogą być używane wielokrotnie u wielu pacjentów.

Omówienie

Automatyczny licznik linii B umożliwia wtykownikom automatyczne zliczanie liczby linii B obecnych w przestrzeni płuc podczas korzystania z wstępnego ustawienia badania płuc. Automatyczny licznik linii B wykorzystuje metodę Instant Percent³ do obliczania maksymalnej liczby linii B obecnych w pojedynczej klatce sekwencji obrazów.

Przeciwwskazania


Nie stosować w obszarach płuc zawierających duży wysięk opłucnowy. Nie stosować u pacjentów pediatrycznych (w wieku poniżej 22 lat).

Kompatybilność


Automatyczny licznik linii B jest obsługiwany na wszystkich urządzeniach Butterfly iQ/ iQ+ kompatybilnych z systemami iOS i Android w obsługiwanych wersjach systemu operacyjnego.

Dostęp do automatycznego licznika linii B

Dostęp do automatycznego licznika linii B można uzyskać w ustawieniu wstępnym badania płuc podczas skanowania w trybie B.

1. W menu ustawień wstępnych wybierz ustawienie wstępne „Płuca”.
2. Stuknij przycisk **Działania**  znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu.
3. Wyświetlony zostanie ekran działania w zakresie badania płuc.

³Anderson et al, “Inter-rater reliability of quantifying pleural B-lines using multiple counting methods,” J. Ultrasound Med. 2013; 32:115–120

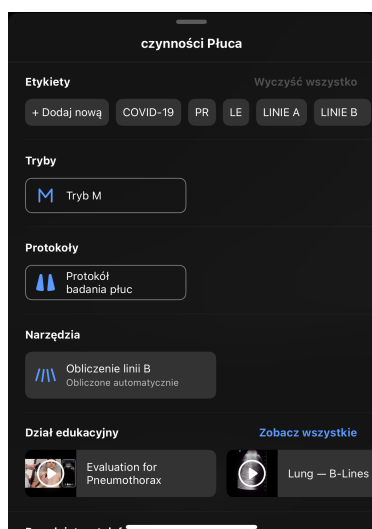


4. Wybierz opcję licznika linii B z menu Działania w pozycji Narzędzia.



UWAGA

Jeśli po raz pierwszy korzystasz z narzędzia linii B, wyświetlona zostanie podpowiedź z instrukcjami dotyczącymi korzystania.

5. Automatyczny licznik linii B można wyłączyć, stukając w **X** u dołu ekranu, gdy narzędzie jest aktywne lub **X** w menu Działania.

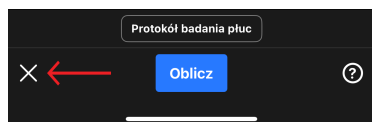


Obliczanie liczby linii B



UWAGA

Aby uzyskać ogólne wskazówki dotyczące korzystania z automatycznego licznika linii B, w tym informacje na temat prawidłowego pozycjonowania głowicy, stuknij w przycisk „?” w prawym dolnym rogu ekranu.

1. Wybierz opcję licznika linii B z sekcji menu Działania w ustawieniach wstępnym Płuca.
2. Ustaw sondę tak, aby przestrzeń między brzością a plecami a linia opłucnej znajdowała się na środku ekranu.

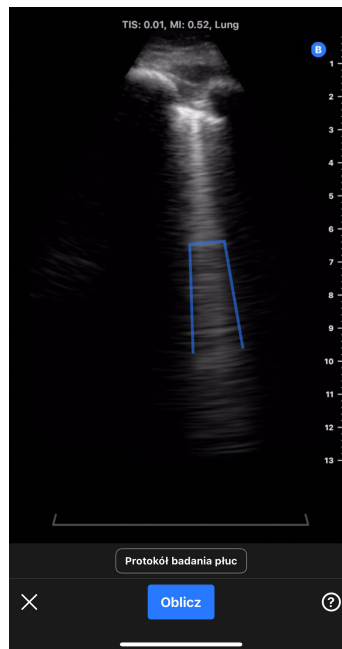


- W dolnej części ekranu wyświetlany jest statyczny, 30-stopniowy wskaźnik sektora przestrzeni między łebrowej podświetlony obszar obrazu, w którym zostanie zmierzona liczba linii B.
- Wzmocnienie obrazu można regulować, przesuwać palcem w lewo lub w prawo na obrazie.
- Głębokość obrazu można regulować, przesuwać obraz w górę i w dół. Głębokość obrazu nie może być ustawiona na mniej niż 8 cm podczas korzystania z automatycznego licznika linii B.
- Lokalizację wykrytych linii B są wyświetlane w czasie rzeczywistym za pomocą niebieskich linii nałożonych na obraz. Pojedyncza niebieska linia reprezentuje dyskretną linię B, a niebieski nawias podświetla obszary zbiegających się linii B.




UWAGA


Wizualizacje lokalizacji linii B nie powinny być wykorzystywane do podejmowania decyzji klinicznych.

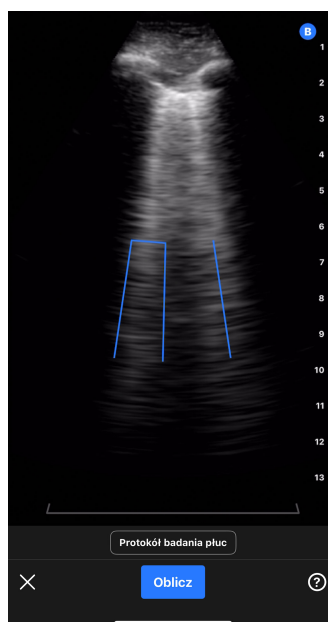


3. Wybierz liczbę .
 - a. Zostanie zarejestrowana 6-sekundowa sekwencja obrazów. W lewym dolnym rogu ekranu pojawi się licznik czasu. Nie poruszaj głowicą podczas nagrywania.
 - b. Po zarejestrowaniu obrazu urządzenie przygotuje obraz i wskaże, czy automatyczne zliczanie linii B powiodło się .
4. Automatyczny licznik linii B pomyślnie oblicza liczbę linii B
 - a. Automatyczna liczba linii B jest wyświetlana w dolnej części ekranu.
 - i. Liczba linii B reprezentuje maksymalną liczbę linii B występujących w pojedynczej klatce sekwencji obrazów. Automatyczny licznik linii B analizuje wszystkie klatki sekwencji obrazów, aby określić maksymalną liczbę . (Uwaga: wiele ramek może mieć maksymalną liczbę linii B).
 - ii. Wyświetlana liczba to 0, 1, 2, 3, 4 lub >5.
 - b. Kreska nad liczbą linii B wyświetla obrazy i zidentyfikowane linie B.

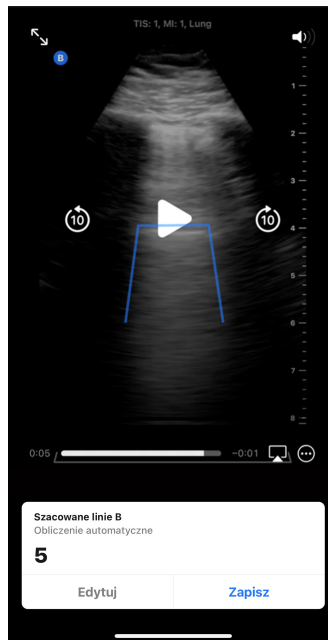

- i. Nagrana sekwencja obrazów będzie odtwarzana w pełni. Sekwencję obrazów można wstrzymać i ręcznie przejrzeć klatki, dotykając ekranu i używając elementów sterujących odtwarzaniem na ekranie.
- ii. Zidentyfikowane linie B zostaną wyróżnione niebieskimi liniami na odpowiadającym im zarejestrowanym obrazie. Pojedyncza linia reprezentuje dyskretną linię B, a nawias podświetla obszary zbiegających się linii B. Lokalizacje linii B są prezentowane użytkownikowi w formie wizualizacji, aby pokazać, w jaki sposób uzyskano liczbę linii B i nie powinny być wykorzystywane do podejmowania decyzji klinicznych.

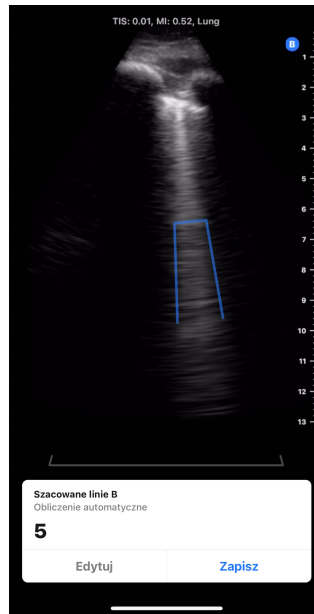

- c. Zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby uzyskać informacje na temat edytowania liczby linii B, zapisywania lub usuwania sekwencji obrazów.
5. *Automatyczny licznik linii B nie oblicza pomylonych liczb linii B*
 Automatyczny licznik linii B ma możliwość identyfikowania sekwencji obrazów, które nie są odpowiednie do automatycznego obliczenia linii B przez narzędzie w oparciu o wewnętrzny kontrolny algorytm.
- a. W takim przypadku wyświetlony zostanie komunikat wyjątkowy, a narzędzie nie było w stanie uzyskać automatycznego zliczenia linii B (patrz zrzut ekranu poniżej). Ponadto automatyczna liczba linii B będzie wyświetlana jako „N/A”. Naciśnięcie przycisku Kontynuuj spowoduje przejście do ekranu wyników, na którym można następnie dodać liczbę za pomocą przycisku Edytuj.

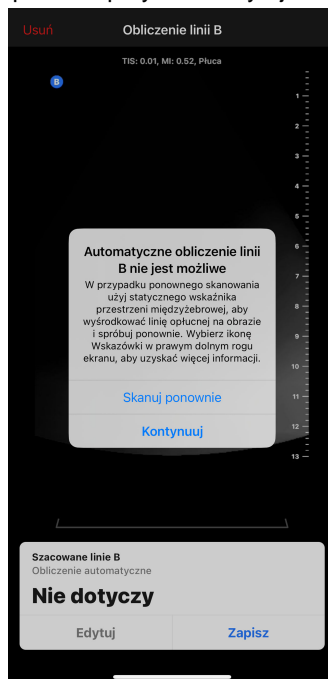


- b. Aby ponownie zeskanować /powtórzyć pomiar,
- i. naciśnij przycisk „Skanuj ponownie” w wyskakującym oknie.

- ii. Urządzenie powróci do ekranu głównego automatycznego licznika linii B, na którym można powtórzyć kroki obliczania liczby linii B, w tym nagranych sekwencji obrazów.
- c. Aby wykonać jakkolwiek inną czynność, w tym wprowadzić ręczną liczbę linii B, zapisać sekwencję obrazów lub ją usunąć, naciśnij przycisk „Kontynuuj” w wyskakującym okienku.


Edytowanie automatycznej liczby linii B

Automatyczne zliczanie linii B dla nagranej sekwencji obrazów można edytować ręcznie, wykonując poniższe czynności.


1. Naciśnij przycisk „Edytuj” w wyskakującym oknie szacowanych linii B

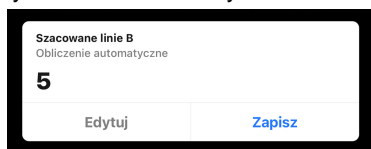


2. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję „Edytuj liczbę”

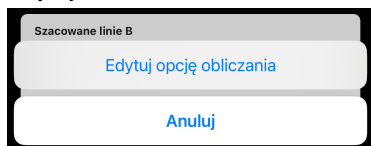

3. Wybierz daną liczbę linii B za pomocą selektora. Dostępne opcje ręcznej edycji to 0, 1, 2, 3, 4, 5 i >5.

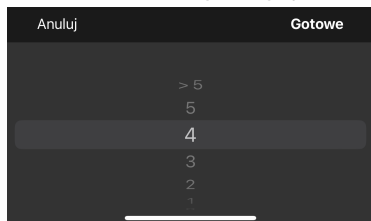

4. Jeśli liczba linii B jest edytowana ręcznie,
 - a. zostanie ona oznaczona jako Liczenie ręczne w wyskakującym okienku szacowanych linii B.
 - b. Wszelkie niebieskie linie wskazujące lokalizację linii B zostaną usunięte.

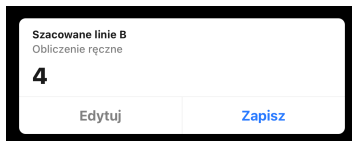

5. Wynik można przełączyć z powrotem na automatyczne zliczanie, naciskając ponownie przycisk Edytuj i wybierając opcję Przywróć liczenie ręczne.


Zapisywanie lub usuwanie nagranej sekwencji obrazów

Nagrane sekwencje obrazów i liczba linii B mogą zostać zapisane na rolce lub usunięte.

1. Aby zapisać :
 - a. Naciśnij przycisk „Zapisz” w wyskakującym oknie szacowanych linii B.
 - b. Po zapisaniu pojawi się wyskakujące okienko z informacją, że sekwencja obrazów została zapisana na rolce badania.
2. Aby usunąć :
 - a. Naciśnij „Usuń” w lewym górnym rogu ekranu.
 - b. Urządzenie zasygnalizuje usunięcie linii, a następnie powróci do ekranu głównego automatycznego licznika linii.

Korzystanie z automatycznego licznika linii B z protokołem płuc

Protokół płuc może być używany z narzędziem automatycznego licznika linii B, aby pomóc w oznaczaniu stref płuc skanowanych przez użytkownika. Aby włączyć protokół badania płuc, kliknij przycisk Protokół płuc znajdujący się nad niebieskim przyciskiem „Licznik”. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z protokołu badania płuc, zapoznaj się z sekcją „Korzystanie z protokołów”.

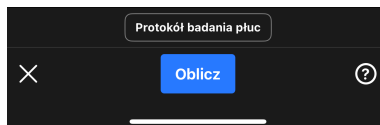


Wskazówki dotyczące narzędzia dla użytkownika

Wskazówki dotyczące automatycznego licznika linii B zapewniają zakładki informacyjne z krótkimi, statycznymi, znormalizowanymi informacjami na temat prawidłowego umieszczenia głowicy i sposobu korzystania z narzędzia. Użytkownicy korzystający po raz pierwszy z automatycznego licznika linii B są automatycznie informowani o wskazówkach dotyczących narzędzia po wybraniu opcji „Licznik linii B” z menu czynności w ustawieniach wstępnym badaniu płuc. Podczas korzystania z automatycznego licznika linii B w dowolnym momencie można uzyskać dostęp do wskazówek poprzez wybranie przycisku ? w prawym dolnym rogu ekranu.




Umieść iQ na pacjencie.

- Skieruj niebieski wskaźnik w stronę głowy pacjenta.
- Umieść iQ w obrębie prawej środkowej linii obojczykowej umieszczonej w przestrzeni międzyżebrowej.
- Przesuń iQ wzdłuż długiej osi w kierunku przestrzeni międzyżebrowej, wyśrodkowując linię optyczną między żebrem a cieniem.




Wybierz strefy do skanowania.

Włącz Protokół do badania płuc, aby uzyskać wskazówki dotyczące stref. Wybierz strefy, których obraz chcesz przechwycić.



Zobacz linie B w wykrywalnym obszarze strefy żebrowej.

Obszar żeber jest pokazany w szarym, poziomym nawiasie u dołu ekranu. Linie B są wykrywane tylko w tej przestrzeni.



Naciśnij przycisk „Oblicz”, aby uzyskać maksymalną liczbę linii B.

Obliczenie linii B trwa 6 sekund. Utrzymuj iQ stabilnie do zakończenia badania.

Dokładność i ograniczenia automatycznego licznika linii B

Automatyczny licznik linii B wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia się, które zostały przeszkolone na tysiącach sekwencji obrazów z setek obiektów w Stanach Zjednoczonych. Następujące filtry kryteriów włączenia i wykluczenia zostały zastosowane przy wyborze i selekcji zbiorów danych do opracowania i walidacji klinicznej.

- Wykorzystano tylko obrazy wykonane przy użyciu standardowego ustawienia badania płuc.
- Wykorzystano tylko istotne klinicznie sekwencje obrazów o głębokości 8 cm lub większej.
- Badania z wysiakiem płucnym zostały wykluczone ze zbioru danych.

Automatyczny licznik linii B wykorzystuje metodę Instant Percent⁴ w celu obliczenia największej liczby linii B w przestrzeni międzyżebrowej w dowolnym momencie w zarejestrowanej sekwencji obrazów. Metoda ta zlicza liczbę linii B w przestrzeni żebera w następujący sposób:

⁴Anderson et al, „Inter-rater reliability of quantifying pleural B-lines using multiple counting methods”, J. Ultrasound Med. 2013; 32:115–12

- Dyskretne linie B są liczone jako 1.
- Zbiór linii B są liczone jako procent przestrzeni zebra wypełnionej zbiorami liniami B podzielony przez 10. Na przykład, jeżeli 40% miejsca na ekranach jest wypełnione, liczba ta wyniesie 4.
- Liczba linii B w dowolnym momencie/dowolnej klatce jest sumą spójnych linii B i dyskretnych linii B.

Algorytm analizuje wszystkie klatki w sekwencji obrazów i określa maksymalną liczbę linii B w sekwencji w zapłnieniu. Ta maksymalna liczba jest wyświetlana użytkownikowi jako liczba linii B dla danej linii. (Uwaga: może być wiele klatek w sekwencji obrazów może mieć maksymalną liczbę linii B).

Automatyczny licznik linii B ma możliwość identyfikowania sekwencji obrazów, które nie są odpowiednie do automatycznego obliczania linii B w oparciu o wewnętrzny kontroler jakości. W takim przypadku narządzie zwróci wartość „N/A”. Może się to zdarzyć na przykład wtedy, gdy linia opłucnej znajduje się poza polem widzenia. Oprócz adekwatności obrazu, na dokładność zliczania linii B mogą również wpływać umiejętności operatora.

Testowanie wydajności

Przeprowadzono dwa badania walidacyjne w celu oceny, czy wydajność automatycznego licznika linii B nie była gorsza w porównaniu z wynikami klinicznych specjalistów (oznaczone jako Badanie 1 i Badanie 2). Obrazy zebrane do tych badań reprezentują szeroki i rozproszony przekrój pacjentów, w tym zróżnicowany zakres liczby linii B, wieku, płci, wskaźnika masy ciała, pochodzenia etnicznego i rasy⁵

Badanie 1 – opis: Celem badania 1 było wykazanie, że automatyczny licznik linii B nie jest gorszy od wyników klinicznych specjalistów (dane oparte na dowodach empirycznych). Głównym punktem porównawczym był współczynnik korelacji miary dzyrasowej (ICC) między wynikami linii B z narzędzia automatycznego licznika linii B a wynikami linii B z opartymi na dowodach empirycznych. Drugim punktem porównawczym był współczynnik podobieństwa Sørensen'a miary segmentacji sparowanej z centroidem z narzędzia automatycznego licznika linii B a segmentacją danych opartych na dowodach empirycznych. Badanie 1 było retrospektywną analizą pozbawionych danych identyfikujących sekwencji obrazów USG płuc zebranych podczas standardowego użytkowania produktów Butterfly iQ i Butterfly iQ+, przesłanych do Butterfly Cloud. Dane te pochodzą od grupy dostawców korzystających z urządzenia Butterfly w pełnym zakresie z aplikacji Butterfly Cloud w świecie rzeczywistym. Zbiór danych walidacji klinicznej składa się z 253 pozbawionych danych identyfikujących sześć sekundowych sekwencji obrazów ze 109 odcinków klinicznych. Dane pochodziły od pacjentów w wieku od 22 do 90 lat z równomiernym rozkładem płci.

Badanie 2 – opis: Ocena wydajności klinicznej algorytmu automatycznego licznika linii B była dodatkowym badaniem walidacyjnym mającym na celu wykazanie możliwości uogólnienia algorytmu licznika w odpowiednich kategoriach demograficznych pacjentów. Głównym celem tego badania było wykazanie, że wydajność algorytmu automatycznego licznika linii B nie jest gorsza od zgodnej interpretacji lekarza (dane oparte na dowodach empirycznych). Drugim celem tego badania była ocena działania algorytmu w różnych podgrupach pod względem wieku, płci, BMI, pochodzenia etnicznego i rasy. Głównym punktem porównawczym był współczynnik korelacji miary dzyrasowej (ICC) między narzędziem automatycznego licznika linii B a wartościami danych oparte na dowodach empirycznych. Badanie 2 było retrospektywną analizą danych wtórnych pozbawionych danych identyfikujących sekwencji obrazów USG płuc i informacji demograficznych pacjenta zebranych z jednego odcinka podczas badania zatwierdzonego przez IRB. Dane zebrano od pacjentów w wieku 22 lat lub starszych, którzy wyrazili zgodną na udział w badaniu i zostali włączeni na podstawie historii ich przyjęcia na oddział opieki ogólnej, telemetrii lub umiarkowanej opieki z objawami klinicznymi obejmującymi obrzęk płuc. Wszyscy pacjenci włączeni do badania zostali poddani badaniu ultrasonograficznemu płuc za pomocą systemu Butterfly iQ/ iQ+ do badań ultrasonograficznych z ustawieniem wstępnym „Płuca”. Wszystkie sekwencje obrazów zostały zapisane w chmurze Butterfly Cloud. Dane od 97 osób zostały przetworzone na sekwencje obrazów. Zebrane dane demograficzne bez cech umiarkowanych identyfikacji obejmowały wiek, płeć, wzrost i wagę (dla BMI), pochodzenie etniczne i rasę; zostały one podsumowane w poniższej tabeli.

⁵Definicja i podział na pochodzenie etniczne i rasę zgodne ze standardami Urzędu ds. Administracji i Budownictwa: Standardy klasyfikacji danych federalnych dotyczących rasy i pochodzenia etnicznego (9 czerwca 1994 r.) i wymogami ustawy o bezpieczeństwie i innowacyjności FDA (ustawa publiczna nr 112-114 (9 lutego 2012 r.) SEC. 907. ZGŁASZANIE WŁĄCZENIA PODGRUP DEMOGRAFICZNYCH DO BADAŃ KLINICZNYCH I ANALIZY DANYCH WE WNIOSKACH DOTYCZĄCYCH LEKÓW, PRODUKTÓW BIOLOGICZNYCH I WYROBÓW.

Tabela 8. Podział demograficzny badania 2, n=97

Kategoria	Liczba uczestników
Wiek (w latach)	
22 - 42	12
42 - 62	31
62 - 82	45
82 - 90	9
Płeć	
Mężczyzna	41
Kobieta	56
BMI	
<25 kg/m ²	27
25-30 kg/m ²	22
30 kg/m ² lub więcej	48
Pochodzenie etniczne⁵	
Latynos lub Latynoska	2
NIE Latynos lub Latynoska	91
Nieznane / Nie zgłoszono	4
Rasa⁵	
Rdenni mieszkańcy Ameryki/Alaski	1
Osoby czarnoskóre lub Afroamerykanie	22
Biała	73
Nieznane / Nie zgłoszono	1

Wydatki licznika linii B: W obu badaniach obliczono współczynnik korelacji między osobową (ICC) między przewidywaniami liczby linii B obliczonej przez automatyczny licznik linii B a wartościami danych opartymi na dowodach empirycznych. Dane oparte na dowodach empirycznych zostały zdefiniowane jako mediana 9 wyników klinicznych specjalistów na tym samym zestawie sekwencji obrazów. Oba testy przekroczyły cel wydajnościowy, jakim było wykazanie ICC powyżej dolnej granicy 0,75. Docelowa wydajność została określona na podstawie opublikowanej literatury ⁶.

	Kryteria akceptacji	ICC	95% CI
Wyniki badania 1	ICC > 0,75	0.899	[0,867, 0,92]
Wyniki badania 2		0.85	[0,78, 0,90]

Analiza podgrupy liczby linii B (badanie 2)

W badaniu 2 oceniono możliwość uogólnienia automatycznego licznika linii B w szerokim zakresie klinicznie istotnych podgrup pacjentów (wiek, płeć, BMI, pochodzenie etniczne i rasa). Narzędzie działało podobnie we wszystkich podgrupach.

Wydatki wizualizacji linii B (inaczej segmentacji linii B): Korzystając wyłącznie z badania 1, stopień nakładania się lokalizacji linii B został oceniony przy użyciu współczynnika Sørensen (DSC) między segmentacją sparowaną z centroidem z narzędzia automatycznego licznika linii B a segmentacją danych opartymi na dowodach empirycznych. Dane oparte na dowodach empirycznych dla segmentacji linii B zostały określone na podstawie 7 wyników klinicznych specjalistów. DSC obliczono między linią B zidentyfikowaną przez narzędzie a linią B danych opartymi na dowodach empirycznych, które całkowicie lub częściowo pokrywały się lub przylegały do siebie bez nakładania się. Badanie 1 przekroczyło cel wydajnościowy, jakim było wykazanie, że DSC był równy lub większy niż 0,52. Docelowa wydajność została zaczerpnięta z opublikowanej literatury ⁷.

⁶Podjęcie to jest zgodne z analizą algorytmu licznika linii B opartego na AI/ML opisanego w Moore et al., „Interobserver Agreement and Correlation of an Automated Algorithm for B-Line Identification and Quantification With Expert Sonologist Review in a Handheld Ultrasound Device”, J Ultrasound Med 2021.

	Kryteria akceptacji	DSC	95% CI
Wyniki badania 1	DSC 0,52	0.82	[0,78, 0,876]

12.2. Automatyczne oszacowanie frakcji wyrzutowych





UWAGA


Narzędzie do pomiaru frakcji wyrzutowej metodą Simpsona nie jest dostępne w Stanach Zjednoczonych.

Narzędzie EF Simpsona pozwala oszacować frakcję wyrzutową lewej komory serca podczas badania kardiologicznego w projekcji koniuszkowej 4-jamowej. Butterfly iQ wykorzystuje jednopłaszczyznowy metodę Simpsona⁸ metoda obliczania frakcji wyrzutowej.

Korzystanie z narzędzia do automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej

1. Wybierz ustawienie wstępne przeznaczone do badania serca.
2. Wybierz przycisk Actions (Czynności)  u dołu ekranu.
3. W zakładce Narzędzia wybierz opcję oceny EF metodą Simpsona.





4. Ekran Record an Apical 4 Chamber (Nagraj projekcję koniuszkową 4-jamową) jest wyświetlany wraz ze wskazówkami edukacyjnymi u dołu ekranu. Wytyczne te wykorzystują skalę od czerwonej do zielonej , przy czym zielony kolor oznacza obraz wysokiej jakości. Ustaw głowicę tak, aby uzyskać wysokiej jakości projekcję koniuszkową 4-jamową.




⁷Pochodzi z dwóch artykułów: 1) Mason, Harry i in. „Lung Ultrasound Segmentation and Adaptation between COVID-19 and Community-Acquired Pneumonia”, 2021 r., zaakceptowany na warsztatach MICCAI ASMUS (<https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.03138>). 2) Roy, S. i in., „Deep Learning for Classification and Localization of COVID-19 Markers in Point-of-Care Lung Ultrasound”, w IEEE Transactions on Medical Imaging, tom 39, nr 8, s. 2676-2687, sierpień 2020 r., doi: 10.1109/TMI.2020.2994459




⁸Lang i in., J. Am. Soc. Echocardiography, 2005: 1440-63. Oszacowania punktów bazowych zastawki mitralnej (środek lewej komory) i punktu wierzchołka (najdalszy punkt na masce segmentacyjnej od punktu środkowego). Te dwa punkty definiują oś, wokół której wykonujemy integrację dysku. Zgodnie z konwencją należy użyć 20 dysków.

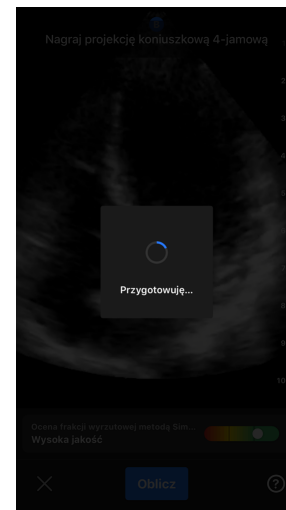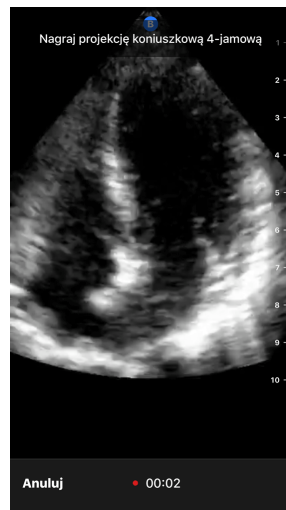5. Wybierz opcję Calculate (Oblicz) i stabilnie trzymaj głowicę. Nastąpi automatyczne nagranie 3-sekundowego klipu.


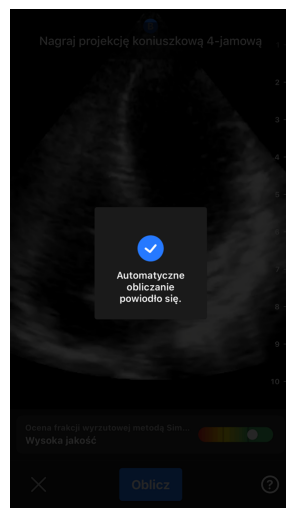


6. Jeśli ocena frakcji wyrzutowej jest możliwa za pomocą narzędzia, nastąpi automatyczne obliczenie EF, wyświetlony zostanie ekran z wynikiem pomiaru frakcji wyrzutowej. Pomiar frakcji wyrzutowej jest oznaczony jako pomiar dokonany automatycznie za pomocą metody Simpsona. Można zapisać wynik automatycznego pomiaru, edytować go i obliczyć ponownie lub usunąć wynik oraz pliki filmowe.





7. Jeśli za pomocą narzędzia nie można obliczyć frakcji wyrzutowej lub chcesz edytować wynik, nastąpi przekierowanie do ekranu Edit (Edytuj). Za pomocą tego ekranu można dostosować fazę końcowo-rozkurczową serca (ED).
- Przewieś list ramek w dolnej części ekranu, aby uzyskać dostęp do odpowiedniej ramki dla ED.
 - Aby przesunąć ogólną pozycję konturu w wybranego do pomiaru komorowego, naciśnij i przeciągnij biały punkt zakotwiczenia . Zwolnij punkt zakotwiczenia, gdy kontur znajdzie się w odpowiedniej pozycji.
 - Aby zmienić pozycje boków konturu w wybranych do pomiaru komorowego, naciśnij i przeciągnij niebieskie koło wskazujące punkt dostosowania  wokół konturu. Zwolnij punkt dostosowania, gdy kontur znajdzie się w odpowiedniej pozycji.
 - Aby zmienić położenie wierzchołka konturu, naciśnij i przeciągnij pasek dostosowania wierzchołka  u góry konturu. Zwolnij pasek dostosowania wierzchołka, gdy kontur znajdzie się w odpowiedniej pozycji.

- e. Po zakończeniu edycji wybierz opcję Update ED (Aktualizuj ED).

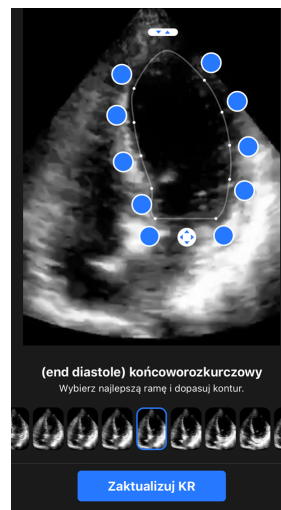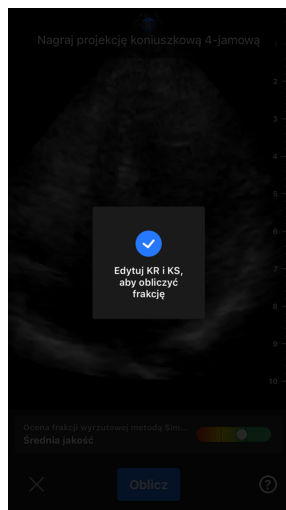

8. Postępuj tak samo jak powyżej dla fazy końcowo-skurczowej End Systole (ES) i zaznacz Update ES (Aktualizuj ES) po zakończeniu. Zostanie wyświetlony ekran wyniku oceny frakcji wyrzutowej, a obliczona frakcja wyrzutowa będzie oznaczona jako pomiar wykonany ręcznie metodą Simpsona.

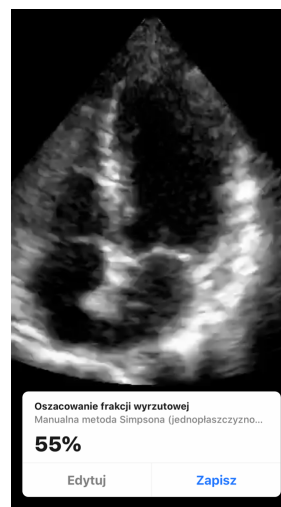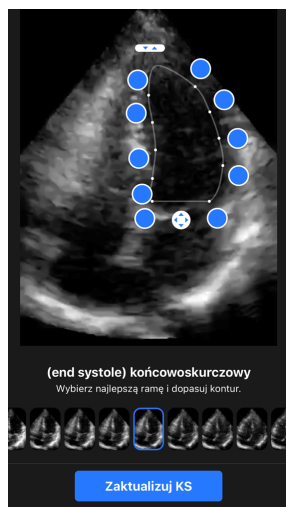

9. Jeśli wybierzesz opcję Save (Zapisz) w celu zapisania pomiaru, przechwycona 3-sekundowa pętla filmu z oszacowanymi frakcjami wyrzutów i związanymi z nimi konturami ED i ES lewej komory zostanie zapisana w Capture Reel (Rolce przechwyconych obrazów). Wybranie opcji Usuń usuwa zarówno wynik frakcji wyrzutowej, jak i 3-sekundową pętlę filmu użytą do obliczenia wyniku.

12.3. Automatyczne oszacowanie objętości serca

Wskazania do stosowania

Narzędzie przeznaczone do automatycznego pomiaru objętości serca to pakiet aplikacji. Jest ono przeznaczone do przeglądania, ilościowego określenia i raportowania wyników uzyskanych za pomocą systemu ultradźwiękowego Butterfly Network. Służy do nieinwazyjnych pomiarów objętości serca moczowego mających na celu uzupełnienie diagnozy lekarskiej. Wskazany do stosowania w populacji osób dorosłych.


Przeciwwskazania


Narzędzie to nie jest przeznaczone do stosowania u kobiet w ciąży lub dzieci ani pacjentów z wodobrzuszem lub pacjentów z otwartymi ranami bądź ranami w okolicy nadłonowej.

Obliczanie obj to ci p cherza


Narzędzie do automatycznego pomiaru obj to ci p cherza⁹ pozwala obliczyć obj to p cherza za pomocą ustawienia wstępnego przeznaczonego do badania p cherza w trybie B. System Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 umożliwia uzyskanie zakresu obrazu 3D, gdy głowica jest trzymana stabilnie. Następnie szacowana obj to jest obliczana na podstawie tego zakresu obrazu 3D.

Dostęp do narzędzia „Automatyczne obliczenie obj to ci p cherza” z poziomu ustawienia wstępnego

1. Stuknij ikon Actions (Czynności)  znajdując się w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Wybierz opcję Obj to p cherza.

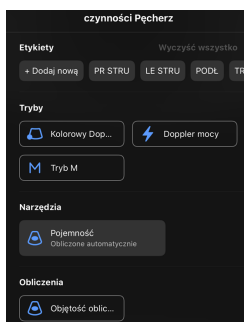


3. Dotknij X, aby wyłączyć narzędzie Automatycznie obliczona obj to p cherza.




Obliczanie obj to ci p cherza




UWAGA



Aby uzyskać pomoc w zakresie korzystania z narzędzia przeznaczonego do automatycznego obliczania obj to ci p cherza, w tym informacje o prawidłowym ustawieniu głowicy, wybierz  w prawym dolnym rogu ekranu.

1. Wybierz opcję **Obj to p cherza** z menu Actions (Czynności) w ustawieniu wstępnym przeznaczonym do badania p cherza.
2. Ustaw głowicę tak, aby p cherz był widoczny od najszerzej strony i znajdował się na środku ekranu. Gdy narzędzie „Automatycznie obliczona obj to p cherza” wykryje p cherz, zostanie wyróżniony niebieski kształt, a rodek niebieskiego kształtu zostanie oznaczony symbolem . Aby ułatwić wyrodkowanie obrazu p cherza, użyj linii pionowej na środku ekranu.

⁹Ronneberger, Olaf, Philipp Fischer i Thomas Brox. „U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation”. Międzynarodowa konferencja nt. obrazowania medycznego i interwencji wspomaganej komputerowo. Springer, Cham, 2015.

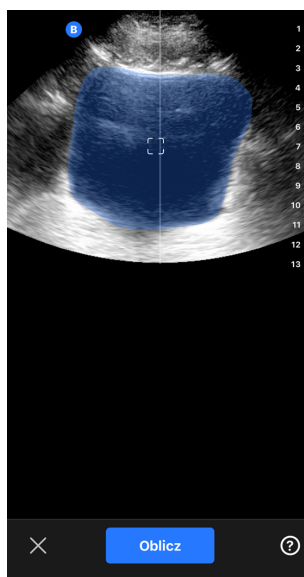


- Wybierz opcj **Oblicz**. Zakres obrazu 3D obszaru p cherza zostanie pobrany automatycznie. Nie ruszaj głowic podczas przemieszczania.
- Po pomy lnym przechwyceniu obrazu p cherza obj to zostanie wy wietlona u dołu ekranu. Film nad wynikiem obj to ci b dzie przedstawiał obrazy i szacowan wielko p cherza u yt do obliczenia obj to ci.

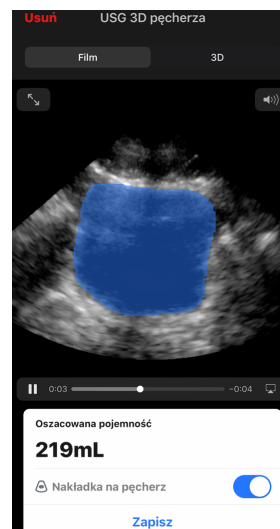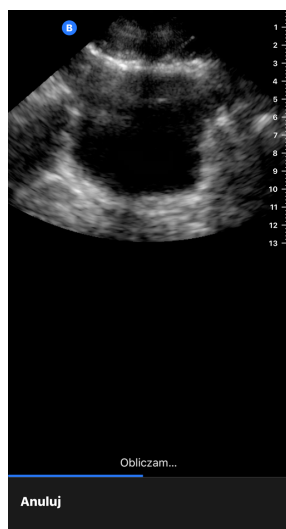

UWAGA

Niebieskie wyró nienie p cherza mo na wył czy , dotykaj c przeł cznika Nakładka na p cherz.

- Wybierz pasek 3D, aby zwizualizowa interaktywny render 3D p cherza.

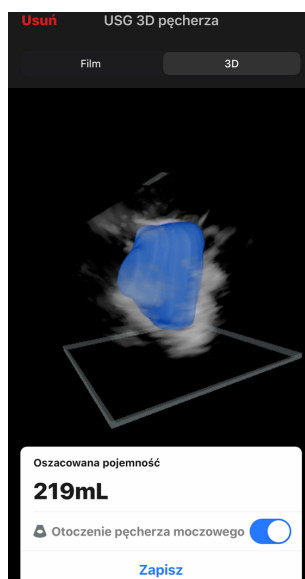


UWAGA

Render 3D nie jest przeznaczony do zastosowań diagnostycznych.

Zapisywanie automatycznego oszacowania objętości pęcherza

Narzędzie do automatycznego pomiaru objętości pęcherza umożliwia zapisanie wyniku oszacowanej objętości do wglądu w aplikacji mobilnej Butterfly iQ oraz Butterfly Cloud.

1. Wybranie opcji Zapisz u dołu ekranu wyniku Objętość pęcherza. Przechwycona płata filmu z oszacowaną objętością pęcherza i obrys pęcherza zostaną zapisane w Capture Reel (Rolce przechwyconych obrazów).

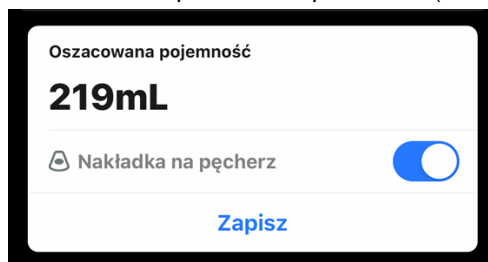

UWAGA

Wybranie opcji Usuń usuwa zarówno wynik objętości pęcherza, jak i filmy użyte do obliczenia wyniku.

Wskazówki dotyczące narzędzia dla użytkownika

Użytkownicy, którzy po raz pierwszy korzystają z narzędzia do automatycznego pomiaru objętości pęcherza mają dostęp do wskazówek dotyczących korzystania z tego narzędzia. Do tych zakładek informacyjnych użytkownik narzędzia w dowolnym momencie może uzyskać dostęp, wybierając opcję ⓘ podczas użytkowania narzędzia.

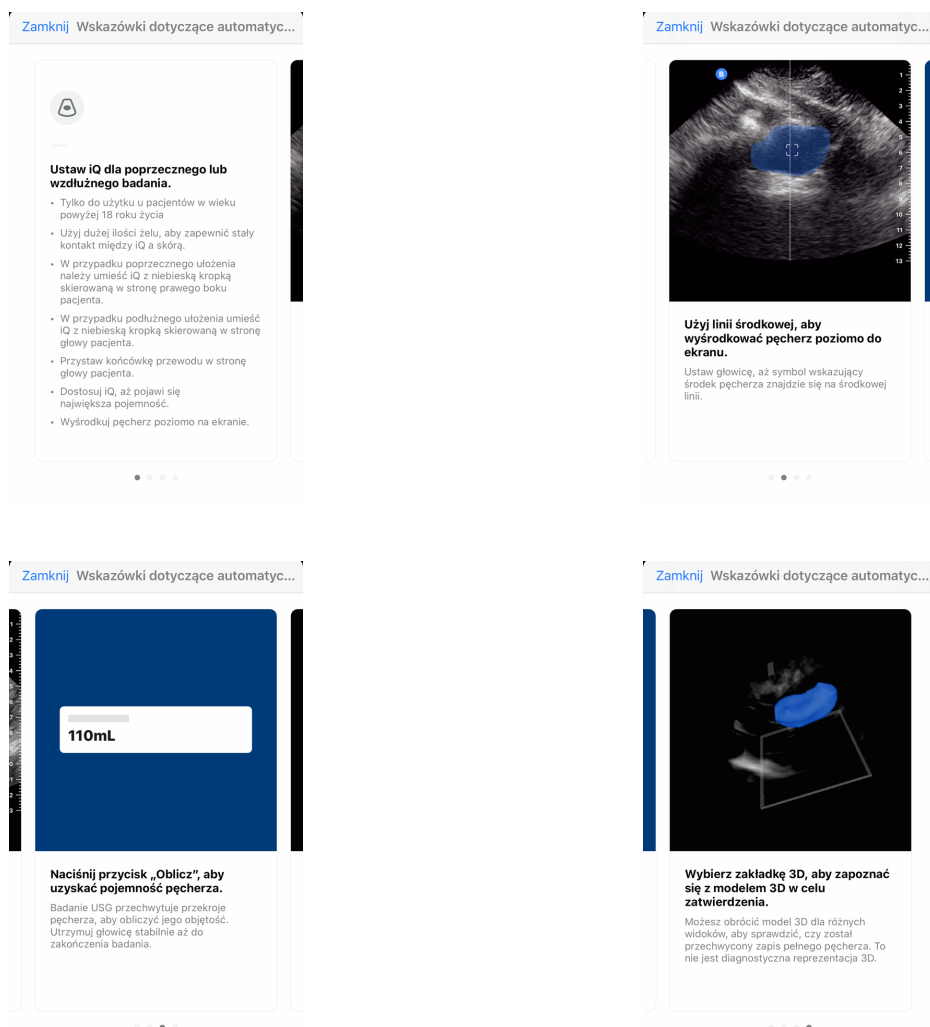


Tabela 9. Dokładność pomiaru objętości

Zakres objętości	Parametr
0-100mL	±7.5 mL
101-740 mL	±7.5 %

- W danych dotyczących dokładności pomiarów przyjęto założenie, że narzędzie jest używane do badania fantomu równoważnego tkance zgodnie z dyspozycją.
- Zakres objętości narzędzia 3D do automatycznego pomiaru objętości pęcherza wynosi 0–740 ml. Mimo że istnieje możliwość oszacowania i wyświetlenia wikszej objętości, Butterfly Network nie może zagwarantować dokładności pomiarów poza podanym zakresem.

12.4. Butterfly iQ Wskazówki edukacyjne dotyczące projekcji



PRZESTROGA!

Wskazówki edukacyjne dotyczące projekcji służą wyłącznie do celów edukacyjnych. Nie są przeznaczone do użytku klinicznego lub diagnostycznego.




UWAGA

Wskazówki edukacyjne dotyczące projekcji nie są dostępne w Stanach Zjednoczonych.


Narzędzia w ramach Wskazówek edukacyjnych dotyczących projekcji zapewniają użytkownikom wizualne wskazówki jako części obrazu podczas badania za pomocą Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3. Narzędzia w ramach Wskazówek edukacyjnych dotyczących projekcji są przeznaczone do następujących projekcji:

- Projekcji koniuszkowej 4-jamowej
- Projekcja przymostkowa w osi długiej serca
- Projekcja przymostkowa w osi krótkiej serca
- Projekcji linii A i linii B płuc


Podczas badania narzędzie zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat jakości obrazu za pomocą skali od czerwonej do zielonej. Kolor zielony wskazuje obraz o wysokiej jakości . Wskazuje odsetek ekspertów, którzy oceniliby obraz jako mierzalny.

Dostęp do Wskazówek edukacyjnych dotyczących projekcji



Narzędzia w ramach Wskazówek edukacyjnych dotyczących projekcji są dostępne w ustawieniach wstępnych do badania serca lub płuc podczas badania w trybie B.

Wybierz przycisk Actions (Czynności)  znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Możesz wybrać następujące narzędzia w ramach Wskazówek edukacyjnych dotyczących projekcji:

- Ustawienie wstępne do badania serca: projekcja koniuszkowa 4-jamowa, projekcja przymostkowa w osi długiej i projekcja przymostkowa w osi krótkiej.
- Ustawienie wstępne do badania płuc: linie A i linie B.

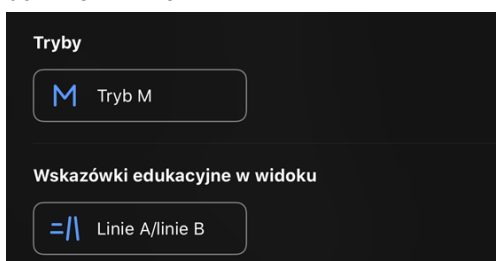

Narzędzia w ramach Wskazówek edukacyjnych dotyczących projekcji można wyłączyć, stukając przycisk X podczas badania w trybie B lub za pomocą menu Actions (Czynności).

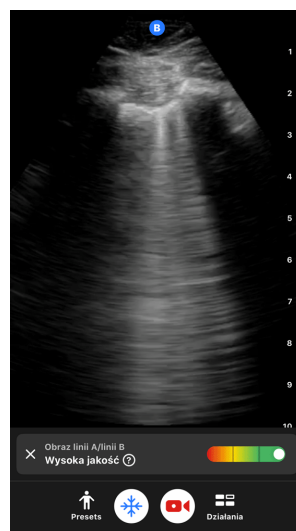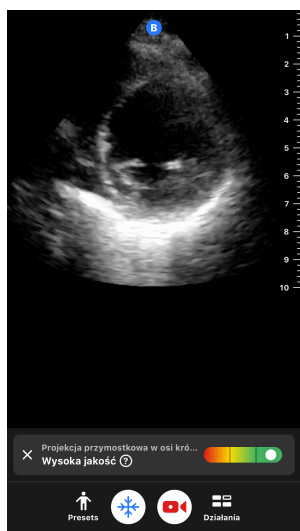

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wskazówek edukacyjnych dotyczących projekcji oraz zgodnie z procedurą, wejdź na support.butterflynetwork.com.

13. Użytkowanie Butterfly Cloud

Niniejszy rozdział zawiera informacje i instrukcje dotyczące korzystania z Butterfly Cloud w celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do badań ultradźwiękowych przesłanych z aplikacji Butterfly iQ.



UWAGA

Twoja organizacja może zdecydować się na skonfigurowanie Butterfly Cloud przy użyciu logowania jednokrotnego (SSO). SSO stanowi część usług Butterfly Enterprise. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat usług Butterfly Enterprise i włączania konfiguracji SSO, należy odwiedzić witrynę support.butterflynetwork.com.

13.1. Omówienie

Usługa Butterfly Cloud jest aplikacją internetową umożliwiającą użytkownikom przesyłanie i recenzowanie badań ultradźwiękowych z aplikacji Butterfly iQ. Użytkownicy chmury mogą również dokumentować, rozliczać i integrować system Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 z istniejącymi systemami szpitalnymi PACS, VNA, EMR i list roboczych modalności. Butterfly Cloud zapewnia również funkcję przyjmowania zdjęć z innych urządzeń ultradźwiękowych.

Administrator usługi Butterfly Cloud konfiguruje archiwum, dodaje nowych członków, a ponadto przeprowadza konfigurację poziomu dostępu dla poszczególnych użytkowników. Administratorzy mogą również skonfigurować kontakty zewnętrzne w Butterfly Cloud.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Butterfly Cloud, należy odwiedzić support.butterflynetwork.com.

13.2. Dostęp do Butterfly Cloud

Dostęp do Butterfly Cloud można uzyskać zarówno z aplikacji Butterfly iQ, jak i z przeglądarki internetowej na stronie cloud.butterflynetwork.com. Jeśli jesteś użytkownikiem Butterfly Enterprise, przejdź do [\[YourDomain\].butterflynetwork.com](https://[YourDomain].butterflynetwork.com).

Zaloguj się do Butterfly Cloud przy użyciu adresu e-mail i hasła Butterfly lub danych logowania jednokrotnego (SSO).

13.3. Przeglądanie i zarządzanie badaniami

Przeglądanie badania

1. Zaloguj się do Butterfly Cloud.
2. Wybierz archiwum (folder), do którego badanie zostało przesłane.
3. Kliknij badanie, aby wyświetlić szczegółowe informacje o pacjencie oraz przejrzeć zdjęcia i klipy.

Przeniesienie badania do nowego archiwum

1. Zaloguj się do Butterfly Cloud.
2. Znajdź badanie, które zamierzasz przenieść. Badania można przenieść z ekranu archiwum lub widoku szczegółów badania.
3. W prawym górnym rogu badania kliknij menu rozwijane „Więcej”, aby je wyświetlić. Jeśli opcja „Przenieś badanie” nie jest widoczna, skontaktuj się z administratorem konta Butterfly, aby uzyskać dodatkowy dostęp.

4. Wybierz archiwum, do którego ma zostać przeniesione badanie.

Usuwanie badania

1. Zaloguj się do Butterfly Cloud.
2. Przejdź do archiwum zawierającego badanie przeznaczone do przeniesienia.
3. W prawym górnym rogu badania kliknij menu rozwijane „Więcej”, aby je wyświetlić.
4. Wybierz opcję „Usuń badanie”. System wygeneruje komunikat o potwierdzeniu usunięcia.
5. Kliknij pozycję „Usuń”, aby usunąć badanie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy odwiedzić witrynę support.butterflynetwork.com.

14. Użytkowanie Butterfly TeleGuidance

Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące Butterfly TeleGuidance. Usługa umożliwia użytkownikom nawigację po czeniu z jednym z dostępnych kontaktów za pośrednictwem aplikacji Butterfly iQ w celu nawigacji zdalnej współpracy podczas badania.



UWAGI

- W zależności od platformy, sprzętu, kraju i rodzaju subskrypcji niektóre ustawienia wstępne oraz funkcje mogą być niedostępne.
- Urządzenie Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 i jego akcesoria mogą być używane wielokrotnie u wielu pacjentów.

14.1. Omówienie

Połączenie TeleGuidance wymaga zarówno osoby przeprowadzającej badanie, jak i zdalnego współpracownika.



PRZESTROGA!

- Butterfly TeleGuidance musi odbyć się wyłącznie pomiędzy dwoma lekarzami.
- PHI będzie widoczne dla użytkowników, którzy przyjmą połączenia.
- Warunki sieciowe mogą pogorszyć jakość obrazu ultradźwiękowego oraz połączenia wideo dla zdalnych współpracowników.

Aby wykonać połączenie jako osoba przeprowadzająca skanowanie — za pomocą iPhone'a lub iPada:

W systemie iOS kliknij przycisk Actions (Czynności) w prawym dolnym rogu głównego ekranu badania, a następnie ikonę telefonu w zakładce TeleGuidance w prawym dolnym rogu. Wybierz połączenie w trybie online, aby przeprowadzić rozmowę.

Aby odebrać połączenie jako zdalny współpracownik — na komputerze z przeglądarką Google Chrome

W przeglądarce Google Chrome na komputerze stacjonarnym zaloguj się na cloud.butterflynetwork.com. Jeśli jesteś użytkownikiem Butterfly Enterprise, przejdź do [\[YourDomain\].butterflynetwork.com](https://[YourDomain].butterflynetwork.com) i zaloguj się. Kliknij „TeleGuidance” w górnym pasku nawigacyjnym. Przygotuj się na połączenia i upewnij się, czy głośniki są włączone. Po nadejściu połączenia rozlegnie się dźwięk dzwonka, a na stronie wyświetli się powiadomienie. Zaakceptuj połączenie, aby rozpocząć.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak przeprowadzić sesję Butterfly TeleGuidance, odwiedź witrynę support.butterflynetwork.com.

15. Użytkowanie Butterfly iQ+ Care

Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące Butterfly iQ+ Care. Ta funkcja pozwala pracować na nowe sposoby dzięki uproszczonemu interfejsowi użytkownika do celów obrazowania, zaprojektowanemu z myślą o wielokrotnym korzystaniu z konkretnych aplikacji.



UWAGI

- W zależności od platformy, sprytu, kraju i rodzaju subskrypcji niektóre ustawienia wstępne oraz funkcje mogą być niedostępne.
- Urządzenie Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 i jego akcesoria mogą być używane wielokrotnie u wielu pacjentów.

Omówienie

Butterfly iQ+ Care wymaga [kompatybilnego urządzenia](#) i dostępu do Butterfly iQ+ Care pakietu funkcji.


Aby obliczyć objętość pęcherza — na urządzeniu iPad



UWAGA

Ważne informacje, między innymi na temat wskazań do stosowania oraz przeciwwskazań, zawiera [Automatyczne oszacowanie objętości pęcherza \[68\]](#).

1. Podłącz głowicę
2. Wybierz przycisk „Obraz pęcherza”, jeżeli jest dostępny
3. Opcjonalnie wprowadź dane pacjenta, jeżeli są dostępne
4. Po wyświetleniu ekranu z funkcją obliczania objętości pęcherza, wyodróżnij obraz i naciśnij przycisk „Oblicz”

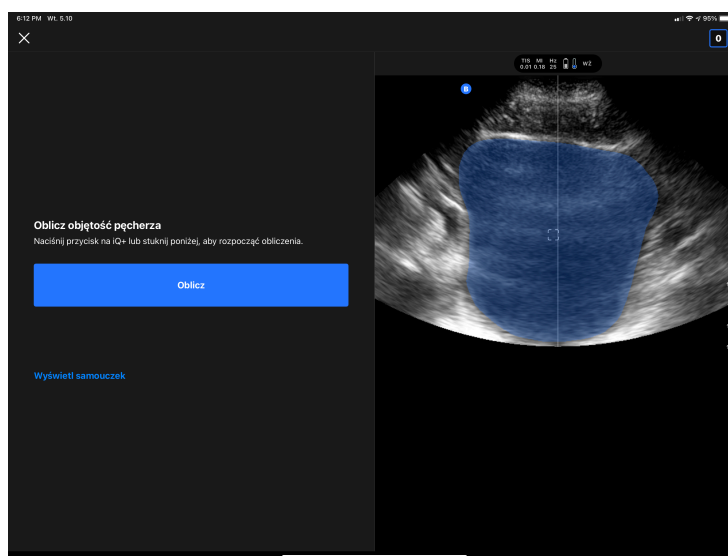

5. Opcjonalnie obejrzyj samouczek, który zawiera materiał wideo oraz szczegółowe objaśnienie, jak wykonać badanie USG pęcherza moczowego



UWAGA

Ten samouczek nie zastępuje profesjonalnego szkolenia i do wiadomości lekarzy i może nie przedstawia wszystkich możliwych przypadków. Lekarze nieustannie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za opiekę nad pacjentem i dokonywanie niezależnej oceny klinicznej.

6. Na ekranie wyników wybierz przycisk „Zakończ”, aby je przesłać, lub przejdź do rolki przechwyconych obrazów, aby przejrzeć badanie
7. Opcjonalnie wybierz przycisk „Uruchom ponownie”, aby zacząć od nowa. Ponowne uruchomienie spowoduje zachowanie danych z poprzedniego obrazowania

Aby wykonać badanie USG dostępu naczyniowego – na urządzeniu iPad

1. Podłącz głowicę
2. Wybierz przycisk „Dostęp naczyniowy”, jeżeli jest dostępny
3. Opcjonalnie wprowadź dane pacjenta, jeżeli są dostępne
4. Wybierz narzędzia takie jak Needle Viz lub Biplane z menu Czynności

16. Używanie systemu Butterfly iQ+ Bladder

Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące systemu Butterfly iQ+ Bladder. System ten umożliwia podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną płynną pracę w przypadku zastosowania do skanowania pęcherza moczowego.



UWAGI

- System Butterfly iQ+ Bladder jest dostępny tylko w określonych krajach.
- Środowisko Butterfly iQ+ Bladder wymaga dedykowanej głowicy (Butterfly iQ+ Bladder) i nie jest zgodne z Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3.
- System Butterfly iQ+ Bladder jest dostępny tylko na iPadach Apple z portem USB-C. Pełna lista zgodnych urządzeń dostępna jest [tutaj](#)
- System Butterfly iQ+ Bladder ma ograniczoną głębokość badania od 5 cm do 20 cm.

16.1. Omówienie

Butterfly iQ+ Bladder wymaga zgodnego urządzenia i oprogramowania. Zalecane jest instalowanie najnowszej wersji aplikacji. Głowica Butterfly iQ+ Bladder jest konfiguracją platformy sprzętowej Butterfly iQ+, dlatego dzieli jej specyfikacje mechaniczne i elektryczne.



UWAGA

Butterfly iQ+ Bladder nie wymaga logowania i nie zapisuje obrazów, dlatego żadne dane chronione o stanie zdrowia pacjentów ani dane osobowe nie są przechowywane na urządzeniu podczas obsługi systemu. Butterfly iQ+ Bladder

16.2. Wskazania do stosowania

System ultrasonograficzny Butterfly iQ+ Bladder jest przeznaczony do użycia przez przeszkolonych pracowników służby zdrowia w placówkach, w których świadczono usługi medyczne, w celu przeprowadzenia diagnostyki ultrasonograficznej na potrzeby pomiaru objętości pęcherza u dorosłych pacjentów w zastosowaniach klinicznych w dziedzinie urologii.


Tryby pracy ultrasonografu to tryb B + [Automatycznie obliczona objętość pęcherza \[68\]](#)


[Narzędzie przeznaczone do automatycznego pomiaru objętości pęcherza \[68\]](#) to pakiet aplikacji. Jest ono przeznaczone do przeglądania, ilościowego określenia i raportowania wyników uzyskanych za pomocą systemu ultrasonograficznego Butterfly Network. Służą do nieinwazyjnych pomiarów objętości pęcherza moczowego mających na celu uzupełnienie diagnozy lekarskiej. Wskazany do stosowania w populacji osób dorosłych.

16.3. Przeciwwskazania


Narzędzie to nie jest przeznaczone do stosowania u kobiet w ciąży lub dzieci ani pacjentów z wodobrzuszem lub pacjentów z otwartymi ranami bądź ranami w okolicy nadłonowej.

16.4. Określanie objętości pęcherza moczowego

1. Sprawdź, czy głowica jest podłączona do kompatybilnego iPada.
2. Włącz iPad.
3. Wybierz aplikację Butterfly iQ; jeżeli głowica Butterfly iQ+ Bladder jest podłączona, rozpocznie się ładowanie systemu.
4. Po załadowaniu systemu wyświetli się skrócona instrukcja. Na tym ekranie możesz rozpocząć obrazowanie, naciskając opcję „**Start Scanning**” (Rozpocznij obrazowanie) lub rozpocząć obrazowanie ze wskazówkami, naciskając opcję „**More help**” (Dodatkowa pomoc).
5. Na ekranie pojawi się obraz na żywo, który jest wyświetlany przy użyciu narzędnia automatycznego określania objętości pęcherza do segmentacji pęcherza moczowego. Ponadto możesz włączyć podpowiedzi po lewej stronie ekranu, naciskając opcję . Po włączeniu podpowiedzi możesz obrazować pęcherz, otrzymując przydatne wskazówki dotyczące sprawdzonych metod obrazowania pęcherza.
6. W podglądzie na żywo możesz dostosować głębię, przesuwając po ekranie palcem w górę i w dół. Zaleca się wyregulowanie pęcherza w polu widoku przed rozpoczęciem obrazowania. Zapoznaj się również z rozdziałem [Automatycznie obliczona objętość pęcherza](#). [68]

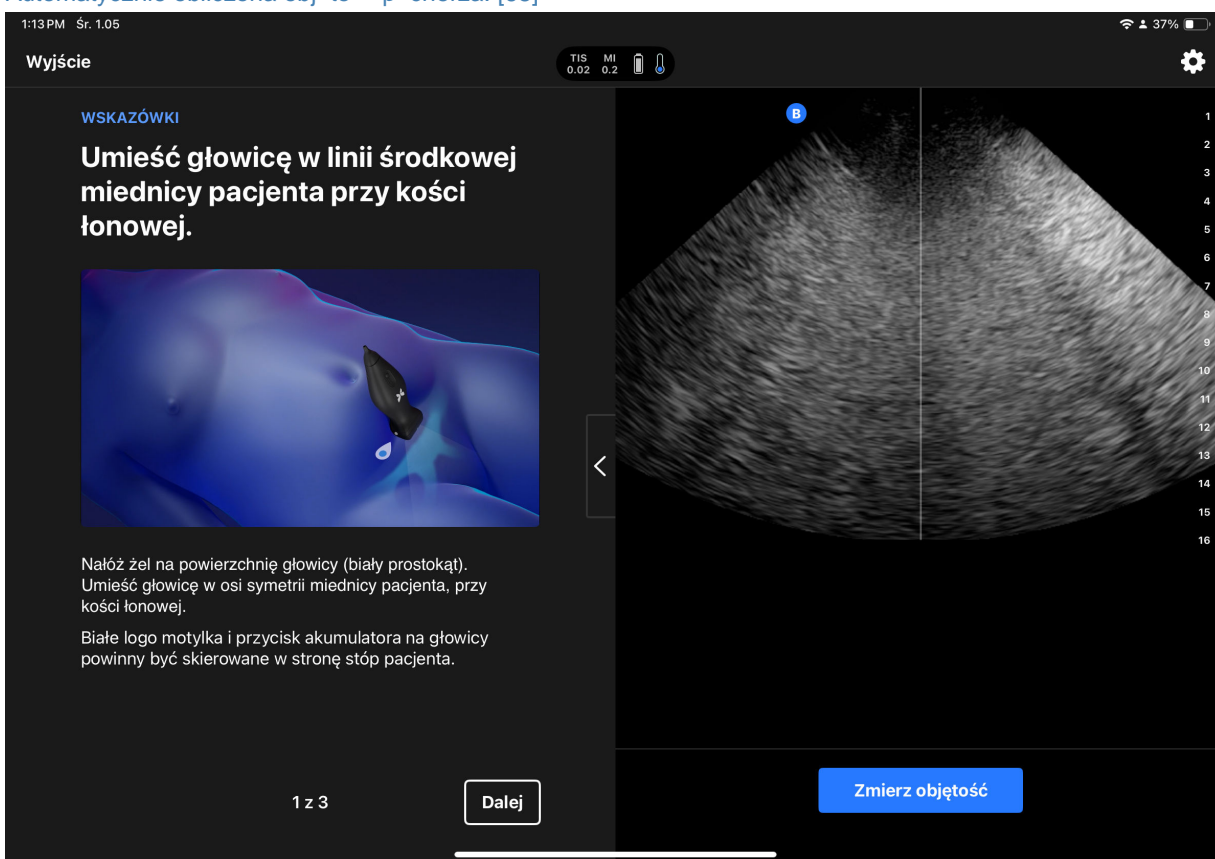

7. Po zlokalizowaniu pęcherza możesz przeprowadzić pomiar, naciskając przycisk „**Measure volume**” (Zmierz objętość) lub naciskając przycisk akumulatora głowicy. Aplikacja przeprowadza pomiar 3D i wykorzystuje funkcję [automatycznego obliczania objętości pęcherza](#). [68]
8. Po uzyskaniu objętości wyświetli się ekran z informacją o objętości, a także obraz 3D objętości do przeglądu.

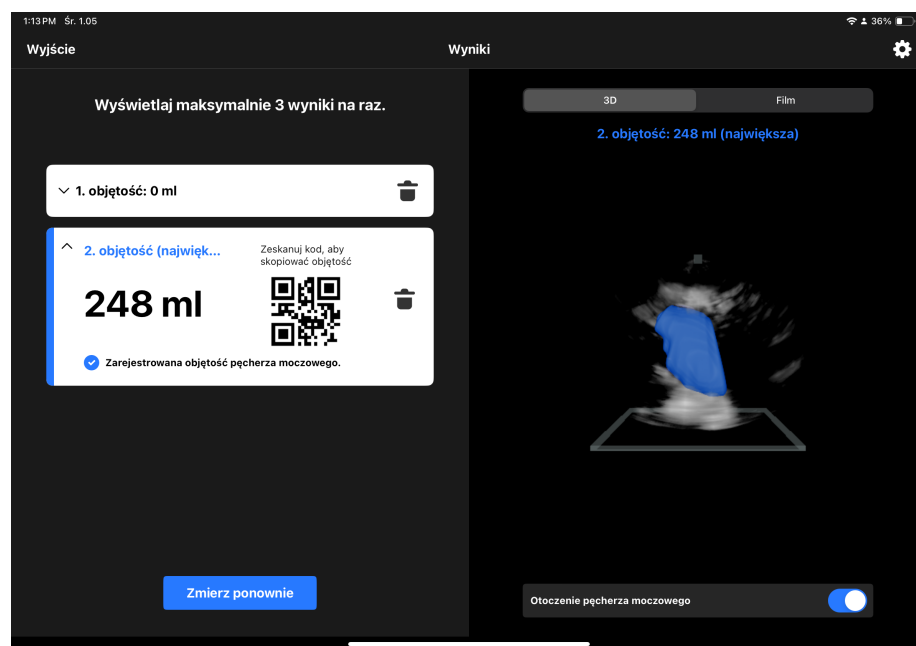


9. Na ekranie przeglądu możesz zapisać maksymalnie 3 pomiary i użyć maksymalnego pomiaru lub wyjść do ekranu głównego i rozpocząć nowe obrazowanie. Każdy z pomiarów ma przypisany kod kreskowy, który możesz zeskanować do systemu EHR. Typ kodu możesz skonfigurować w menu ustawień.
10. Po ukończeniu możesz zakończyć obrazowanie, naciskając opcję „**End Scan**” (Zakończ obrazowanie) w lewym górnym rogu ekranu.



UWAGA

Po zakończeniu obrazowania obrazy zostaną trwale usunięte.

16.5. Dostępne ustawienia

Aby uzyskać dostęp do menu ustawień, naciśnij w prawym górnym rogu (ikona koła z zębami ). W menu ustawień możesz dostosować następujące opcje:

1. **Moja sonda:** Sprawdź numer seryjny sondy, model sondy itp.
2. **Skonfiguruj kod kreskowy:** Wybierz typ kodu kreskowego, który stanowi kod pomiaru objętości i może zostać zeskanowany do systemu EHR. W menu możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie kodu kreskowego, a także wybrać jeden z następujących stylów kodu kreskowego:
 - a. Kod 128
 - b. Kod Aztec
 - c. DataMatrix
 - d. Kod QR
3. **Strona szybkiego startu:** określ, czy strona szybkiego startu ma być wyświetlana łącznie, czy też ma być pomijana przy uruchamianiu.
4. **Automatyczne zamknięcie:** Włącz/wyłącz funkcję automatycznego zamknięcia. Jeśli jest ona włączona, ekran zostanie zamknięty, gdy głowica wykryje, że nie wykonano obrazowania przez ponad 30 sekund (np. głowica znajduje się w powietrzu), aby oszczędzić energię akumulatora głowicy.
5. **Kontakt z działem wsparcia:** Skontaktuj się z obsługą Butterfly Network.

6. **Instrukcja obsługi:** Uzyskaj dostęp do elektronicznej wersji instrukcji obsługi.

17. Konservacja

W tym rozdziale podano informacje i instrukcje dotyczące przechowywania, transportu, czyszczenia i dezynfekcji głowicy.

17.1. Konservacja głowicy

Odbiór i rozpakowanie głowicy

Jeśli opakowanie urządzenia jest uszkodzone po odebraniu systemu, należy sprawdzić jego elementy wymienione na liście [Elementy Systemu \[20\]](#) pod kątem wszelkich widocznych uszkodzeń. Potwierdź prawidłowe działanie systemu, postępując zgodnie z instrukcjami z punktu [Wykonywanie testu diagnostycznego głowicy \[90\]](#). Jeśli wystąpią widoczne uszkodzenia lub jeśli system nie działa prawidłowo, skontaktuj się z zespołem wsparcia Butterfly, korzystając z jednej z metod wymienionych w punkcie [Wsparcie \[101\]](#).

Przechowywanie i transport:



PRZESTROGI!

- Unikaj przechowywania głowicy w miejscach, w których głowica lub jej przewód mogłyby łatwo ulec uszkodzeniu.
- Unikaj transportowania głowicy, chyba że po jej dokładnym zabezpieczeniu. Unikaj kołysania głowic lub trzymania jej wyłącznie za przewód.

Głowicę przechowywać w czystym, suchym miejscu o umiarkowanej temperaturze.

Wykonać poniższe czynności związane z codziennym przechowywaniem i transportem:

- Na czas przechowywania głowicy owinąć przewód wokół niej z zachowaniem pewnego luzu u dołu głowicy. Więcej informacji, patrz: [Rysunek 2, „Owijanie przewodu” \[85\]](#).
- Unikaj umieszczania lub przechowywania głowicy w miejscach, w których panuje szczególnie wysoka lub niska temperatura lub w miejscach nasłonecznionych.
- Unikaj umieszczania lub przechowywania głowicy z innym sprzętem lub obiektami, które mogą nieodwracalnie uszkodzić głowicę, zwłaszcza jej przedni czujnik.
- Unikaj zanieczyszczenia poprzez:
 - postępowanie zgodnie z instrukcją czyszczenia i dezynfekcji.
 - upewnianie się, że urządzenie jest suche;
 - ostrożne postępowanie z głowicą w celu zapobieżenia uszkodzeniu sprzętu.




PRZESTROGI!


- Kabel powinien być nieco luźny w miejscu, w którym łączy się on z głowicą, aby uniknąć ryzyka ciskania lub innego rodzaju uszkodzenia przewodu. Jak pokazano na [Rysunek 2, „Owijanie przewodu” \[85\]](#), [i] należy luźno owinąć pozostały kabel wokół głowicy i [ii] pozostawić minimum 5 cm. Nie należy owijać kabla wokół innych przedmiotów ani korzystać z etui, które nie są zatwierdzone lub zalecane przez firmę Butterfly.
- Niewystarczający luz może uszkodzić kabel i spowodować przedwczesne zużycie przewodu.

Rysunek 2. Owijanie przewodu

Butterfly iQ/ iQ+

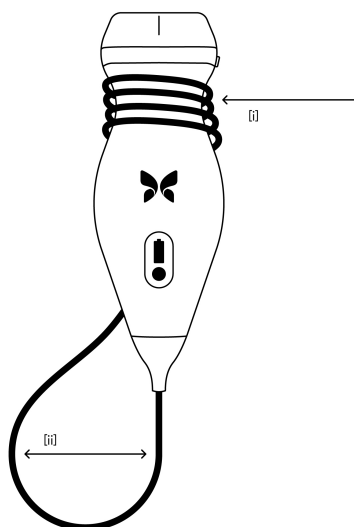

Butterfly iQ3

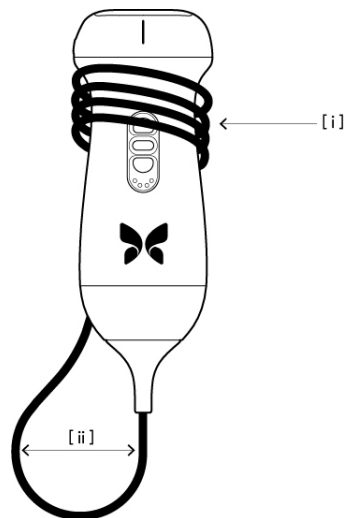

17.2. Czyszczenie i dezynfekcja głowicy w miejscu u ycia



OSTRZE ENIE!

Zaniechanie dezynfekcji głowicy mo e spowodowa zwi kszone ryzyko rozprzestrzeniania si czynników chorobotwórczych.



PRZESTROGA!

Głowic czy ci wył cznie z u yciem zatwierdzonych produktów do czyszczenia i ciereczek. Niewła ciwe metody czyszczenia i dezynfekcji lub stosowanie niezatwierdzonych roztworów do czyszczenia i dezynfekcji mog prowadzi do uszkodzenia sprz tu.

Niniejszy rozdział zawiera informacje i instrukcje dotycz ce prawidłowego czyszczenia i dezynfekcji głowicy systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3. Post powanie zgodne z tymi instrukcjami pomo e te zapobiega ryzyku uszkodzenia głowicy w czasie czyszczenia i dezynfekcji. Po ka dym badaniu nale y niezwłocznie wyczy ci i zdezynfekowa urz dzenie Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 zgodnie z poni szymi instrukcjami, aby zapobiec wysychaniu brudu i zanieczyszcze w urz dzeniu i na nim.

Mimo e zawarte tutaj wskazówki dotycz ce czyszczenia i dezynfekcji zostały zatwierdzone pod k tem skuteczno ci, wykaz produktów do czyszczenia i dezynfekcji, które s odpowiednie do głowicy Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 , ale nie zostały przetestowane pod wzgl dem efektywno ci przez Butterfly, mo na znale w artykule „Kompatybilne produkty do czyszczenia i dezynfekcji”, dost pnym na stronie support.butterflynetwork.com. Produkty wymienione w artykule „Kompatybilne produkty do czyszczenia i dezynfekcji” nie wpłyn na funkcjonalno głowicy, je li zostan u yte zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta produktu.

17.2.1. Czyszczenie głowicy



PRZESTROGI!

- Podczas czyszczenia i dezynfekcji nie dopuszcza do przedostania si jakichkolwiek cieczy do elektrycznych lub metalowych cz ci z cza przewodu. Wskutek obecno ci cieczy w tych miejscach mo e doj do uszkodzenia.
- Zapobiega rozlaniu cieczy na ekran dotykowy urz dzenia mobilnego podczas skanowania i czyszczenia. Wskutek obecno ci cieczy mo e doj do uszkodzenia.

Aby wyczy ci głowic :

1. Po ka dym u yciu głowicy usun z niej el przewodz cy ultrad wi ki za pomoc jednej z zalecanych wilgotnych ciereczek (Super Sani-Cloth® Germicidal Disposable Wipes firmy PDI, Inc., Super Sani-Cloth® AF3 Disposable Wipes firmy PDI, Inc. lub niestrz pi ca si ciereczka zwil ona wod).
2. Odł czy głowic od urz dzenia mobilnego.
3. Wyciera głowic , reduktor napr enia i z cze jedn z zalecanych wilgotnych ciereczek przez jedn (1) minut i a do widocznego usuni cia zanieczyszcze .
4. W razie potrzeby wymienia ciereczki na nowe i powtarza powy sz czynno tak długo, a z głowicy zostan usuni te wszelkie widoczne zanieczyszczenia.
5. Wsuszy głowic na powietrzu. Ewentualnie u y mi kkiej, niestrz pi cej si szmatki i wytrze do sucha. Nie wyciera soczewki. Osuszy pozostał cz głowicy, kabel, reduktor napr enia i z cze.
6. Sprawdzi wzrokowo głowic w dobrze o wietlnym miejscu, aby upewni si , e wszystkie powierzchnie s czyste. Je eli tak nie jest, powtórzy czyszczenie.
7. Materiał czyszcz cy usun zgodnie z wszelkimi obowi zuj cymi przepisami.

Aby uzyska najbardziej aktualn list zatwierdzonych rodków czyszcz cych, nale y odwiedzi support.butterflynetwork.com.

17.2.2. Dezynfekcja głowicy



OSTRZE ENIE!

Ka dorazowo sprawdza głowic przed i po czyszczeniu, dezynfekcji i u yciu. Sprawdza powierzchni soczewki, przewód, obudow , spojenia i z cze pod k tem oznak uszkodze , takich jak p kni cia, złuszczenia, zarysowania i nieszczelno ci. Aby unikn ryzyka pora enia pr dem elektrycznym, nie u ywa głowicy w razie wykrycia jakiegokolwiek objawu wiadcz cego o uszkodzeniu.

Po wyczyszczeniu głowicy konieczna jest jej dezynfekcja.

Aby ograniczy ryzyko zanieczyszczenia i infekcji, wa ny jest wybór odpowiedniego poziomu dezynfekcji na podstawie u ycia w poprzednim badaniu i klasyfikacji u ycia jako niekrytyczne lub cz ciowo krytyczne. Skorzystaj z informacji, które zawiera [Tabela 10, „Klasa dezynfekcji głowicy, u ycie i metoda” \[86\]](#), aby okre li odpowiedni klas , a nast pnie post powa zgodnie z procedur dezynfekcji redniego lub wysokiego poziomu.

Tabela 10. Klasa dezynfekcji głowicy, u ycie i metoda

Klasa	U ycie	Metoda
Klasa niekrytyczna	Dotyka nieuszkodzonej skóry	Czyszczenie, a nast pnie dezynfekcja redniego poziomu (ILD)

Klasa	U ycie	Metoda
Klasa cz iowo krytyczna	Dotyka błon luzowych lub uszkodzonej skóry	Czyszczenie, a nast pnie dezynfekcja wysokiego poziomu (HLD)

Dezynfekcja redniego poziomu (ILD)

Zaleca si stosowanie ciereczek Super Sani-Cloth®Germicidal Disposable Wipes firmy PDI, Inc. lub wybielacza (0,6% roztwór podchlorynu sodu) i czystych, niestrz pi cych si ciereczek.

Aby zdezynfekowa głowic , wykorzystuj c dezynfekcj redniego poziomu (ILD) z u yciem ciereczek Super Sani-Cloth®Germicidal Disposable Wipes firmy PDI, Inc.:

1. Wytrze głowic , przewód, reduktor napr enia i zł cze ciereczk Super Sani-Cloth® Germicidal Disposable Wipe. W razie potrzeby u y wi kszej liczby wie ych ciereczek.
2. Upewni si wzrokowo, e czyszczona powierzchnia pozostaje wilgotna przez co najmniej dwie (2) minuty, zwracaj c uwag na spojenia, szczeliny, materiał uszczelek i wgł bienia.
3. W razie potrzeby u y dodatkowych wie ych ciereczek, aby zapewni dwuminutowy ci gły kontakt.
4. Wysuszy głowic na powietrzu. Ewentualnie u y mi kkiej, niestrz pi cej si szmatki i wytrze do sucha. Nie wyciera soczewki. Osuszy pozostał cz głowicy, kabel, reduktor napr enia i zł cze.
5. Po wyczyszczeniu i dezynfekcji sprawdzi wzrokowo głowic , reduktor napr enia, przewód i zł cze pod k tem objawów uszkodzenia i zu ycia.

Aby zdezynfekowa głowic , wykorzystuj c dezynfekcj redniego poziomu (ILD) z u yciem wybielacza (0,6% roztwór podchlorynu sodu) i czystej, niestrz pi cej si szmatki:

1. Wyciera głowic , przewód, reduktor napr enia i zł cze, u ywaj c czystej, niestrz pi cej si szmatki zwil onej (ale nie ociekaj cej) wybielaczem (roztwór 0,6%). W razie potrzeby u y wi kszej liczby wie ych ciereczek.
2. Upewni si wzrokowo, e czyszczona powierzchnia pozostaje wilgotna przez co najmniej dziesi (10) minut, zwracaj c uwag na spojenia, szczeliny, materiał uszczelek i wgł bienia.
3. W razie potrzeby u y dodatkowych wie ych ciereczek, aby zapewni dziesi ciominutowy ci gły kontakt.
4. Wysuszy głowic na powietrzu. Ewentualnie u y mi kkiej, niestrz pi cej si szmatki i wytrze do sucha. Nie wyciera soczewki. Osuszy pozostał cz głowicy, kabel, reduktor napr enia i zł cze.
5. Po wyczyszczeniu i dezynfekcji sprawdzi wzrokowo głowic , reduktor napr enia, przewód i zł cze pod k tem objawów uszkodzenia i zu ycia.

Dezynfekcja wysokiego poziomu

Zaleca si u ycie roztworu Cidex® OPA. ¹⁰ przez Ethicon US, LLC.

Aby sprawdzi mo liwo zastosowania metody HLD do głowicy:

1. Wejd do menu Ustawienia.
2. Dotkn opcji **Mój iQ**, aby wy wietli ekran **Mój iQ**.
3. Sprawdź , czy w wierszu **Wytyczne do dezynfekcji wysokiego poziomu** widoczny jest tekst **Tak**.
4. Zastosowa metod HLD tylko wtedy, gdy jest zgodna z u ywan głowic .
5. Odł czy głowic od urz dzenia mobilnego.

Dezynfekcja głowicy za pomoc metody dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD):



1. Po wyczyszczeniu głowicy konieczna jest jej dezynfekcja. Zalecane jest u ycie roztworu Cidex® OPA do dezynfekcji wysokiego poziomu.
2. Przygotowa roztwór Cidex® OPA do u ycia w dezynfekcji wysokiego poziomu zgodnie z instrukcjami producenta. Napełni tack lub zlew roztworem dezynfekuj cym w temperaturze pokojowej (minimalna temperatura 20°C) do poziomu umo liwiaj cego zanurzenie głowicy do linii zanurzenia (linia przerywana, któr przedstawia [Rysunek 3, „Linia zanurzenia głowicy” \[88\]](#)).
3. Zanurzy głowic w roztworze Cidex® OPA do poziomu linii zanurzenia i sprawdzi , czy nie wyst puje uwi zione powietrze lub p cherzyki. Pozostawi do namoczenia zgodnie z instrukcjami producenta.
4. Dokładnie wypłuka głowic (do linii zanurzenia), zanurzaj c j w du ej ilo ci wody krytycznej (demineralizowana) na co najmniej jedn (1) minut . Wyj głowic i wyla wod do płukania. Nie u ywa wody ponownie. Zawsze u ywa wie ej wody do ka dego płukania. Powtórzy ten etap dodatkowo dwa (2) razy, wykonuj c łą cznie trzy (3) płukania.
5. Dokładnie osuszy wszystkie powierzchnie urz dzenia za pomoc sterylnej, niestrz pi cej si ciereczki, wymieniaj c j w razie potrzeby, aby upewni si , e urz dzenie jest całkowicie suche. Sprawdź wzrokowo urz dzenie, aby upewni si , e wszystkie powierzchnie s czyste i suche. Powtórzy kroki czyszczenia, je eli widoczna jest jakakolwiek wilgo .
6. Po wyczyszczeniu i dezynfekcji sprawdzi wzrokowo głowic , reduktor napr enia, przewód i zł cze pod k tem objawów uszkodzenia i zu ycia.

Rysunek 3. Linia zanurzenia głowicy

Butterfly iQ/ iQ+

Butterfly iQ3

¹⁰Cidex® OPA jest zatwierdzonym przez FDA roztworem HLD.

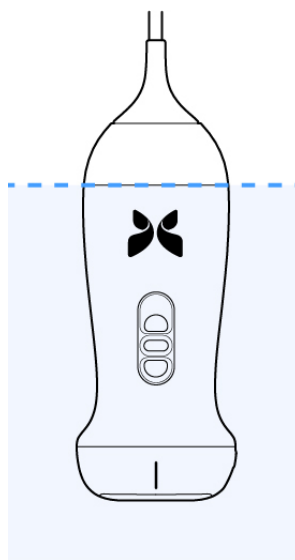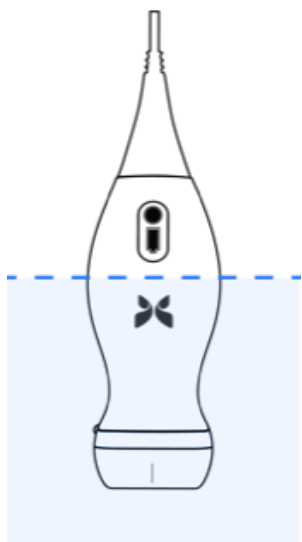

17.3. Aktualizacja oprogramowania głowicy i aplikacji

Aktualizacje aplikacji Butterfly iQ i głowicy odbywają się poprzez witrynę Apple App Store lub Google Play Store.

System operacyjny urządzenia mobilnego i aplikacja Butterfly iQ muszą być aktualizowane, aby zapewnić posiadanie najnowszej wersji oprogramowania.



PRZESTROGA!

Aplikację mobilną Butterfly należy pobierać wyłącznie ze sklepu Apple App Store, Google Play lub za pośrednictwem rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) stosowanego w organizacji (jeżeli dotyczy).



PRZESTROGA!

Jeżeli aplikacja nie będzie już używana na danym urządzeniu przenośnym, odinstaluj aplikację, wykonaj odpowiednie czynności w systemie iOS lub Android, aby usunąć wszelkie dane użytkownika z urządzenia.



UWAGA

Kiedy nie musisz już korzystać z aplikacji, wyjdź z aplikacji Butterfly iQ, aby uniknąć liwi jej używania.

17.4. Wykonywanie testu diagnostycznego głowicy

Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 ma możliwość wykonania inicjowanych przez użytkownika autotestów diagnostycznych, których celem jest ocena gotowości systemu do użytkowania.

Okresowo niezbędne jest wykonywanie testu diagnostycznego. W przypadku normalnego użytkowania zaleca się testowanie comiesięczne.

Test diagnostyczny dotyczy wyłącznie głowicy ultradźwiękowej Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3. Aplikacja nie ma możliwości oceny stanu technicznego ekranu urządzenia mobilnego.

Test diagnostyczny polega na wykonaniu serii testów diagnostycznych i kończy się wygenerowaniem powiadomienia, gdy wszystkie testy zostaną pomyślnie przeprowadzone.

Aby wykonać test diagnostyczny głowicy:

1. Upewnij się, że głowica jest podłączona do obsługiwanego urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją Butterfly iQ.
2. Zaloguj się w aplikacji za pomocą danych logowania użytkownika.
3. Wejdź do menu Ustawienia.
4. Dotknij opcji **Mój iQ** aby wyświetlić ekran **Mój iQ**.
5. Dotknij opcji **Przeprowadź diagnostykę**, a następnie wybierz opcję **Rozpocznij diagnostykę głowicy** w celu przeprowadzenia testu.

Test diagnostyczny głowicy

Test diagnostyczny głowicy wykonuje test cyfrowej i akustycznej wydajności elementów przetwornika. Jeżeli test diagnostyczny sondy wykazuje awarię, użytkownik powinien skontaktować się z Butterfly Network w celu uzyskania dalszego wsparcia [101].

Dodatkowo za każdym razem, gdy głowica jest włączona i podczas jej pracy, system testuje podsystemy analogowe i cyfrowe, czujniki bezpieczeństwa, poziom naładowania baterii itp. oraz wykrywa i zgłasza awarie w razie jakichkolwiek obaw.

17.5. Wymiana kabla Butterfly iQ+/ iQ3



PRZESTROGA!

Nie należy nadmiernie wymontowywać i instalować kabla, ponieważ spowoduje to przedwczesne zużycie pierścienia uszczelniającego o przekroju kołowym i umożliwi wnikanie wody i pyłu do urządzenia.



UWAGA

Podmiana kabla głowicy jest dostępna tylko w przypadku Butterfly iQ+. Próba odłączenia kabla w przypadku Butterfly iQ nie jest możliwa i może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.


Kabel do głowicy Butterfly iQ+ można wymienić w przypadku oznak uszkodzenia lub konieczności użycia urządzenia mobilnego z innym typem złącza. Podsumowanie kompatybilności głowicy i przewodu można znaleźć w Tabeli 11, „Kompatybilność głowicy i wymiennego kabla” [91].

Tabela 11. Kompatybilność głowicy i wymiennego kabla

Głowica	Kable do akcesoriów	Numer modelu	Numer SKU pakietu (jeżeli dotyczy)
Butterfly iQ Numer modelu: 850-20003	OSTRZEŻENIE: Przewód jest zamontowany na stałe. Nie wolno wyjmować/wymieniać kabla.	-	-
Butterfly iQ+ Numer modelu: 850-20014	Butterfly iQ+Kabel do akcesoriów, złącze Lightning, 1,50 M	900-20010-02	Ten kabel do złącza Lightning nie jest dostępny jako zamiennik. Jeżeli konieczna jest wymiana, jest to model kabla do złącza Lightning 490-00189-02.
	Butterfly iQ+Kabel do akcesoriów, złącze Lightning, 1,50 M	490-00189-02	900-20010-12
	Butterfly iQ+Kabel do akcesoriów, złącze USB-C, 1,50 M	490-00187-02	900-20011-12
	Butterfly iQ+Kabel do akcesoriów, złącze Lightning, 2,50 M	490-00189-03	900-20010-13
Butterfly iQ3 Numer modelu: 850-20023	Butterfly iQ3Kabel do akcesoriów, złącze Lightning, 1,50 M	490-00227-02	900-20054-02 900-20073-02
	Butterfly iQ3Kabel do akcesoriów, złącze USB-C, 1,50 M	490-00228-02	900-20055-02 900-20074-02
	Butterfly iQ3Kabel do akcesoriów, złącze Lightning, 2,50 M	490-00227-03	900-20054-03 900-20073-03
	Butterfly iQ3Kabel do akcesoriów, złącze USB-C, 2,50 M	490-00228-03	900-20055-03 900-20074-03

Rysunek 4. Butterfly iQ+/ iQ3 Elementy okablowania

Kabel Butterfly iQ+

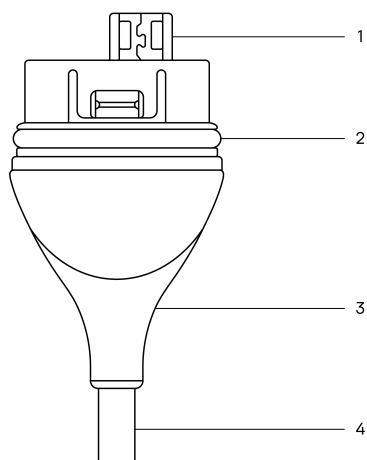

Kabel Butterfly iQ3

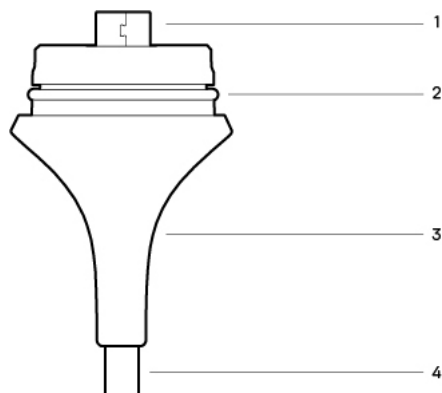



Tabela 12. Elementy kabla

Butterfly iQ+	Butterfly iQ3
1. Wtyczka USB	1. Wtyczka USB
2. Piercie uszczelniający o przekroju kołowym	2. Piercie uszczelniający o przekroju kołowym
3. Zacisk odciążający	3. Zacisk odciążający
4. Przewód	4. Przewód

Wymiana kabla Butterfly iQ+


1. Wyjmij używany kabel z głowicy Butterfly iQ+. Owiń kabel głowicą wokół nadgarstka, mocno trzymając głowicę w drugiej ręce. Rozłóż te dwa elementy. Nie używaj narzędzi do chwytania zacisku odciążającego tego lub przewodu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kabla.

Rysunek 5. Zdejmowanie kabla Butterfly iQ+




2. Dopasuj złoczyce i głowicę, a następnie mocno wciśnij kabel do korpusu głowicy. Po całkowitym zainstalowaniu kabla należy się spodziewać, że pomiędzy zaciskiem odciążającym a korpusem głowicy pojawi się niewielka szczelina.

Rysunek 6. Wyrównaj kabel Butterfly iQ+ przed założeniem



Rysunek 7. Przewidywany wygląd szczeliny między zaciskiem odciążającym kabla a korpusem głowicy po założeniu kabla Butterfly iQ+





Wymiana kabla Butterfly iQ3

1. Wyjmij używany kabel z głowicy Butterfly iQ3. Owiń kabel głowicy wokół nadgarstka, mocno trzymając głowicę w drugiej ręce. Naciśnij przycisk zwalniania kabla i rozsuń je od siebie. Nie używaj narzędzi do chwytania zacisku odciążającego lub kabla, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kabla.

Rysunek 8. Odciążanie kabla Butterfly iQ3



2. Dopasuj złacze i głowicę, a następnie mocno wciśnij kabel do korpusu głowicy. Po całkowitym zainstalowaniu kabla poczujesz lekkie kliknięcie, gdy blokada kabla na głowicy połączy się z kablem.

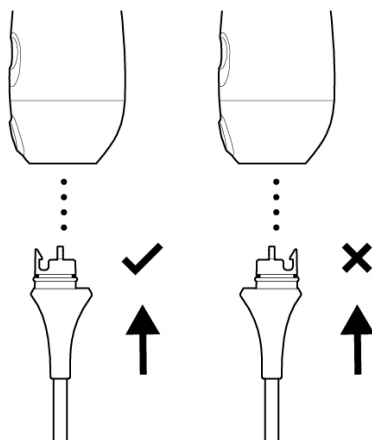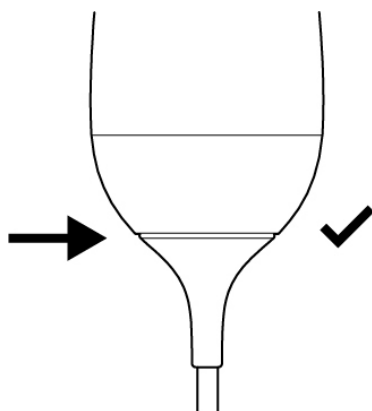Rysunek 9. Wyrównaj kabel Butterfly iQ3 przed założeniem**Rysunek 10. Przewidywany wygląd szczeliny między zaciskiem odciążającym kabla a korpusem głowicy po założeniu kabla Butterfly iQ3.**

W przypadku planowania zanurzenia głowicy w celu jej odkażenia za pomocą dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD):

1. Butterfly iQ/ iQ+ nigdy nie należy całkowicie zanurzać w roztworze HLD. Należy zapoznać się z: [Dezynfekcja wysokiego poziomu \[88\]](#), aby zobaczyć odpowiednie linie zanurzenia dla każdego modelu głowicy.
2. Należy dokładnie sprawdzić pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym przy każdym założeniu nowego kabla, aby upewnić się, czy nie jest uszkodzony. Należy zapoznać się z [Butterfly iQ+/ iQ3 Rysunek 4, „Butterfly iQ+/ iQ3 Elementy okablowania” \[92\]](#), aby sprawdzić umiejscowienie pierścienia uszczelniającego oraz innych elementów kabla.
3. Upewnij się, czy kabel został całkowicie włożony.

17.6. Zaplanowana konserwacja

Urządzenie automatycznie inicjuje test diagnostyczny co 25 godzin łącznego czasu skanowania. Urządzenie również ręcznie zainicjuje test diagnostyczny głowicy, wykonując czynności opisane w [Wykonywanie testu diagnostycznego głowicy \[90\]](#). Te testy diagnostyczne umożliwiają monitorowanie stanu głowicy. Do utrzymania głowicy w dobrej kondycji nie jest wymagana żadna okresowa konserwacja ani kalibracja.

17.7. Przewidywany okres eksploatacji urządzenia Butterfly iQ+/ iQ3

Przewidywany okres eksploatacji głowicy Butterfly iQ+/ iQ3 wynosi 5 lat. Okres eksploatacji głowicy ultradźwiękowej Butterfly iQ+/ iQ3 może się różnić w zależności od kilku czynników, między innymi od: sposobu użytkowania,

warunków eksploatacji, a także dbałość o urządzenie i jego konserwację przez użytkownika. W celu zapewnienia maksymalnego okresu eksploatacji należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania, przechowywania i konserwacji, które przedstawiono w podręczniku.

Przewidywany okres eksploatacji kabla/ladowarki Butterfly iQ+/ iQ3 wynosi 3 lata. Okres eksploatacji kabla/ladowarki Butterfly iQ+/ iQ3 może się różnić w zależności od kilku czynników, między innymi od: sposobu użytkowania, warunków eksploatacji, a także dbałości o akcesoria i ich odpowiedniej konserwacji przez użytkownika. W celu zapewnienia maksymalnego okresu eksploatacji należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania, przechowywania i konserwacji, które przedstawiono w podręczniku.

18. Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale podano informacje i instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów z systemem.



OSTRZEŻENIE!

Nie używaj głowicy w przypadku wykrycia jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. Skontaktuj się z działem wsparcia. Więcej informacji, patrz [Wsparcie \[101\]](#).

18.1. Rozwiązywanie problemów



PRZESTROGA!

Zignorowanie alertów i komunikatów aplikacji może skutkować brakiem możliwości podjęcia pracy przez system.

Tabela 13, „Rozwiązywanie problemów” [96] obejmuje listę problemów i ich rozwiązania. Więcej informacji, patrz [Wsparcie \[101\]](#).



UWAGI

- Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, należy zanotować problem i zgłosić go w dziale wsparcia w celu uzyskania pomocy. Więcej informacji, patrz [Wsparcie \[101\]](#).
- Jeśli w trakcie rozwiązywania problemu okaże się, że problemem jest stan zdrowia pacjenta, a nie urządzenie mobilne, niezwłocznie wezwij lekarza.
- Aby zgłosić reklamację lub zdarzenie, skontaktuj się z programem zgłaszania problemów FDA MedWatch pod numerem: 1-800-332-1088 lub za pośrednictwem Internetu: www.fda.gov/Safety/MedWatch/.

Tabela 13. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Aplikacja nie uruchamia się	Odejmij głowicę, usuń aplikację i ponownie zainstaluj aplikację.
Awaria aplikacji	Zamknij aplikację i uruchom ją ponownie. Sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania w stosownym sklepie z aplikacjami.
Aplikacja uruchamia się, ale nie skanuje obrazów	Zamknij aplikację i uruchom ją ponownie. Upewnij się, że głowica jest naładowana. Jeśli głowica jest naładowana, skontaktuj się z działem wsparcia.
Problemy z obrazowaniem	
Gorsza jakość obrazu	Sprawdź, czy używana jest odpowiednia ilość zatwierdzonego celu przewodzącego ultradźwięki. Jeśli jakość nie ulega poprawie, skontaktuj się z działem wsparcia.
Pusty ekran lub ekran nie aktualizuje się	Zamknij aplikację i uruchom ją ponownie. Odejmij głowicę od platformy mobilnej (urządzenia mobilnego), po czym podłącz ją ponownie.

Problem	Rozwi zanie
Pogorszenie jako ci obrazu lub wyst powanie artefaktów obrazu	<p>Upewni si , e stosowane jest wła ciwe ustawienie wst pne i e gł boko jest odpowiednia dla skanowanej anatomii.</p> <p>Sprawdzi , czy jasno na ekranie jest ustawiona na zalecane 65%.</p> <p>W celu ustalenia, czy głowica jest uszkodzona, aktywowa autotest głowicy. Szczegółowe informacje, patrz Wykonywanie testu diagnostycznego głowicy [90]</p>
Problemy z badaniem	
Nie mo na wczyta badania; badanie pozostaje w skrzynce nadawczej	<p>Sprawdzi , czy urz dzenie mobilne ma wł czon funkcj ł czno ci sieciowej (Wi-Fi lub ł czno komórkowa).</p> <p>Usługa Butterfly Cloud mo e by w trakcie konserwacji lub jest niedost pna. Spróbowa ponownie pó niej.</p>
Problemy dotycz ce głowicy	
Powracaj cy problem z podł czeniem głowicy	Wykona twardy reset:
Głowica nie ładuje si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odł czy głowic od urz dzenia mobilnego. 2. Naciśn i przytrzyma wci ni ty przycisk wska nika akumulatora głowicy przez 10-15 sekund a diody LED b d miga . 3. Powtórzy krok 2 a nast pne ponownie podł czy głowic do urz dzenia. 4. Konieczne mo e by ładowanie głowicy przez co najmniej sze (6) godzin.
Alerty i komunikaty aplikacji	
Aplikacja uruchamia si , ale nie mo na si zalogowa : Wymagany kod dost pu do urz dzenia	<p>Oznacza to, e urz dzenie mobilne nie ma kodu dost pu. Butterfly iQ wymaga, aby urz dzenie mobilne miało ustawiony kod dost pu, co pozwoli zapewni bezpiecze stwo danych pacjenta. Stuknij opcj Ustawienia na urz dzeniu, aby aktywowa i skonfigurowa kod dost pu do urz dzenia mobilnego.</p>
Aplikacja uruchamia si , ale nie mo na si zalogowa : Bł d logowania	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź , czy urz dzenie mobilne ma wł czon funkcj ł czno ci sieciowej (Wi-Fi lub ł czno komórkowa). • Podj prób ponownego wprowadzenia danych logowania. • Zresetowa hasło w oknie przegl darki na komputerze stacjonarnym, aby uzyska dost p do Butterfly Cloud (cloud.butterflynetwork.com) <p>Je eli powy sze czynno ci nie rozwi problemu, mo e to wskazywa , e usługa Butterfly Cloud wła nie przechodzi konserwacj lub jest niedost pna. Spróbowa ponownie pó niej.</p>
Wy wietla si alert Wycofanie sprz tu	Po wy wietleniu tego alertu nie mo na u ywa głowicy do obrazowania. Dotkn opcji Skontaktuj si z działem wsparcia i post powa zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Wy wietla si alert Wymuszone wylogowanie	Oznacza to, e urz dzenie mobilne nie ma kodu dost pu. System Butterfly iQ wymaga, aby urz dzenie mobilne miało ustawiony kod dost pu, co pozwoli zapewni bezpiecze stwo danych pacjenta. Dotkn opcji Ustawienia , aby aktywowa i skonfigurowa kod dost pu do urz dzenia mobilnego.
Wy wietla si alert Głowica tymczasowo wył czona	Ten alert pojawia si , gdy urz dzenie mobilne nie zostało podł czone do Internetu w ci gu ostatnich 30 dni. Nawiz ponownie ł czno z Internetem i dotkn opcji Od wie .
Alert Skanowanie mo na wznowi po zako czeniu stygni cia	Ten alert jest wy wietlany, gdy głowica jest zbyt gor ca na skanowanie. System ogranicza temperatur , w jakiej mo liwy jest kontakt głowicy z ciałem pacjenta i nie podejmuje skanowania w temperaturze 43°C lub wy szej. System generuje ten alert przed wył czeniem. Podczas wy wietlania tego komunikatu mo na kontynuowa skanowanie, dopóki nie rozpocznie si procedura automatycznego stygni cia. Automatyczne stygni cie jest uruchamiane w celu zapewnienia bezpiecze stwa pacjenta. Skanowanie zostanie wznowione, gdy procedura automatycznego stygni cia obni y temperatura głowicy.

**PRZESTROGA!**

Zignorowanie alertów i komunikatów aplikacji mo e skutkowa brakiem mo liwo ci podj cia pracy przez system.



UWAGI

- Je eli nie mo na rozwi za problemu, nale y zanotowa problem i zgłosi go w dziale wsparcia w celu uzyskania pomocy. Wi cej informacji, patrz [Wsparcie \[101\]](#).
- Je eli w trakcie rozwi zywania problemu oka e si , e problemem jest stan zdrowia pacjenta, a nie urz dzenie mobilne, niezwłocznie wezwa lekarza.
- Aby zgłosi reklamacj lub zdarzenie, skontaktowa si z programem zgłaszania problemów FDA MedWatch pod numerem: 1-800-332-1088 lub za po rednictwem Internetu: www.fda.gov/Safety/MedWatch/.

18.2. Rozwi zywanie problemów z przegrzaniem głowicy

W przeciwie stwie do tradycyjnych systemów ultrad wi kowych z kryształami piezoelektrycznymi, głowica Butterfly wykorzystuje technologii Ultrasound-on-chip, a tak e akumulator wewn trz głowicy.

Nagrzewanie głowicy podczas skanowania i ładowania jest normalne. Niektóre ustawienia wst pne powoduj wi ksze zu ycie energii ni inne, co oznacza, e wzrost temperatury mo e nast pi szybciej.

Czynniki, które mog wpływa na ciepło głowicy:

- Rodowisko otoczenia.
- Temperatura głowicy na pocz tku skanowania
- Czas nieprzerwanego skanowania
- Okresy bezczynno ci mi dzy kolejnymi operacjami skanowania
- Wybrano ustawienie wst pne i tryb
- Funkcja inicjowania automatycznego chłodzenia

Alarm temperatury głowicy

Gdy szacowana temperatura głowicy osi gnie 41,5°C, czyli zacznie zbli a si do punktu, w którym jest zbyt ciepła do operacji skanowania, na dole ekranu pojawi si ostrze enie.

Gdy ten komunikat ostrzegawczy jest wy wietlany, mo na kontynuowa skanowanie, dopóki głowica nie przejdzie do stanu automatycznego chłodzenia.

Gdy temperatura kontaktu z ciałem osi gnie 43°C, automatycznie wł czana jest funkcja chłodzenia. Aplikacja Butterfly b dzie nadal dost pna podczas działania funkcji automatycznego chłodzenia. Nie b dzie to mie wpływu na dane trwaj cego badania (obrazy i nagrania).

Skanowanie mo na wznowi po tym, jak funkcja automatycznego chłodzenia obni y szacowan temperaturę głowicy do 38,5°C.

Oczekiwany czas nieprzerwanego skanowania w ustawieniu wst pnym o du ej mocy zale y od modelu głowicy. Wynosi około 10–25 minut od rozpocz cia skanowania za pomoc głowicy w temperaturze otoczenia (~25°C). W systemie Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3, je li zdejmiesz głowic z podkładki ładuj cej przed zako czeniem ładowania albo natychmiast po nim, poczekaj na jej ostygni cie zanim jej u yjesz.

Rozpocz cie sesji skanowania, gdy głowica jest chłodna, pozwoli zoptymalizowa czas skanowania.

Temperatura głowicy podczas ładowania

Nagrzewanie głowicy podczas ładowania jest normalne, zwłaszcza w systemie Butterfly iQ/ iQ+, który wykorzystuje ładowanie bezprzewodowe (o którym wiadomo, e generuje ciepło podczas ładowania). Je li w systemie Butterfly iQ/ iQ+ głowica przegrzewa si podczas ładowania, zapoznaj si z najlepszymi praktykami dotycz cymi

umieszczenia głowicy w zależności od modelu ładowarki, ponieważ nieprawidłowe umieszczenie głowicy na podkładce ładowczej może zwiększyć temperaturę głowicy podczas ładowania.

18.3. Rozwiązywanie problemów z ładowaniem

Jeśli głowica pozostaje w stanie bezczynności przez dłuższy okres, może nastąpić całkowite rozładowanie akumulatora, przez co głowica nie będzie się ładować. Zwykle można ją ponownie uruchomić, wykonując poniższe kroki.

Butterfly iQ3 Rozwiązywanie problemów

1. Podłącz ładowarkę ze stykiem magnetycznym do dostarczonego zasilacza i podłącz zasilacz bezpośrednio do gniazdka elektrycznego, używając wyłącznie dostarczonego sprzętu firmy Butterfly. Nie używaj gniazdka podłączonego do ściemniacza. Nie używaj listwy przeciwprzepięciowej. Nie używaj listwy zasilającej.
2. Umieść głowicę Butterfly iQ3 na ładowarce na pięć minut.
3. Gdy urządzenie Butterfly iQ3 znajduje się na ładowarce, zresetuj je. W tym celu przytrzymaj czerwony przycisk przez 10–15 sekund.
4. Pozostaw głowicę Butterfly iQ3 na ładowarce na noc lub na co najmniej 6 godzin.
5. Zresetuj Butterfly iQ3, przytrzymując przycisk wskaźnika naładowania akumulatora przez 10–15 sekund. Diody LED wskaźnika naładowania akumulatora powinny migać.
6. Ponownie podłącz głowicę Butterfly iQ3 do urządzenia mobilnego.
7. Jeśli nadal występują problemy z ładowaniem, skontaktuj się z działem wsparcia Butterfly pod adresem <http://support.butterflynetwork.com/>.

Butterfly iQ/ iQ+ Rozwiązywanie problemów

1. Najpierw sprawdź, czy ładowarka działa. Ładowarka Butterfly powinna ładować każde urządzenie mobilne, które łączy się bezprzewodowo. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania ładowarki i prawidłowego umieszczenia głowicy na podkładce ładowczej, patrz [Ładowarka akumulatora głowicy \[24\]](#).
 - Podłącz czajnik ładowarki Butterfly bezpośrednio do gniazdka ściemniacza, używając wyłącznie dostarczonego sprzętu Butterfly. Nie używaj gniazdka podłączonego do ściemniacza. Nie używaj listwy przeciwprzepięciowej. Nie używaj listwy zasilającej.
 - Użyj wyłącznie zatwierdzonej podkładki do ładowania Butterfly.
2. Po sprawdzeniu, czy ładowarka działa, umieść urządzenie Butterfly na ładowarce na pięć minut.
3. Gdy głowica Butterfly jest na ładowarce, zresetuj ją. Aby to zrobić, przytrzymaj przycisk wskaźnika naładowania akumulatora przez 10-15 sekund.
4. Pozostaw głowicę Butterfly na ładowarce na noc lub na co najmniej 6 godzin.
5. Zresetuj głowicę Butterfly, przytrzymując przycisk wskaźnika naładowania akumulatora przez 10-15 sekund. Diody LED wskaźnika naładowania akumulatora powinny migać.
6. Ponownie podłącz głowicę Butterfly do urządzenia mobilnego.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą rozwiązać problemu, wykonaj poniższe kroki dotyczące rozwiązywania problemów z głowicą w aplikacji:

1. Zaloguj się do aplikacji Butterfly iQ i przejdź do ekranu skanowania.
2. Podłącz głowicę i odczekaj co najmniej 5 sekund.
3. Wyświetli się komunikat („Podłączono, ale nie można się połączyć?”). Dotknij opcji „Uruchom rozwiązywanie problemów”, aby kontynuować.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów wyświetlanymi na ekranie.
5. Jeśli nadal występują problemy z ładowaniem, skontaktuj się z działem wsparcia Butterfly pod adresem <http://support.butterflynetwork.com/> i podaj następujące informacje:

- Numer seryjny znajduj cy si z tyłu głowicy.
- Odpowiedzi na nast puj ce pytania:
 - Jaki kolor jest widoczny na podkładce do ładowania po umieszczeniu na niej głowicy?
 - Jaki jest wzór lub sekwencja wiecienia, gdy głowica zostaje umieszczona na podkładce?
 - Jaki wzór jest widoczny podczas ładowania?
- W celach sprawozdawczych prosimy o podanie informacji, czy w wyniku tego problemu wyst piły jakiegokolwiek obra enia pacjenta lub u ytkownika, znacz ce klinicznie opó nienie w leczeniu lub diagnozie, bł dna diagnoza lub zdarzenie niepo dane.

19. Wsparcie

Niniejszy rozdział zawiera dane kontaktowe na wypadek konieczności zwrócenia się o pomoc w sprawie głowicy i aplikacji Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3.

19.1. Kontakt z działem wsparcia firmy Butterfly

Butterfly Network, Inc.

1600 District Ave

Burlington, MA 01803 USA

Nr telefonu: +1 (855) 296-6188

Zapytania ogólne: info@butterflynetwork.com

Wsparcie i serwis: support@butterflynetwork.com

Witryna internetowa: www.butterflynetwork.com



Autoryzowany przedstawiciel w Europie

Emergo Europe B.V.

Westervoortsedijk 60

6827 AT Arnhem

The Netherlands

Sponsor australijski

Emergo Australia

Level 20, Tower II

Darling Park

201 Sussex Street

Sydney, NSW 2000

Australia



Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii

MedEnvoy Switzerland

Gotthardstrasse 28

6302 Zug

Szwajcaria

19.2. Kontakt z działem wsparcia za pośrednictwem aplikacji Butterfly iQ

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z działem wsparcia Butterfly poprzez aplikację Butterfly iQ i przesłanie prośby o pomoc.

Aby uzyskać wsparcie:

1. Na ekranie obrazowania dotknij strzałki w dół w lewym górnym rogu.
2. Dotknij awatara w prawym dolnym rogu.

- Przejdź do sekcji **Kontakt z działem wsparcia**, aby wysłać wiadomość bezpośrednio do naszego zespołu obsługi klienta.

20. Parametry

Niniejszy rozdział podaje parametry techniczne głowicy i oprogramowania Butterfly iQ. Zawiera ponadto informacje prawne oraz instrukcje dotyczące recyklingu i usuwania sprzętu.

20.1. Wymagania dotyczące urządzenia mobilnego



OSTRZEŻENIE!

Nie używaj aplikacji Butterfly iQ w urządzeniu mobilnym, które nie spełnia minimalnych wymagań. Korzystanie z aplikacji Butterfly iQ w urządzeniu mobilnym niespełniającym minimalnych wymagań może negatywnie wpływać na działanie systemu i jako obrazu, a co za tym idzie, przyczyni się do postawienia błędnego rozpoznania.

System Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 działa na wielu urządzeniach Apple i Android. Aby uzyskać najnowszy list kompatybilnych urządzeń mobilnych, odwiedź stronę support.butterflynetwork.com.



UWAGA

Aplikacja Butterfly iQ nie wpływa na ustawienia systemu operacyjnego urządzenia mobilnego.

20.2. Parametry systemu

Tabela 14. Parametry systemu

Element	Butterfly iQ	Butterfly iQ+	Butterfly iQ3
Wymiary głowicy	185 x 56 x 35 mm (7.2 x 2.2 x 1.4 in.)	185 x 56 x 35 mm	152 x 52 x 37 mm (5,98 x 2,05 x 1,45 cala)
Ciężar głowicy	313 g	309 gramów	300 g (0,66 funta)
Zasilanie	Akumulator (z możliwością wielokrotnego ładowania)		
Okres użytkowania akumulatora	2 godziny w trybie B (typowy nowy akumulator w temperaturze 25°C). 2 godziny odnosi się do skanowania cięgiego w przeciwieństwie do tradycyjnych modeli skanowania.		1,25 godz. w trybie B (typowy nowy akumulator w temperaturze 25°C). 1,25 godz. odnosi się do cięgiego skanowania przy maksymalnym zużyciu energii w porównaniu z tradycyjnymi sposobami skanowania.
Języki	Interfejs użytkownika i towarzysząca mu dokumentacja zostały przetłumaczone na język angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, polski, portugalski, holenderski, duński, norweski, szwedzki i fiński.		
Wyświetlacz	Zróżnicowany		
Minimalna/maksymalna głębokość skanowania	min. 1 cm / maks. 30 cm ^a		
Czyp ultradźwiękowy	Zintegrowany czip CMOS		
Przetworniki	CMUT, ok. 9000 elementów		
Zakres częstotliwości:	1–10 MHz ^b		1–12 MHz
System operacyjny	<ul style="list-style-type: none"> W przypadku urządzeń Apple wymagany jest system iOS w wersji 16.0 lub nowszej. Brak zgodności z wersjami beta lub niepublikowanymi. W przypadku urządzeń mobilnych Google Pixel, OnePlus i Samsung wymagany jest system Android w wersji 10 lub nowszej. Brak zgodności z wersjami beta lub niepublikowanymi. 		

^aButterfly iQ+ Bladder wykorzystuje tylko ustawienie domyślne Bladder, w związku z czym głębokość skanowania jest ograniczona od 5 cm do 20 cm.

^bButterfly iQ+ Bladder wykorzystuje tylko ustawienie domyślne Bladder, dlatego dostępny zakres częstotliwości wynosi 1–5 MHz.

20.3. Ładowarka akumulatora głowicy

Tabela 15. Butterfly iQ/ iQ+ Specyfikacja ładowarki




Podkładka do ładowania głowicy			
Element	Parametr		
Standard ładowania bezprzewodowego	Spełnia wymagania Qi		
Napięcie wejściowe	DC 5V / 2A		
Interfejs wejściowy	Micro-USB		
Moc ładowania bezprzewodowego	10W	10W	5W
Wydajność ładowania bezprzewodowego	> 73%		
Zabezpieczenie	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie nadprądowe		
Wymiary	121 x 62 x 11mm	121 x 62 x 19mm	121 x 62 x 19mm
Kolor	Czarny/Niebieski	Czarny	Czarny

Tabela 16. Butterfly iQ3 Specyfikacja ładowarki

Element	Parametr
Kabel ładowania głowicy (Wymiary podano w mm)	
Standard ładowania	Specyfikacja zasilania USB, wersja 3.0
Napięcie wejściowe	DC 9 V / 2 A
Interfejs wejściowy	Port USB-C
Typowa moc ładowania	< 8,0 W
Wydajność ładowania	>80%
Zabezpieczenie	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie nadprądowe, styk wykrywania kontaktu
Wymiary	Zobacz zdjęcie powyżej w sekcji „Kabel do ładowania głowicy”
Kolor	Czarny

20.4. Rodowiskowe warunki pracy

Tabela 17, „Rodowiskowe warunki pracy” [106] podaje Rodowiskowe warunki dotyczące wyładowania głowicy Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3. Szczegółowe informacje na temat urządzenia mobilnego, na którym uruchamiana jest aplikacja Butterfly iQ, patrz dokumentacja dołączona do urządzenia mobilnego.

Tabela 17. Rodowiskowe warunki pracy

Element	Limity robocze	
	Butterfly iQ/ iQ+	Butterfly iQ3
Wilgotność wzgl. dna	Pomiędzy 18 a 93%, bez kondensacji	Od 15% do 90% bez kondensacji
Wysokość n.p.m.	Od 46 m (150 stóp) poniżej poziomu morza do 3048 m (10 000 stóp) nad poziomem morza	Pomiędzy 381 m (1250 stóp) poniżej poziomu morza a 4 572 m (15 000 stóp) nad poziomem morza
Temperatura pracy	Od 5°C do 39°C	Od 0°C do 40°C (przy wilgotności względnej 15%)
Temperatura krótkiego przechowywania	Głowicę można przechowywać przez trzy dni w temperaturze od -20°C do 50°C	Głowicę można przechowywać przez trzy dni w temperaturze od -40°C do 50°C

Biorąc pod uwagę, że urządzenie jest portowne, oczekuje się, że będzie ono narażone na różne warunki środowiska, w tym na pogotowiu ratunkowym, w szpitalu i w domu. Choć urządzenie zostało zaprojektowane do bezpiecznej pracy w szerokim zakresie środowisk i w zmiennych warunkach, należy zachować ostrożność, aby chronić je przed ekstremalnymi temperaturami, wstrząsami, upadkami lub innymi skrajnymi warunkami. Zapoznaj się z Tabelą 18, „Zgodność środowiskowa” [107] w celu uzyskania podsumowania zgodności środowiskowej.

Tabela 18. Zgodno rodowiskowa

Zgodno rodowiskowa	Butterfly iQ	Butterfly iQ+	Butterfly iQ3
IEC 60601-1-11, do u ytku domowego	-	✓	✓
IEC 60601-1-12, rodowisko pogotowia ratunkowego	-	✓	✓

20.5. Zgodno elektromagnetyczna (EMC)

System Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 jest przeznaczony do diagnostycznego obrazowania ultrad wi kowego i pomiaru struktur anatomicznych oraz płynów przez wykwalifikowanych i przeszkolonych lekarzy. Pola elektromagnetyczne mog jednak powodowa zniekształcanie lub zaburzenie tych informacji, co wpływa niekorzystnie na działanie urz dzenia.

System Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 opracowano pod k tem stosowania w rodowiskach elektromagnetycznych okre lonych w [Tabela 19, „Emisje elektromagnetyczne” \[107\]](#) i [Tabela 20, „Odporno elektromagnetyczna” \[108\]](#). Aby unikn wypromieniowanych i przewodzonych zaburze elektromagnetycznych, klient lub u ytkownik systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 powinien zapewni , e system jest u ywany w ramach tych specyfikacji.

Tabela 19. Emisje elektromagnetyczne

Wytyczne i deklaracje producenta — emisje elektromagnetyczne			
Test emisji	Zgodno		
	Butterfly iQ	Butterfly iQ+	Butterfly iQ3
Emisje RF CISPR 11EN55011	Grupa 1 ^a .		
Emisje RF CISPR 11EN55011	Klasa A ^b .	Klasa B ^c .	
Emisje cz stotliwo ci harmonicznych wg normy EN/IEC 61000-3-2	Nie dotyczy		
Wahania napi cia / emisje migotania wg normy EN/IEC 61000-3-3	Nie dotyczy		

^aSystem ultrad wi kowy Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 wykorzystuje energi fal o cz stotliwo ci radiowej tylko w ramach funkcji wewn trznych. St d te emisje te s bardzo niskie i nie powoduj zakłóce działania urz dze elektronicznych znajduj cych si w pobl u.

^bSystem ultrad wi kowy Butterfly iQ nadaje si do u ytku we wszystkich obiektach, z wyj tkiem budynków mieszkalnych i budynków bezpo rednio po czonych z publicz n sieci energetyczn dostarczaj c pr d o niskim napi ciu do budynków mieszkalnych.

^cSystem ultrad wi kowy Butterfly iQ+/ iQ3 nadaje si do u ytku we wszystkich obiektach, w tym budynkach mieszkalnych i budynkach bezpo rednio po czonych z publicz n sieci energetyczn dostarczaj c pr d o niskim napi ciu do budynków mieszkalnych.

Tabela 20. Odporno elektromagnetyczna

Test odporno ci	EN/IEC 60601 — poziom testowy		Poziom zgodno ci		rodowisko elektromagnetyczne — wytyczne
	Butterfly iQ	Butterfly iQ+/ iQ3	Butterfly iQ	Butterfly iQ+/ iQ3	
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) EN/IEC 61000-4 -2	±8 kV styk ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV powietrze		±8 kV styk ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV powietrze		Podłogi powinny by drewniane, betonowe lub pokryte płytkami ceramicznymi. W przypadku podłóg pokrytych materiałem syntetycznym wilgotno wzgl dna powinna wynosi co najmniej 30%.
Sygnały przej ciowe / wyładowania elektryczne EN/IEC 61000-4-4	Nie dotyczy. To urz dzenie nie jest zasilane pr dem przemiennym.		Nie dotyczy.		Jako zasilania sieciowego powinna by na poziomie typowym dla warunków komercyjnych lub szpitalnych.
Pole magnetyczne o cz stotliwo ci zasilania (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m, 50 Hz lub 60 Hz 3 orientacje ortogonalne		30 A/m 50 i 60 Hz		Pola magnetyczne o cz stotliwo ci zasilania powinny by na poziomie charakterystycznym dla typowej lokalizacji w typowych warunkach komercyjnych lub szpitalnych.
Przewodzone cz stotliwo ci fal radiowych EN/IEC 61000-4-4	3 V 0,15 MHz– 80 MHz 6 V w pasmach ISM pomi dzy 150 kHz a 80 MHz 80% AM przy 1 kHz		3 V 0,15 MHz– 80 MHz 6 V w pasmach ISM pomi dzy 150 kHz a 80 MHz 80% AM przy 1 kHz		Przeno nych i mobilnych urz dze komunikacyjnych RF nie nale y u ywa bli ej adnej cz ci układu ultrad wi kowego Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3, w tym przewodów, ni zalecana odległo obliczona na podstawie równania dotycz ce go cz stotliwo ci nadajnika.
Wypromieniowane cz stotliwo ci fal radiowych IEC 61000-4-3	10 V/m Od 80 MHz do 2,7 GHz	10 V/m Od 80 MHz do 6 GHz	10 V/m Od 80 MHz do 2,7 GHz	10 V/m Od 80 MHz do 6 GHz	Równania i kluczowe zalecenia odległo ci przedstawiono w Odległo ci [109] . Nat enia pól ze stałych nadajników fal radiowych, ustalone w wyniku pomiarów elektromagnetycznych w terenie, ^a powinny by ni sze ni poziom zgodno ci w ka dym zakresie cz stotliwo ci. ^b
Spadki napi cia, przerwy w napi ciu EN/IEC 61000-4-11:2004	Nie dotyczy	Przetestowano tylko dla Butterfly iQ3: 0%, 0,5 cyklu przy 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 315° 0%, 1 cykl 70%, 25/30 cykli 0% 250/300 cykli	Nie dotyczy	Przetestowano tylko dla Butterfly iQ3: 0%, 0,5 cyklu przy 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 315° 0%, 1 cykl 70%, 25/30 cykli 0% 250/300 cykli	EUT skonfigurowano zgodnie z planem testu i podł czono do symulatora zaniku/odchylenia, a oprogramowanie zostało ustawione na wykonywanie testów odporno ci na spadki napi cia, odchylenia i przerwy.
Odporno na zbli eniowe pola magnetyczne IEC 61000-4-39:2017	Nie dotyczy	Przetestowano tylko dla Butterfly iQ3: 30 kHz CW przy 8 A/m 134,2 kHz, 2,1 kHz PM przy 65 A/m 13,56 MHz, 50 kHz PM przy 7,5 A/m	Nie dotyczy	Przetestowano tylko dla Butterfly iQ3: 30 kHz CW przy 8 A/m 134,2 kHz, 2,1 kHz PM przy 65 A/m 13,56 MHz, 50 kHz PM przy 7,5 A/m	EUT umieszczono na nieprzewod cym stole. Cewka promieniuj ca jest umieszczona równolegle w odległo ci 50 mm od powierzchni EUT. Wydajno EUT była monitorowana przez 10 sekund. Procedura ta została powtórzona dla ka dego miejsca na EUT, które podlega o wietleniu przez pola magnetyczne podczas normalnego u ytkowania.

^aNat enia pól ze stałych nadajników, takich jak stacje bazowe radiotelefonów (komórkowych/bezprzewodowych) i przeno ne radia I dowe, radio amatorskie, sygnały radiowe AM i FM oraz sygnały transmisji telewizyjnej nie mo na dokładnie oszacowa teoretycznie. Aby oceni rodowisko elektromagnetyczne wytwarzane przez stałe nadajniki fal radiowych, nale y rozwa y pomiary elektromagnetyczne w terenie. Je eli zmierzone nat enie pola w miejscu u ytkowania systemu ultrad wi kowego Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 przekracza podany powy ej odpowiedni poziom zgodno ci fal radiowych, obserwowa system ultrad wi kowy Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 , aby zweryfikowa jego prawidłowe działanie.

W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania, mogą być niezbędne dodatkowe rodki, takie jak zmiana kierunku lub umiejscowienia systemu ultradźwiękowego Butterfly iQ/iQ+/iQ3.

^bW zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być niższe niż 3 V/m.

20.5.1. Odległości

Urządzenia takie, jak telefony komórkowe/mobilne, nadajniki i nadajnik-o odbiorniki radiowe, transmitują fale radiowe (RF), które mogą wywoływać zakłócenia. System Butterfly iQ/iQ+/iQ3 jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym emitowane zakłócenia o częstotliwościach fal radiowych są kontrolowane.

Jeżeli wystąpi wypromieniowane i przewodzone zakłócenia elektromagnetyczne i zakłócone zostanie działanie systemu, użytkownik lub klient powinien podjąć działania mające na celu ograniczenie zakłóceń, w tym przeniesienie systemu lub zmianę jego ustawienia.

Tabela 21. Zalecane odległości

Zalecane odległości pomiędzy przenośnym i komórkowym sprzętem telekomunikacyjnym emitującym fale o częstotliwościach radiowej a urządzeniem ultradźwiękowym			
Urządzenie ultradźwiękowe jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym emitowane zakłócenia o częstotliwościach fal radiowych są kontrolowane. Nabywca lub użytkownik urządzenia ultradźwiękowego może zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez utrzymanie podanej poniżej minimalnej odległości pomiędzy przenośnym i komórkowym sprzętem telekomunikacyjnym emitującym fale o częstotliwościach radiowej (nadajnikami) a urządzeniem ultradźwiękowym, adekwatnie do maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu telekomunikacyjnego.			
Znamionowa maksymalna moc wyjściowa nadajnika (P, w watach)	Odległość od cz. stłw. ci nadajnika (d w metrach)		
	Od 150 kHz do 80 MHz	Od 80 MHz do 800 MHz	Od 800 MHz do 2,5 GHz
	$d = 1.2\sqrt{P}$	$d = 1.2\sqrt{P}$	$d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej zalecaną odległość d w metrach (m) można oszacować za pomocą równania odnoszącego się do częstotliwości nadajnika, gdzie P oznacza maksymalną moc wyjściową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta nadajnika. Uwaga 1: W przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie wyższy zakres częstotliwości. Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych wpływa pochłanianie i odbijanie się ich od budowli, obiektów i ludzi.			

20.6. Wyjciowa moc akustyczna

Bezpieczeństwo związane z ultradźwiękami

Diagnostyczne procedury ultradźwiękowe powinny być w sposób bezpieczny oraz zgodnie z przewidzianym zastosowaniem przeprowadzane przez przeszkolonych lekarzy. Butterfly iQ/iQ+/iQ3. Wartości graniczne bezpieczeństwa akustycznego dla wskaźników termicznych (TI) oraz mechanicznych (MI) ustalono zgodnie z obowiązującymi w branży normami, tj. dla urządzenia Track 3, i są one widoczne na ekranie wyświetlacza. Wskaźnik termiczny (TI) jest wyświetlany jako odnoścy się do tkanki mechanicznej (TIS) lub kości (TIB). Tylko jeden z tych wskaźników jest wyświetlany w danym momencie w oparciu o kliniczne ustawienia domyślne wybranego badania. Wartości wskaźnika termicznego (TI) i wskaźnika mechanicznego (MI) są wyświetlane w odstępach co 0,1 w zakresie od 0,0 do maksymalnej wartości wyjściowej.

Wskaźnik termiczny (TI) jest szacunkową wartością wyrażającą wzrost temperatury tkanki mechanicznej, a jego limity ustalono na podstawie:

- Normy NEMA, UD 3: „Standard wyświetlania wskaźników termicznych i mechanicznych parametrów akustycznych w czasie rzeczywistym na diagnostycznym urządzeniu ultradźwiękowym”, wersja 2 IEC 60601-2-37. Medyczny sprzęt elektryczny. Część 2-37: Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa medycznego sprzętu ultradźwiękowego do diagnostyki i monitorowania

- IEC 62359: 2.0/AMD1:2017, Wydanie 2.0 Ultradźwięki — Charakterystyka terenowa: Metody badania do wyznaczania wskaźników termicznych i mechanicznych związanych z polami ultradźwiękowej w diagnostyce medycznej

Wskaźnik mechaniczny (MI) wyraża szacunkowe prawdopodobieństwo uszkodzenia tkanki spowodowanego kawitacją oraz jego limity (1,9), zgodnie z wytycznymi Amerykańskiej Agencji ds. Leków (FDA) „Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers”.

I_{spta} jest to szczytowa wartość przestrzenna natężenia uśredniona w czasie, a maksymalna I_{spta} wynosi 720 mW/cm², który to limit również pozostaje w zgodzie z wytycznymi FDA „Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers”.

Chociaż te ustawienia wyjściowej mocy akustycznej zostały ograniczone zgodnie z powyższymi normami, nauczelnicy powinni obowiązywać z odrobina szkolenia w zakresie korzystania z urządzeń ultradźwiękowych i posiadania wiedzy na temat biologicznych skutków działania ultradźwięków, jak również ograniczania do minimum ekspozycji pacjenta na potencjalnie szkodliwe skutki i związane ryzyko. Uczelnicy urządzeń ultradźwiękowych powinni dysponować wiedzą w zakresie procedur ultradźwiękowych i umieć wykonywać je z zastosowaniem poziomów mocy wyjściowej oraz czasów ekspozycji zgodnych z zasadą ALARA (tak nisko, jak to realnie jest możliwe). Skrót ALARA oznacza ekspozycję na ultradźwięki utrzymywaną na tak niskim poziomie, jak to jest realnie możliwe, przy jednoczesnej optymalizacji danych diagnostycznych.

Przykładem zasady ALARA jest ultrasonografia połówkowa. Minimalizowanie - na przykład - uśrednienia Dopplera kolorowego, ograniczanie czasu przebywania, skanowanie tylko krytycznych struktur wymaganych do badania oraz unikanie badań z przyczyn innych niż medyczne — wszystkie te działania stanowią przejaw dbałości o zmniejszenie narażenia na energię ultradźwięków.

Wyjciowa niepewność wyświetlania

Wyjciowa dokładność wyświetlania MI i TI zależy od precyzji systemu pomiarowego, założenia liniowego w ramach modelu akustycznego służącego do obliczania parametrów i źródlicowania wyjściowej mocy akustycznej głowic. Firma Butterfly porównuje akustykę wewnątrz i firmy zewnętrznej i potwierdza, że oba pomiary mieszczą się w zalecanej kwantyzacji wyświetlacza wynoszącej 0,2 zgodnie z normami. Należy pamiętać, że wszystkie wartości wskaźników MI i TI wyświetlane w urządzeniu nie przekroczą maksymalnych wartości globalnych (wymienionych w tabelach poniżej) o więcej niż 0,2.

Informacje na temat Track 3

System Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 jest zgodny z ustawieniami parametrów wyjściowych, wyświetlania danych wyjściowych i zasadami bezpieczeństwa ALARA określonymi w zaleceniach Track 3 FDA. Następujące tabele podają globalne maksymalne wartości wskaźników wyjściowej mocy akustycznej dla głowicy i każdego z klinicznych trybów wyjściowych.

Tabela 22. Diagnostyczne wskazania ultrasonograficzne dla Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3

Przetwornik: przetwornik systemu ultradźwiękowego Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3									
Przeznaczenie: Diagnostyczne obrazowanie ultradźwiękowe lub analiza przepływu płynu w organizmie człowieka, jak poniżej:									
Zastosowanie kliniczne		Tryb pracy							
Ogólne (tylko cięka 1)	Określone (cięki 1 i 3)	B	M	Zasilanie	PWD	Kolorowy Doppler	iQ Slice	iQ Fan	Łączony (określi)
Okulistyczny	Okulistyczny	X		X		X	X		Tryb B + kolorowy Doppler Tryb B + Doppler mocy

Przetwornik: przetwornik systemu ultradźwiękowego Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3									
Przeznaczenie: Diagnostyczne obrazowanie ultradźwiękowe lub analiza przepływu płynu w organizmie człowieka, jak poniżej:									
Zastosowanie kliniczne		Tryb pracy							
Ogólne (tylko cieka 1)	Określone (cieka 1 i 3)	B	M	Zasilanie	PWD	Kolorowy Doppler	iQ Slice	iQ Fan	Łączony (okreli)
Obrazowanie płodu i inne	badania płodu / położnictwo,	X	X	X	X	X	X		Tryb B + tryb M Tryb B + kolorowy Doppler Tryb B + Doppler mocy
	Jama brzuszna	X	X	X	X	X	X		Tryb B + tryb M Tryb B + kolorowy Doppler Tryb B + Doppler mocy Tryb B + iQ Slice
	Płuca	X	X					X	Tryb B + tryb M Tryb B + iQ Fan
	ródogoperacyjne (okreli)								
	ródogoperacyjne (Neuro)								
	Laparoskopowe								
	U dzieci	X	X	X			X		Tryb B + tryb M Tryb B + kolorowy Doppler Tryb B + Doppler mocy
	Małe narządy (w tym moczowa, tarczyca i piersi)	X	X	X			X		Tryb B + tryb M Tryb B + kolorowy Doppler Tryb B + Doppler mocy
	Przeznaczskowe u noworodka								
	Przeznaczskowe u osoby dorosłej								
	Przezodbytnicze								
	Przezpochwowe								
	Przezcewkowe								
Przezprzełykowe (pozaserkowe)									

Przetwornik: przetwornik systemu ultradźwiękowego Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3									
Przeznaczenie: Diagnostyczne obrazowanie ultradźwiękowe lub analiza przepływu płynu w organizmie człowieka, jak poniżej:									
Zastosowanie kliniczne		Tryb pracy							
Ogólne (tylko cieka 1)	Określenie (cieka 1 i 3)	B	M	Zasilanie	PWD	Kolorowy Doppler	iQ Slice	iQ Fan	Łączony (określenie)
	układ mięśniowo-szkieletowy (powierzchniowy).	X	X	X		X			Tryb B + tryb M Tryb B + kolorowy Doppler Tryb B + Doppler mocy
	Wewnętrzne trzmielnicowe								
	Inne (konwencjonalne układu mięśniowo-szkieletowego)	X	X	X		X			Tryb B + tryb M Tryb B + kolorowy Doppler Tryb B + Doppler mocy
	Inne (ginekologiczne)	X	X	X		X			Tryb B + tryb M Tryb B + kolorowy Doppler Tryb B + Doppler mocy
	Inne (urologiczne)	X	X	X		X			Tryb B + tryb M Tryb B + kolorowy Doppler Tryb B + Doppler mocy
Sercowy	Kardiologiczne u osoby dorosłej	X	X			X			Tryb B + tryb M Tryb B + kolorowy Doppler
	Kardiologiczne u dziecka	X	X			X			Tryb B + tryb M Tryb B + kolorowy Doppler
	Wewnętrzne trzmielnicowe (kardiologiczne)								
	Trans-esoph. (Cardiac)								
	Wewnętrzne trzmielnicowe								

Przetwornik: przetwornik systemu ultradźwiękowego Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3									
Przeznaczenie: Diagnostyczne obrazowanie ultradźwiękowe lub analiza przepływu płynu w organizmie człowieka, jak poniżej:									
Zastosowanie kliniczne		Tryb pracy							
Ogólne (tylko cieka 1)	Określone (cieka 1 i 3)	B	M	Zasilanie	PWD	Kolorowy Doppler	iQ Slice	iQ Fan	Łączony (określi)
Naczynie obwodowe	Naczynie obwodowe	X	X	X		X			Tryb B + tryb M Tryb B + kolorowy Doppler Tryb B + Doppler mocy
	Inne (tętnica szyjna, zakrzepica żył głębokich, badania tętnicze)	X	X	X		X			Tryb B + tryb M Tryb B + kolorowy Doppler Tryb B + Doppler mocy
	Inne (wytyczne proceduralne)	X	X	X	X	X			Tryb B + tryb M Tryb B + kolorowy Doppler Tryb B + Doppler mocy

20.6.1. Wartości graniczne wyjściowej mocy akustycznej

System ultradźwiękowy emituje wyjściową moc akustyczną poniżej odpowiednich wartości granicznych dla każdego zastosowania wymienionego poniżej.

Zastosowania nieokulistyczne:

System Probe	$I_{SPTA.3}$	TI Type	TI Value	MI	$I_{PA.3}@MI_{max}$
Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3	146,47 mW/cm ²	TIB	0.85	0.51	102 W/cm ²

Zastosowania okulistyczne:

System Probe	$I_{SPTA.3}$	TI Type	TI Value	MI	$I_{PA.3}@MI_{max}$
Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3	8.12 mW/cm ²	TIB	0.047	0.162	6.48 W/cm ²

For additional information please visit support.butterflynetwork.com.

20.6.2. Tabele z zestawieniem mocy akustycznej



UWAGA

Aby uzyskać pełne definicje pomiarów używanych w [Tabele z zestawieniem mocy akustycznej \[113\]](#) należy zapoznać się z tabelą 201.101 zawartą w normie IEC 60601-2-37.

Butterfly iQ Tabele akustyczne

Tabela 23. Butterfly iQ Tryb B

Index Label			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	Non-Scan		Non-Scan	
					$A_{\text{aprt}} < 1 \text{ cm}^2$	$A_{\text{aprt}} > 1 \text{ cm}^2$		
Maximum Index Value			0.485	0.02	-	-	-	(a)
Assoc Acoustic Parameter	Pr.3	(MPa)	0.718					
	W_o	(mW)		4.40	-		-	(a)
	min of [$W_{.3}(z_1)$, $I_{TA.3}(z_1)$]	(mW)				-		
	z_1	(cm)				-		
	z_{bp}	(cm)				-		
	z_{sp}	(cm)	5.83				-	
	$d_{eq}(Z_{sp})$	(cm)					-	
	f_c	(MHz)	2.19	2.41	-	-	-	(a)
	Dim of A_{aprt}	X (cm)		2.0	-	-	-	(a)
Y (cm)			1.3	-	-	-	(a)	
Other Information	PD	(μsec)	0.295					
	PRF	(Hz)	1066					
	$p_r @ PII_{\text{max}}$	(MPa)	1.11					
	$d_{eq} @ PII_{\text{max}}$	(cm)					-	
	Focal Length	FLx (cm)		10.0	-	-		
		FLy (cm)		INF	-	-		
$I_{PA.3} @ MI_{\text{max}}$	(W/cm ²)	54.6						
Operating Control Conditions	Ustawienie wst pne: FAST		✓					
	Ustawienie wst pne: warstwa gł boka jamy brzusznej			✓				
Uwaga 1:	Podawanie informacji nie jest konieczne dla dowolnego określenia TIS niedającego wartości maksymalnej TIS dla tego trybu.							
Uwaga 2:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do TIC dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji dotyczących MI i TI nie jest konieczne, jeżeli spełnia warunki klauzul wyłączeniowych podanych w punktach 51.2aa) oraz 51.2 dd).							
(a)	Przeznaczenie nie obejmuje zastosowań cefalicznych, toteż TIC nie jest obliczany.							

Tabela 24. Butterfly iQTryb B + kolorowy

Index Label			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	Non-Scan		Non-Scan	
					$A_{aprt < 1}$ cm ²	$A_{aprt > 1}$ cm ²		
Maximum Index Value			0.485	-	-	0.13	0.29	(a)
Assoc Acoustic Parameter	Pr.3	(MPa)	0.718					
	W _o	(mW)		-	-		17.4	(a)
	min of [W _{.3(z₁), I_{TA.3(z₁)}]}	(mW)				0.74		
	z ₁	(cm)				7.8		
	z _{bp}	(cm)				2.76		
	z _{sp}	(cm)	5.83				7.1	
	d _{eq} (z _{sp})	(cm)					1.84	
	f _c	(MHz)	2.19	-	-	2.49	2.49	(a)
	Dim of A _{aprt}	X (cm)		-	-	2.0	2.0	(a)
Y (cm)			-	-	1.8	1.8	(a)	
Other Information	PD	(μsec)	0.295					
	PRF	(Hz)	1066					
	p _r @PII _{max}	(MPa)	1.11					
	d _{eq} @PII _{max}	(cm)					1.84	
	Focal Length	FLx (cm)		-	-	10.0		
		FLy (cm)		-	-	10.0		
I _{PA.3} @MI _{max}	(W/cm ²)	54.6						
Operating Control Conditions	Ustawienie wst pne: FAST		✓					
	Ustawienie wst pne: p chertz moczowy					✓	✓	
Uwaga 1:	Podawanie informacji nie jest konieczne dla dowolnego określenia TIS niedającego wartości maksymalnej TIS dla tego trybu.							
Uwaga 2:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do TIC dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji dotyczących MI i TI nie jest konieczne, jeżeli spełnia warunki klauzul wyłączeniowych podanych w punktach 51.2aa) oraz 51.2 dd).							
(a)	Przeznaczenie nie obejmuje zastosowań cefalicznych, toteż TIC nie jest obliczany.							

Tabela 25. Butterfly iQTryb B + tryb M

Index Label			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	Non-Scan		Non-Scan	
					$A_{aprt < 1}$ cm ²	$A_{aprt > 1}$ cm ²		
Maximum Index Value			0.485	0.013	-	-	0.012	(a)
Assoc Acoustic Parameter	Pr.3	(MPa)	0.718					
	W _o	(mW)		2.64	-		0.63	(a)
	min of [W _{.3} (z ₁), I _{TA.3} (z ₁)]	(mW)				-		
	z ₁	(cm)				-		
	z _{bp}	(cm)				-		
	z _{sp}	(cm)	5.83				8.3	
	d _{eq} (z _{sp})	(cm)					2.1	
	f _c	(MHz)	2.19	2.41	-	-	1.56	(a)
	Dim of A _{aprt}	X (cm)		2.0	-	-	2.5	(a)
Y (cm)			1.3	-	-	1.3	(a)	
Other Information	PD	(μsec)	0.295					
	PRF	(Hz)	1066					
	P _r @PII _{max}	(MPa)	1.11					
	d _{eq} @PII _{max}	(cm)					2.1	
	Focal Length	FLx (cm)		10.0	-	-		
		FLy (cm)		INF	-	-		
I _{PA.3} @MI _{max}	(W/cm ²)	54.6						
Operating Control Conditions	Ustawienie wst pne: FAST		✓					
	Ustawienie wst pne: warstwa gł boka jamy brzusznej			✓				
	Ustawienie wst pne: kardiologiczne THI						✓	
Uwaga 1:	Podawanie informacji nie jest konieczne dla dowolnego określenia TIS niedającego wartości maksymalnej TIS dla tego trybu.							
Uwaga 2:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do T/C dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji dotyczących MI i TI nie jest konieczne, jeżeli spełnia warunki klauzuli wyłączenia podanych w punktach 51.2aa) oraz 51.2 dd).							
(a)	Przeznaczenie nie obejmuje zastosowań cefalicznych, toteż TIC nie jest obliczany.							

Tabela 26. Butterfly iQTryb B + Doppler mocy

Index Label			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	Non-Scan		Non-Scan	
					$A_{aprt < 1}$ cm ²	$A_{aprt > 1}$ cm ²		
Maximum Index Value			0.485	-	-	0.13	0.29	(a)
Assoc Acoustic Parameter	Pr.3	(MPa)	0.718					
	W _o	(mW)		-	-		17.4	(a)
	min of [W _{.3} (z ₁), I _{TA.3} (z ₁)]	(mW)				0.74		
	z ₁	(cm)				7.8		
	z _{bp}	(cm)				2.76		
	z _{sp}	(cm)	5.83				7.1	
	d _{eq} (z _{sp})	(cm)					1.84	
	f _c	(MHz)	2.19	-	-	2.49	2.49	(a)
	Dim of A _{aprt}	X (cm)		-	-	2.0	2.0	(a)
Y (cm)			-	-	1.8	1.8	(a)	
Other Information	PD	(μsec)	0.295					
	PRF	(Hz)	1066					
	p _r @PII _{max}	(MPa)	1.11					
	d _{eq} @PII _{max}	(cm)					1.84	
	Focal Length	FLx (cm)		-	-	10.0		
		FLy (cm)		-	-	10.0		
I _{PA.3} @MI _{max}	(W/cm ²)	54.6						
Operating Control Conditions	Ustawienie wst pne: FAST		✓					
	Ustawienie wst pne: p chertz moczowy					✓	✓	
Uwaga 1:	Podawanie informacji nie jest konieczne dla dowolnego określenia TIS niedającego wartości maksymalnej TIS dla tego trybu.							
Uwaga 2:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do TIC dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji dotyczących MI i TI nie jest konieczne, jeżeli spełnia warunki klauzuli wyłączenia podanych w punktach 51.2aa) oraz 51.2 dd).							
(a)	Przeznaczenie nie obejmuje zastosowań cefalicznych, toteż TIC nie jest obliczany.							

Tabela 27. Butterfly iQ Doppler fali pulsacyjnej

Index Label			MI	TIS		TIB		TIC
				At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum Index Value			0.21	.0915		0.14		0.10
Index Component Value				0.09	.0408	.0915	0.14	
Assoc Acoustic Parameter	$p_{r,a}$ at Z_{MI}	(MPa)	0.44					
	P	(mW)		4.67		4.67		4.67
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		4.48		4.48		
	Z_s	(cm)			2.87			
	Z_b	(cm)					2.87	
	Z_{MI}	(cm)	2.87					
	$Z_{pii,a}$	(cm)	2.87					
	f_{awf}	(MHz)	4.29	4.29		4.29		4.29
Other Information	pr	(Hz)	3000					
	srr	(Hz)	N/A					
	η_{pps}		1					
	$I_{pa,a}$ at $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	7.56					
	$I_{spta,a}$ at $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	25.15					
	I_{spta} at Z_{pij} or Z_{sii}	(mW/cm ²)	58.82					
	p_r at Z_{pii}	(MPa)	0.68					
Operating Control Conditions	Doppler pulsacyjny A							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wska. nik.							
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchnią” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne, o ile nie do MI i TI dla każdego ZESPÓŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Jeżeli wymagania 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC.							
Uwaga 5:	Jeżeli wymagania 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących MI.							
Uwaga 6:	Niezacienione komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbową. Ustawienie sprężu związane ze wskaźnikiem należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.							
Uwaga 7:	Głębokości Z_{pii} oraz $Z_{pii,a}$ dotyczą TRYBÓW NIESKANOWANIA, natomiast głębokości Z_{sii} oraz $Z_{sii,a}$ dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.							

Butterfly iQ+ Tabele akustyczne

Tabela 28. Butterfly iQ+Tryb B, Biplane, 3D/Maksymalne warto ci MI

Index Label			MI	TIS		TIB		TIC
				At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum Index Value			0.43	0.00388		0.00388		0.0131
Index Component Value				0.00388	0.00388	0.00388	0.00388	
Assoc Acoustic Parameter	$P_{r,a}$ at Z_{MI}	(MPa)	0.76					
	P	(mW)		0.38		0.38		0.38
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		0.26		0.26		
	Z_s	(cm)			2.77			
	Z_b	(cm)					2.73	
	Z_{MI}	(cm)	2.77					
	$Z_{pii,a}$	(cm)	2.77					
	f_{awf}	(MHz)	3.12	3.12		3.12		3.12
Other Information	pr	(Hz)	962.8					
	srr	(Hz)	21.4					
	n_{pps}		1					
	$I_{pa,a}$ at $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	21.75					
	$I_{spta,a}$ at $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	0.71					
	I_{spta} at Z_{pii} or Z_{sii}	(mW/cm ²)	1.28					
	p_r at Z_{pii}	(MPa)	1.02					
Operating Control Conditions			Ustawienie wst pne: pluca					
Uwaga 1:			Tylko jeden warunek działania na wska nik.					
Uwaga 2:			Dane nale y wprowadzi dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchni ” w obu kolumnach dotycz cych TIS i TIB.					
Uwaga 3:			Podawanie informacji nie jest konieczne odno nie do MI i TI dla ka dego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowa przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.					
Uwaga 4:			Je li wymogi 201.12.4.2a s spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie adnych danych w kolumnach dotycz cych TIS, TIB lub TIC					
Uwaga 5:			Je li wymogi 201.12.4.2b s spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie adnych danych w kolumnach dotycz cych MI.					
Uwaga 6:			Niezacieniwane komórki powinny mie przypisan warto liczbow . Ustawienie sprz tu zwi zane ze wska nikiem nale y wprowadzi w sekcji sterowania operacyjnego.					
Uwaga 7:			Gł boko ci Z_{pii} oraz $Z_{pii,a}$ dotycz TRYBÓW NIESKANUJ CYCH, natomiast gł boko ci Z_{sii} oraz $Z_{sii,a}$ dotycz TRYBÓW SKANOWANIA.					

Tabela 29. Butterfly iQ+ Tryb B, Biplane, 3D/Maksymalne warto ci TIS, TIB

Index Label			MI	TIS		TIB		TIC
				At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum Index Value			0.22	0.0153		0.0153		0.0521
Index Component Value				0.0153	0.0153	0.0153	0.0153	
Assoc Acoustic Parameter	$P_{r,a}$ at Z_{MI}	(MPa)	0.41					
	P	(mW)		1.53		1.53		1.53
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		0.91		0.91		
	Z_s	(cm)			3.60			
	Z_b	(cm)					3.57	
	Z_{MI}	(cm)	3.60					
	$Z_{pii,a}$	(cm)	3.60					
f_{awf}	(MHz)	3.55		3.55		3.55		3.55
Other Information	pr	(Hz)	2000.0					
	srr	(Hz)	64.5					
	η_{pps}		1					
	$I_{pa,a}$ at $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	6.27					
	$I_{spta,a}$ at $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	1.59					
	I_{spta} at Z_{pii} or Z_{sii}	(mW/cm ²)	3.84					
P_r at Z_{pii}	(MPa)	0.63						
Operating Control Conditions	Ustawienie wst pne: kardiologia dzieci ca							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wska nik.							
Uwaga 2:	Dane nale y wprowadzi dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchni ” w obu kolumnach dotycz cych TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odno nie do MI i TI dla ka dego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowa przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Je li wymogi 201.12.4.2a s spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie adnych danych w kolumnach dotycz cych TIS, TIB lub TIC							
Uwaga 5:	Je li wymogi 201.12.4.2b s spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie adnych danych w kolumnach dotycz cych MI.							
Uwaga 6:	Niezacienowane komórki powinny mie przypisan warto liczbow . Ustawienie sprz tu zwi zane ze wska nikiem nale y wprowadzi w sekcji sterowania operacyjnego.							
Uwaga 7:	Gł boko ci Z_{pii} oraz $Z_{pii,a}$ dotycz TRYBÓW NIESKANUJ CYCH, natomiast gł boko ci Z_{sii} oraz $Z_{sii,a}$ dotycz TRYBÓW SKANOWANIA.							

Tabela 30. Butterfly iQ+ Doppler kolorowy/Doppler mocy + Tryb B/Maksymalne warto ci MI, TIB

Index Label			MI	TIS		TIB		TIC
				At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum Index Value			0.29	0.0479		0.17		0.24
Index Component Value				1: 0.00453 2: 0.0453	1: 0.0453 2: 0.0386	1: 0.00453 2: 0.0430	1: 0.00453 2: 0.16	
Assoc Acoustic Parameter	$P_{r,a}$ at Z_{MI}	(MPa)	2: 0.49					
	P	(mW)		1: 0.45 2: 6.72		1: 0.45 2: 6.72		1: 0.45 2: 6.72
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		1: 0.27 2: 3.08		1: 0.27 2: 3.08		
	Z_s	(cm)			1: 3.60 2: 4.37			
	Z_b	(cm)					1: 3.57 2: 3.77	
	Z_{MI}	(cm)	2: 4.37					
	$Z_{pii,a}$	(cm)	2: 4.37					
	f_{awf}	(MHz)	2: 2.94		1: 3.55 2: 2.94		1: 3.55 2: 2.94	1: 3.55 2: 2.94
Other Information	pr	(Hz)	2: 1386.7					
	srr	(Hz)	N/A					
	η_{pps}		2: 1					
	$I_{pa,a}$ at $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	2: 10.49					
	$I_{spta,a}$ at $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	23.58					
	I_{spta} at Z_{pii} or Z_{sii}	(mW/cm ²)	57.62					
	P_r at Z_{pii}	(MPa)	2: 0.76					
Operating Control Conditions	Ustawienie wst pne: kardiologia dzieci ca							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wska nik.							
Uwaga 2:	Dane nale y wprowadzi dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchni ” w obu kolumnach dotycz cych TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odno nie do MI i TI dla ka dego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowa przeczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Je li wymogi 201.12.4.2a s spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie adnych danych w kolumnach dotycz cych TIS, TIB lub TIC							
Uwaga 5:	Je li wymogi 201.12.4.2b s spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie adnych danych w kolumnach dotycz cych MI.							
Uwaga 6:	Niezacieniowane komórki powinny mie przypisan warto liczbow . Ustawienie sprz tu zwi zane ze wska nikiem nale y wprowadzi w sekcji sterowania operacyjnego.							

Index Label	MI	TIS		TIB		TIC
		At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Uwaga 7:	Głębokości p_{ii} oraz $z_{p_{ii},a}$ dotyczą TRYBÓW NIESKANOWANIA, natomiast głębokości $z_{s_{ii}}$ oraz $z_{s_{ii},a}$ dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.					
Uwaga 8:	Składnik „1:” odnosi się do trybu B, składnik „2:” odnosi się do Dopplera kolorowego.					

Tabela 31. Butterfly iQ+ Doppler kolorowy/Doppler mocy + tryb B/Maksymalne wartości TIS

Index Label			MI	TIS		TIB		TIC
				At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum Index Value			0.17	.0649		0.15		0.42
Index Component Value				1: 0.00323 2: 0.0512	1: 0.00323 2: 0.0617	1: 0.00323 2: 0.0512	1: 0.00323 2: 0.15	
Assoc Acoustic Parameter	$p_{r,a}$ at z_{MI}	(MPa)	2: 0.27					
	P	(mW)		1: 0.59 2: 11.66		1: 0.59 2: 11.66		1: 0.59 2: 11.66
	P_{1x1}	(mW)		1: 0.24 2: 4.30		1: 0.24 2: 4.30		
	z_s	(cm)			1: 5.30 2: 4.67			
	z_b	(cm)					1: 4.90 2: 4.30	
	z_{MI}	(cm)	2: 4.67					
	$z_{pii,a}$	(cm)	2: 4.67					
	f_{awf}	(MHz)	2: 2.50		3.55		3.55	3.55
Other Information	prr	(Hz)	2: 1965.3					
	srr	(Hz)	N/A					
	η_{pps}		2: 1					
	$I_{pa,a}$ at $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	2: 2.88					
	$I_{spta,a}$ at $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	10.28					
	I_{spta} at Z_{pii} or Z_{sii}	(mW/cm ²)	23.23					
p_r at Z_{pii}	(MPa)	2: 0.40						
Operating Control Conditions	Ustawienie wst pne: p cherez moczowy							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wskaźnik.							
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchnią” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne, o ile nie do MI i TI dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Jeśli wymagania 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC.							
Uwaga 5:	Jeśli wymagania 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących MI.							
Uwaga 6:	Niezacienione komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbową. Ustawienie sprzeczne ze wskazaniami należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.							
Uwaga 7:	Głębokości Z_{pii} oraz $Z_{pii,a}$ dotyczą TRYBÓW NIESKANOWANIA, natomiast głębokości Z_{sii} oraz $Z_{sii,a}$ dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.							
Uwaga 8:	Składnik „1:” odnosi się do trybu B, składnik „2:” odnosi się do Dopplera kolorowego.							

Tabela 32. Butterfly iQ+ Tryb M + Tryb B/Maksymalne wartości MI

Index Label			MI	TIS		TIB		TIC
				At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum Index Value			0.43	0.00283		0.00519		0.00953
Index Component Value				1: 0.00246 2: 0.000369	1: 0.00246 2: 0.000298	1: 0.00246 2: 0.000369	1: 0.00246 2: 0.00273	
Assoc Acoustic Parameter	$p_{r,a}$ at Z_{MI}	(MPa)	1: 0.76					
	P	(mW)		1: 0.24 2: .0635		1: 0.24 2: .0365		1: 0.24 2: .0365
	P_{1x1}	(mW)		1: 0.17 2: .0249		1: 0.17 2: .0249		
	z_s	(cm)			1: 2.77 2: 2.77			
	z_b	(cm)					1: 2.73 2: 2.73	
	Z_{MI}	(cm)	1: 2.77					
	$Z_{pii,a}$	(cm)	1: 2.77					
	f_{awf}	(MHz)	1: 3.12		1: 3.12 2: 3.12		1: 3.12 2: 3.11	1: 3.12 2: 3.12
Other Information	p_{rr}	(Hz)	1: 610.3					
	s_{rr}	(Hz)	1: 15.3					
	n_{pps}		1: 1					
	$I_{pa,a}$ at $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	1: 27.75					
	$I_{spta,a}$ at $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	1.39					
	I_{spta} at Z_{pii} or Z_{sii}	(mW/cm ²)	2.53					
	p_r at Z_{pii}	(MPa)	1: 1.02					
Operating Control Conditions	Ustawienie wst. pne: płuca							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wskaźnik.							
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchnią” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do MI i TI dla każdego ZESPÓŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Jeśli wymogi 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC.							
Uwaga 5:	Jeśli wymogi 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących MI.							
Uwaga 6:	Niezacienione komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbową. Ustawienie sprzeczne ze wskaźnikiem należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.							
Uwaga 7:	Głębokości Z_{pii} oraz $Z_{pii,a}$ dotyczą TRYBÓW NIESKANUJĄCYCH, natomiast głębokości Z_{sii} oraz $Z_{sii,a}$ dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.							
Uwaga 8:	Składnik „1:” odnosi się do trybu B, składnik „2:” odnosi się do trybu M.							

Tabela 33. Butterfly iQ+ Tryb M + Tryb B/Maksymalne warto ci TIS, TIB

Index Label			MI	TIS		TIB		TIC
				At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum Index Value			0.19	0.0107		0.0127		0.0732
Index Component Value				1: 0.00952 2: 0.00113	1: 0.00952 2: 0.00135	1: 0.00952 2: 0.00135	1: 0.00952 2: 0.0318	
Assoc Acoustic Parameter	$p_{r,a}$ at Z_{MI}	(MPa)	1: 0.31					
	P	(mW)		1: 1.92 2: 0.23		1: 1.92 2: 0.23		1: 1.92 2: 0.23
	P_{1x1}	(mW)		1: 0.79 2: 0.0936		1: 0.79 2: 0.0936		
	z_s	(cm)			1: 5.10 2: 5.10			
	z_b	(cm)					1: 4.53 2: 4.53	
	Z_{MI}	(cm)	1: 5.10					
	$Z_{pii,a}$	(cm)	1: 5.10					
	f_{awf}	(MHz)	1: 2.58		1: 2.58 2: 2.58		1: 2.58 2: 2.55	1: 2.58 2: 2.58
Other Information	prr	(Hz)	1: 828.4					
	srr	(Hz)	1: 9.9					
	n_{pps}		1: 1					
	$I_{pa,a}$ at $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	1: 3.47					
	$I_{spta,a}$ at $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	0.76					
	I_{spta} at Z_{pii} or Z_{sii}	(mW/cm ²)	1.86					
	p_r at Z_{pii}	(MPa)	1: 0.48					
Operating Control Conditions	Ustawienie wst pne: warstwa gł boka jamy brzusznej							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wska nik.							
Uwaga 2:	Dane nale y wprowadzi dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchni ” w obu kolumnach dotycz cych TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odno nie do MI i TI dla ka dego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowa przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Je li wymogi 201.12.4.2a s spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie adnych danych w kolumnach dotycz cych TIS, TIB lub TIC							
Uwaga 5:	Je li wymogi 201.12.4.2b s spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie adnych danych w kolumnach dotycz cych MI.							
Uwaga 6:	Niezacieniowane komórki powinny mie przypisan warto liczbow . Ustawienie sprz tu zwi zane ze wska nikiem nale y wprowadzi w sekcji sterowania operacyjnego.							
Uwaga 7:	Gł boko ci Z_{pii} oraz $Z_{pii,a}$ dotycz TRYBÓW NIESKANUJ CYCH, natomiast gł boko ci Z_{sii} oraz $Z_{sii,a}$ dotycz TRYBÓW SKANOWANIA.							
Uwaga 8:	Składnik „1:” odnosi si do trybu B, składnik „2:” odnosi si do trybu M.							

Tabela 34. Butterfly iQ+ Doppler fali pulsacyjnej/Maksymalne warto ci MI, TIS, TIB

Index Label			MI	TIS		TIB		TIC
				At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum Index Value			0.34	0,2		1,31		0,88
Index Component Value				0,2	0,18	0,2	1,31	
Assoc Acoustic Parameter	$P_{r,a}$ at Z_{MI}	(MPa)	0.45					
	P	(mW)		76.47		76.47		76.47
	P_{1x1}	(mW)		23.86		23.86		
	Z_s	(cm)			10.20			
	Z_b	(cm)					4.27	
	Z_{MI}	(cm)	4.27					
	$Z_{pii,a}$	(cm)	10.20					
f_{awf}	(MHz)	1.79		1.80		1.79		1.80
Other Information	pr	(Hz)	4000					
	srr	(Hz)	Nie dotyczy					
	n_{pps}		1					
	$I_{pa,a}$ at $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	7.8					
	$I_{spta,a}$ at $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	146.47					
	I_{spta} at Z_{pii} or Z_{sii}	(mW/cm ²)	517.54					
P_r at Z_{pii}	(MPa)	0.68						
Operating Control Conditions			Ustawienie wst pne: badanie kardiologiczne standardowe					
Uwaga 1:			Tylko jeden warunek działania na wska nik.					
Uwaga 2:			Dane nale y wprowadzi dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchni ” w obu kolumnach dotycz cych TIS i TIB.					
Uwaga 3:			Podawanie informacji nie jest konieczne odno nie do MI i TI dla ka dego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowa przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.					
Uwaga 4:			Je li wymogi 201.12.4.2a s spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie adnych danych w kolumnach dotycz cych TIS, TIB lub TIC					
Uwaga 5:			Je li wymogi 201.12.4.2b s spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie adnych danych w kolumnach dotycz cych MI.					
Uwaga 6:			Niezacieniowane komórki powinny mie przypisan warto liczbow . Ustawienie sprz tu zwi zane ze wska nikiem nale y wprowadzi w sekcji sterowania operacyjnego.					
Uwaga 7:			Gł boko ci Z_{pii} oraz $Z_{pii,a}$ dotycz TRYBÓW NIESKANUJ CYCH, natomiast gł boko ci Z_{sii} oraz $Z_{sii,a}$ dotycz TRYBÓW SKANOWANIA.					

Butterfly iQ3 Tabele akustyczne

Tabela 35. Butterfly iQ3 tryb raportowania 1 (naczyniowy: gł boka yła (tryb B))

Etykieta wskaźnika			MI	Ti		TIB		TIC
				Na powierzchni	Pod powierzchnią	Na powierzchni	Pod powierzchnią	
Maksymalna wartość wskaźnika			0.51	1,84E-02		1,84E-02		2,92E-02
Wartość składnika indeksu				1,84E-02	1,84E-02	1,84E-02	1,84E-02	
Pow. parametr akustyczny	$P_{r,a}$ przy Z_{MI}	(MPa)	1.18					
	P	(mW)		1.68		1.68		1.68
	P_{1x1}	(mW)		0.72		0.72		
	Z_s	(cm)		Nie dotyczy				
	Z_b	(cm)				Nie dotyczy		
	Z_{MI}	(cm)	3.53					
	$Z_{pii,a}$	(cm)	3.53					
	$f_{a,awf}$	(MHz)	5.40	5.40		5.40		5.40
Inne informacje	p_{rr}	(Hz)	1980.0					
	s_{rr}	(Hz)	9.0					
	n_{pps}		4					
	$I_{pa,a}$ przy $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	1,0E+02					
	$I_{spta,a}$ przy $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	1.84					
	I_{spta} przy Z_{pii} lub Z_{sii}	(mW/cm ²)	6.86					
	P_r przy Z_{pii}	(MPa)	2.25					
Robocze warunki kontrolne	5,5 MHz-36,0 mm – tryb B / tryb M							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wskaźnik.							
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchnią” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do MI i TI dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Jeśli wymagania 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC.							
Uwaga 5:	Jeśli wymagania 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących MI.							
Uwaga 6:	Niezacienione komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbową. Ustawienie sprzeczne ze wskaźnikiem należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.							
Uwaga 7:	Głębokości Z_{pii} oraz $Z_{pii,a}$ dotyczą TRYBÓW NIESKANOWANYCH, natomiast głębokości Z_{sii} oraz $Z_{sii,a}$ dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.							

Tabela 36. Butterfly iQ3 Tryb B, tryb raportowania 2 (naczyniowy: gł boka yła (B+C))

Etykieta wskaźnika			MI	Ti		TIB		TIC
				Na powierzchni	Pod powierzchni	Na powierzchni	Pod powierzchni	
Maksymalna wartość wskaźnika			0.51	4,27E-02		5,99E-02		6,46E-02
Wartość składnika indeksu				1: 1,84E-02 2: 2,46E-02	1: 1,84E-02 2: 2,38E-02	1: 1,84E-02 2: 2,46E-02	1: 1,84E-02 2: 4,07E-02	
Pow. parametr akustyczny	$P_{r,a}$ przy Z_{MI}	(MPa)	1: 1.18					
	P	(mW)		1: 1.68 2: 2.39		1: 1.68 2: 2.39		1: 1.68 2: 2.39
	P_{1x1}	(mW)		1: 0.72 2: 1.02		1: 0.72 2: 1.02		
	Z_s	(cm)			1: NIE DOTYCZY 2: 2.52			
	Z_b	(cm)					1: NIE DOTYCZY 2: 5.95	
	Z_{MI}	(cm)	1: 3.53					
	$Z_{pii,a}$	(cm)	1: 3.53					
	$f_{a\text{ awf}}$	(MHz)	1: 5.40		1: 5.40 2: 5.07		1: 5.40 2: 5.07	
Inne informacje	p_{rr}	(Hz)	1: 1980.0					
	s_{rr}	(Hz)	1: 9.0					
	n_{pps}		1: 4					
	$I_{pa,a}$ przy $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	1: 101					
	$I_{spta,a}$ przy $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	16.09					
	I_{spta} przy Z_{pii} lub Z_{sii}	(mW/cm ²)	127.70					
	p_r przy Z_{pii}	(MPa)	1: 2.25					
Robocze warunki kontrolne	Komponent 1: 5,5 MHz – 36,0 mm – tryb B/tryb M							
	Komponent 2: 5,0 MHz – 60,0 mm – tryb kolorowy							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wskaźnik.							
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchni” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do MI i TI dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Jeśli wymagania 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC							
Uwaga 5:	Jeśli wymagania 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących MI.							

Etykieta wskaźnika	MI	Ti		TIB		TIC
		Na powierzchni	Pod powierzchni	Na powierzchni	Pod powierzchni	
Uwaga 6:	Niezacienione komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbowa. Ustawienie sprężytowane ze wskaźnikiem należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.					
Uwaga 7:	Głębokości z p _{ii} oraz z p _{ii, a} dotyczą TRYBÓW NIESKANUJĄCYCH, natomiast głębokości z s _{ii} oraz z s _{ii, a} dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.					
Uwaga 8:	Składnik „1:” odnosi się do trybu B, składnik „2:” odnosi się do Dopplera kolorowego.					

Tabela 37. Butterfly iQ3 tryb raportowania 2 (naczyniowy: głębia boka (B+C)), komponent 1 (5,5 MHz–36,0 mm – tryb B/ tryb M)

Etykieta wskaźnika		MI	TI		TIB		TIC
			Na powierzchni	Pod powierzchnią	Na powierzchni	Pod powierzchnią	
Maksymalna wartość wskaźnika		0.51	1,84E-02		1,84E-02		2,92E-02
Wartość składnika indeksu			1,84E-02	1,84E-02	1,84E-02	1,84E-02	
Pow. parametr akustyczny	$P_{r,a}$ przy Z_{MI}	(MPa)	1.18				
	P	(mW)		1.68	1.68		1.68
	P_{1x1}	(mW)		0.72	0.72		
	z_s	(cm)		Nie dotyczy			
	z_b	(cm)				Nie dotyczy	
	Z_{MI}	(cm)	3.53				
	$Z_{pii,a}$	(cm)	3.53				
$f_{a_{awf}}$	(MHz)	5.40	5.40		5.40		5.40
Inne informacje	p_{rr}	(Hz)	1980.0				
	s_{rr}	(Hz)	9,0				
	n_{pps}		4				
	$I_{pa,a}$ przy $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	1,0E+02				
	$I_{spta,a}$ przy $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	1.84				
	I_{spta} przy Z_{pii} lub Z_{sii}	(mW/cm ²)	6.86				
p_r przy Z_{pii}	(MPa)	2.25					
Robocze warunki kontrolne	5,5 MHz-36,0 mm – tryb B / tryb M						
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wskaźnik.						
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchnią” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.						
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do MI i TI dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowania przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.						
Uwaga 4:	Jeśli wymogi 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie żadnych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC						
Uwaga 5:	Jeśli wymogi 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie żadnych danych w kolumnach dotyczących MI.						
Uwaga 6:	Niezacienione komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbową. Ustawienie sprzeczne ze wskaźnikiem należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.						
Uwaga 7:	Głębokości z_{pii} oraz $z_{pii,a}$ dotyczą TRYBÓW NIESKANOWANYCH, natomiast głębokości z_{sii} oraz $z_{sii,a}$ dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.						
Uwaga 8:	Składnik „1:” odnosi się do trybu B, składnik „2:” odnosi się do Dopplera kolorowego.						

Tabela 38. Butterfly iQ3 tryb raportowania 2 (naczyniowy: włączyć bok (B+C)), komponent 2 (5,0 MHz – 60,0 mm – tryb kolorowy)

Etykieta wskaźnika			MI	Ti		TIB		TIC
				Na powierzchni	Pod powierzchnią	Na powierzchni	Pod powierzchnią	
Maksymalna wartość wskaźnika			0.22	2,46E-02		4,07E-02		3,54E-02
Wartość składnika indeksu				2,46E-02	2,38E-02	2,46E-02	4,07E-02	
Pow. parametr akustyczny	$P_{r,a}$ przy Z_{MI}	(MPa)	0.50					
	P	(mW)		2.39		2.39		2.39
	P_{1x1}	(mW)		1.02		1.02		
	Z_s	(cm)			2.52			
	Z_b	(cm)					5.95	
	Z_{MI}	(cm)	6.10					
	$Z_{pii,a}$	(cm)	6.10					
$f_{a\text{ w f}}$	(MHz)	5.07	5.07		5.07		5.07	
Inne informacje	prf	(Hz)	666					
	srf	(Hz)	Nie dotyczy					
	η_{pps}		1					
	$I_{pa,a}$ przy $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	22					
	$I_{spta,a}$ przy $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	14.25					
	I_{spta} przy Z_{pii} lub Z_{sii}	(mW/cm ²)	120.84					
P_r przy Z_{pii}	(MPa)	1.45						
Robocze warunki kontrolne	5,0 MHz – 60,0 mm – tryb kolorowy							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wskaźnik.							
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchnią” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne, o ile nie do MI i TI dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Jeśli wymagania 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC.							
Uwaga 5:	Jeśli wymagania 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących MI.							
Uwaga 6:	Niezacienione komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbową. Ustawienie sprzeczne ze wskaźnikiem należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.							
Uwaga 7:	Głębokości Z_{pii} oraz $Z_{pii,a}$ dotyczą TRYBÓW NIESKANOWANYCH, natomiast głębokości Z_{sii} oraz $Z_{sii,a}$ dotyczą TRYBÓW SKANOWANYCH.							
Uwaga 8:	Składnik „1:” odnosi się do trybu B, składnik „2:” odnosi się do Dopplera kolorowego.							

Tabela 39. Butterfly iQ3 tryb raportowania 3 (naczyniowy: gł boka yła (B+M))

Etykieta wska nika		MI	Ti		TIB		TIC
			Na powierzchni	Pod powierzchni	Na powierzchni	Pod powierzchni	
Maksymalna wartość wska nika		0,51	4,65E-02		0,16		7,16E-02
Warto składowa indeksu			1: 1,84E-02 2: 2,67E-02	1: 1,84E-02 2: 2,81E-02	1: 1,84E-02 2: 2,67E-02	1: 1,84E-02 2: 0,14	
Pow. parametr akustyczny	$P_{r,a}$ przy Z_{MI}	(MPa)	1: 1.18				
	P	(mW)		1: 1.68 2: 2.44		1: 1.68 2: 2.44	1: 1.68 2: 2.44
	P_{1x1}	(mW)		1: 0.72 2: 1.04		1: 0.72 2: 1.04	
	Z_s	(cm)			1: NIE DOTYCZY 2: 2,15		
	Z_b	(cm)				1: NIE DOTYCZY 2: 3,47	
	Z_{MI}	(cm)	3.53				
	$Z_{pii,a}$	(cm)	3.53				
	$f_{a,awf}$	(MHz)	1: 5.40	1: 5.40 2: 5.40		1: 5.40 2: 5.40	1: 5.40 2: 5.40
Inne informacje	prf	(Hz)	1: 1980.0				
	srf	(Hz)	1: 9,0				
	ρ_{pps}		1: 4				
	$I_{pa,a}$ przy $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	1: 101				
	$I_{spta,a}$ przy $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	75.19				
	I_{spta} przy Z_{pii} lub Z_{sii}	(mW/cm ²)	280.87				
	p_r przy Z_{pii}	(MPa)	1: 2.25				
Robocze warunki kontrolne	Komponent 1: 5,5 MHz – 36,0 mm – tryb B/tryb M Komponent 2: 5,5 MHz – 36,0 mm – tryb B/tryb M						
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wska niki.						
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchni” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.						
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do MI i TI dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.						
Uwaga 4:	Jeśli wymagania 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC						
Uwaga 5:	Jeśli wymagania 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących MI.						
Uwaga 6:	Niezacienione komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbową. Ustawienie sprężonego powietrza ze wskaźnikiem należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.						

Etykieta wskaźnika	MI	Ti		TIB		TIC
		Na powierzchni	Pod powierzchnią	Na powierzchni	Pod powierzchnią	
Uwaga 7:	Głębokości z p _{ii} oraz z p _{ii} , a dotyczy TRYBÓW NIESKANUJĄCYCH, natomiast głębokości z s _{ii} oraz z s _{ii} , a dotyczy TRYBÓW SKANOWANIA.					
Uwaga 8:	Składnik „1:” odnosi się do trybu B, składnik „2:” odnosi się do trybu M.					

Tabela 40. Butterfly iQ3 tryb raportowania 3 (gł boka yła (B+M)), komponent 1 (5,5 MHz–36,0 mm – tryb B/tryb M)

Etykieta wskaźnika			MI	Ti		TIB		TIC
				Na powierzchni	Pod powierzchnią	Na powierzchni	Pod powierzchnią	
Maksymalna wartość wskaźnika			0.51	1,84E-02		1,84E-02		2,92E-02
Wartość składnika indeksu				1,84E-02	1,84E-02	1,84E-02	1,84E-02	
Pow. parametr akustyczny	$P_{r,a}$ przy Z_{MI}	(MPa)	1.18					
	P	(mW)		1.68		1.68		1.68
	P_{1x1}	(mW)		0.72		0.72		
	z_s	(cm)		Nie dotyczy				
	z_b	(cm)					Nie dotyczy	
	z_{MI}	(cm)	3.53					
	$z_{pii,a}$	(cm)	3.53					
	$f_{a,awf}$	(MHz)	5.40	5.40		5.40		5.40
Inne informacje	prf	(Hz)	337					
	srf	(Hz)	Nie dotyczy					
	η_{pps}		1					
	$I_{pa,a}$ przy $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	1,0E+02					
	$I_{spta,a}$ przy $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	1.84					
	I_{spta} przy Z_{pii} lub Z_{sii}	(mW/cm ²)	6.86					
	P_r przy Z_{pii}	(MPa)	2.25					
Robocze warunki kontrolne	5,5 MHz-36,0 mm – tryb B / tryb M							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wskaźnik.							
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchnią” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do MI i TI dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Jeśli wymogi 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC.							
Uwaga 5:	Jeśli wymogi 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących MI.							
Uwaga 6:	Niezacienione komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbową. Ustawienie sprzeczne ze wskaźnikiem należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.							
Uwaga 7:	Głębokości z_{pii} oraz $z_{pii,a}$ dotyczą TRYBÓW NIESKANOWANYCH, natomiast głębokości z_{sii} oraz $z_{sii,a}$ dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.							

Tabela 41. Butterfly iQ3 tryb raportowania 3 (naczyniowy: gł boka yła (B+M)), komponent 2 (5,5 MHz–36,0 mm – tryb B/tryb M)

Etykieta wska nika			MI	Ti		TIB		TIC
				Na powierzchni	Pod powierzchni	Na powierzchni	Pod powierzchni	
Maksymalna wartość wska nika			0.51	2,81E-02		0,14		4,24E-02
Wartość składnika indeksu				2,67E-02	2,81E-02	2,67E-02	0,14	
Pow. parametr akustyczny	$P_{r,a}$ przy Z_{MI}	(MPa)	1.18					
	P	(mW)		2,44		2,44		2,44
	P_{1x1}	(mW)		1,04		1,04		
	z_s	(cm)			2,15			
	z_b	(cm)					3,47	
	z_{MI}	(cm)	3.53					
	$z_{pii,a}$	(cm)	3.53					
$f_{a\text{ awf}}$	(MHz)	5.40	5.40		5.40		5.40	
Inne informacje	prf	(Hz)	2880,0					
	srf	(Hz)	Nie dotyczy					
	η_{pps}		1					
	$I_{pa,a}$ przy $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	1,0E+02					
	$I_{spta,a}$ przy $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	73.36					
	I_{spta} przy Z_{pii} lub Z_{sii}	(mW/cm ²)	274.01					
P_r przy Z_{pii}	(MPa)	2.25						
Robocze warunki kontrolne	5,5 MHz-36,0 mm – tryb B / tryb M							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wska nika.							
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchni ” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do MI i TI dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Jeśli wymogi 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie żadnych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC							
Uwaga 5:	Jeśli wymogi 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie żadnych danych w kolumnach dotyczących MI.							
Uwaga 6:	Niezacienione komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbowa. Ustawienie sprzeczne ze wskazaniami należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.							
Uwaga 7:	Głębokości z_{pii} oraz $z_{pii,a}$ dotyczą TRYBÓW NIESKANOWANYCH, natomiast głębokości z_{sii} oraz $z_{sii,a}$ dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.							

Tabela 42. Butterfly iQ3 tryb raportowania 4 (jama brzuszna: gł b (B+M))

Etykieta wskaźnika			MI	Ti		TIB		TIC
				Na powierzchni	Pod powierzchni	Na powierzchni	Pod powierzchni	
Maksymalna wartość wskaźnika			0.16	3,23E-02		3,28E-02		5,76E-02
Wartość składnika indeksu				1: 3,01E-02 2: 1,91E-03	1: 3,01E-02 2: 2,21E-03	1: 3,01E-02 2: 1,91E-03	1: 3,01E-02 2: 2,74E-03	
Pow. parametr akustyczny	$P_{r,a}$ przy Z_{MI}	(MPa)	1: 0.28					
	P	(mW)		1: 4,75 2: 0.30		1: 4,75 2: 0.30		1: 4,75 2: 0.30
	P_{1x1}	(mW)		1: 2,02 2: 0.13		1: 2,02 2: 0.13		
	Z_s	(cm)			1: NIE DOTYCZY 2: 3,28			
	Z_b	(cm)					1: NIE DOTYCZY 2: 3,29	
	Z_{MI}	(cm)	1: 4.97					
	$Z_{pii,a}$	(cm)	1: 4.97					
	$f_{a\text{wff}}$	(MHz)	1: 3.11		1: 3.11 2: 3.11		1: 3.11 2: 3.11	1: 3.11 2: 3.11
Inne informacje	pr	(Hz)	1: 1417.5					
	sr	(Hz)	1: 22,5					
	ρ_{pps}		1: 1					
	$I_{pa,a}$ przy $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	1: 3,26					
	$I_{spta,a}$ przy $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	0.76					
	I_{spta} przy Z_{pii} lub Z_{sii}	(mW/cm ²)	3.23					
	p_r przy Z_{pii}	(MPa)	1: 0.51					
Robocze warunki kontrolne	Komponent 1: 3,0 MHz – 285,0 mm – tryb B/tryb M Komponent 2: 3,0 MHz – 285,0 mm – tryb B/tryb M							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wskaźnik.							
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchni” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do MI i TI dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przeczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Jeśli wymagania 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC							
Uwaga 5:	Jeśli wymagania 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących MI.							

Etykieta wska nika	MI	Ti		TIB		TIC
		Na powierzchni	Pod powierzchni	Na powierzchni	Pod powierzchni	
Uwaga 6:	Niezacienowane komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbową. Ustawienie sprężu związanego ze wskazaniami należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.					
Uwaga 7:	Głębokości Z_{pii} oraz $Z_{pii,a}$ dotyczą TRYBÓW NIESKANUJĄCYCH, natomiast głębokości Z_{sii} oraz $Z_{sii,a}$ dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.					

Tabela 43. Butterfly iQ3 tryb raportowania 4 (jama brzuszna: głębia (B+M)), komponent 1 (3,0 MHz-285,0 mm – tryb B/tryb M)

Etykieta wska nika			MI	Ti		TIB		TIC
				Na powierzchni	Pod powierzchni	Na powierzchni	Pod powierzchni	
Maksymalna wartość wska nika			0.16	3,01E-02		3,01E-02		5,42E-02
Wartość składnika indeksu				3,01E-02	3,01E-02	3,01E-02	3,01E-02	
Pow. parametr akustyczny	$P_{r,a}$ przy Z_{MI}	(MPa)	0.28					
	P	(mW)		4,75		4,75		4,75
	P_{1x1}	(mW)		2,02		2,02		
	Z_s	(cm)		Nie dotyczy				
	Z_b	(cm)				Nie dotyczy		
	Z_{MI}	(cm)	4.97					
	$Z_{pii,a}$	(cm)	4.97					
	$f_{a\text{awf}}$	(MHz)	3.11	3.11		3.11		3.11
Inne informacje	p_{rr}	(Hz)	1417.5					
	s_{rr}	(Hz)	22,5					
	n_{pps}		1					
	$I_{pa,a}$ przy $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	3,3					
	$I_{spta,a}$ przy $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	0.62					
	I_{spta} przy Z_{pii} lub Z_{sii}	(mW/cm ²)	2.57					
	p_r przy Z_{pii}	(MPa)	0.51					
Robocze warunki kontrolne	3,0 MHz – 285,0 mm – tryb B/tryb M							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wskaźnik.							
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchni” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do MI i TI dla każdego ZESPÓŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezcezaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Jeżeli wymagania 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC.							
Uwaga 5:	Jeżeli wymagania 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących MI.							
Uwaga 6:	Niezacienowane komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbową. Ustawienie sprężu związanego ze wskazaniami należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.							
Uwaga 7:	Głębokości Z_{pii} oraz $Z_{pii,a}$ dotyczą TRYBÓW NIESKANUJĄCYCH, natomiast głębokości Z_{sii} oraz $Z_{sii,a}$ dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.							

Tabela 44. Butterfly iQ3 tryb raportowania 4 (jama brzuszna: gł b (B+M)), komponent 2 (3,0 MHz-285,0 mm tryb B/tryb M)

Etykieta wskaźnika		MI	TI		TIB		TIC
			Na powierzchni	Pod powierzchnią	Na powierzchni	Pod powierzchnią	
Maksymalna wartość wskaźnika		0.16	2,21E-03		2,74E-03		3,45E-03
Wartość składnika indeksu			1,91E-03	2,21E-03	1,91E-03	2,74E-03	
Pow. parametr akustyczny	$P_{r,a}$ przy Z_{MI}	(MPa)	0.28				
	P	(mW)		0.30	0.30		0.30
	P_{1x1}	(mW)		0.13	0.13		
	z_s	(cm)		3,28			
	z_b	(cm)				3,39	
	Z_{MI}	(cm)	4.97				
	$Z_{pii,a}$	(cm)	4.97				
$f_{a,awf}$	(MHz)	3.11	3.11		3.11	3.11	
Inne informacje	prf	(Hz)	90.2				
	srf	(Hz)	Nie dotyczy				
	n_{pps}		1				
	$I_{pa,a}$ przy $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	3.3				
	$I_{spta,a}$ przy $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	0.14				
	I_{spta} przy Z_{pii} lub Z_{sii}	(mW/cm ²)	0.67				
P_r przy Z_{pii}	(MPa)	0.51					
Robocze warunki kontrolne	3,0 MHz – 285,0 mm – tryb B/tryb M						
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wskaźnik.						
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchnią” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.						
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do MI i TI dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.						
Uwaga 4:	Jeśli wymogi 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie żadnych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC						
Uwaga 5:	Jeśli wymogi 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie żadnych danych w kolumnach dotyczących MI.						
Uwaga 6:	Niezacienione komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbową. Ustawienie sprzeczne ze wskaźnikiem należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.						
Uwaga 7:	Głębokości Z_{pii} oraz $Z_{pii,a}$ dotyczą TRYBÓW NIESKANOWANYCH, natomiast głębokości Z_{sii} oraz $Z_{sii,a}$ dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.						
Uwaga 8:	Składnik „1.” odnosi się do trybu B, składnik „2.” odnosi się do Dopplera kolorowego/Dopplera mocy.						

Tabela 45. Butterfly iQ3 tryb raportowania 5 (sercowy: gł b. (Doppler fali pulsacyjnej))

Etykieta wskaźnika		MI	Ti		TIB		TIC
			Na powierzchni	Pod powierzchni	Na powierzchni	Pod powierzchni	
Maksymalna wartość wskaźnika		0.32	0,32		0,85		0,63
Wartość składnika indeksu			0,21	0,32	0,21	0,85	
Pow. parametr akustyczny	$P_{r,a}$ przy Z_{MI}	(MPa)	0.44				
	P	(mW)		56.97		56.97	56.97
	P_{1x1}	(mW)		24.30		24.30	
	Z_s	(cm)			3,48		
	Z_b	(cm)				10,10	
	Z_{MI}	(cm)	10.20				
	$Z_{pii,a}$	(cm)	10.20				
	$f_{a_{awf}}$	(MHz)	1.83	1.83		1.83	
Inne informacje	prf	(Hz)	2940.0				
	srf	(Hz)	Nie dotyczy				
	n_{pps}		1				
	$I_{pa,a}$ przy $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	8.9				
	$I_{spta,a}$ przy $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	120.85				
	I_{spta} przy Z_{pii} lub Z_{sii}	(mW/cm ²)	448.66				
	P_r przy Z_{pii}	(MPa)	0.83				
Robocze warunki kontrolne	1,8 MHz–110,0 mm – Doppler fali pulsacyjnej						
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wskaźnik.						
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchni” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.						
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do MI i TI dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.						
Uwaga 4:	Jeśli wymogi 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC						
Uwaga 5:	Jeśli wymogi 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie danych w kolumnach dotyczących MI.						
Uwaga 6:	Niezacienione komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbową. Ustawienie sprzeczne ze wskaźnikiem należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.						
Uwaga 7:	Głębokości Z_{pii} oraz $Z_{pii,a}$ dotyczą TRYBÓW NIESKANOWANYCH, natomiast głębokości Z_{sii} oraz $Z_{sii,a}$ dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.						
Uwaga 8:	Składnik „1:” odnosi się do trybu B, składnik „2:” odnosi się do Dopplera kolorowego/Dopplera mocy.						

Tabele z zestawieniem mocy akustycznej dla zastosowań okulistycznych

Tabela 46. Butterfly iQ Tryb B + Okulistyczny

Index Label			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	Non-Scan		Non-Scan	
					$A_{\text{aprt}} < 1 \text{ cm}^2$	$A_{\text{aprt}} > 1 \text{ cm}^2$		
Maximum Index Value			0.162	0.0015	-	-	-	0.0021
Assoc Acoustic Parameter	Pr.3	(MPa)	0.354					
	W_0	(mW)		0.0657	-	-	-	0.0657
	min of $[W_{.3}(z_1), I_{TA.3}(z_1)]$	(mW)				-		
	z_1	(cm)				-		
	z_{bp}	(cm)				-		
	z_{sp}	(cm)	1.65				-	
	$d_{eq}(z_{sp})$	(cm)					-	
	f_c	(MHz)	4.80	4.80	-	-	-	4.80
	Dim of A_{aprt}	X (cm)		0.7	-	-	-	0.7
Y (cm)			0.7	-	-	-	0.7	
Other Information	PD	(μsec)	0.181					
	PRF	(Hz)	3000					
	$p_r @ PII_{\text{max}}$	(MPa)	0.466					
	$d_{eq} @ PII_{\text{max}}$	(cm)					-	
	Focal Length	FLx (cm)		2.2	-	-		
		FLy (cm)		2.2	-	-		
$I_{PA.3} @ MI_{\text{max}}$	(W/cm ²)	6.24						
Operating Control Conditions	Ustawienie wst pne: okulistyczne		✓					
				✓				
							✓	
Uwaga 1:	Podawanie informacji nie jest konieczne dla dowolnego określenia TIS niedającego wartości maksymalnej TIS dla tego trybu.							
Uwaga 2:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do TIC dla każdego ZESPÓŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji dotyczących MI i TI nie jest konieczne, jeżeli sprzęt spełnia warunki klauzul wyłączeniowych podanych w punktach 51.2aa) oraz 51.2 dd).							

Tabela 47. Butterfly iQ Kolorowy Doppler + Okulistyczny

Index Label			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	Non-Scan		Non-Scan	
					$A_{aprt < 1}$ cm ²	$A_{aprt > 1}$ cm ²		
Maximum Index Value			0.162	0.00145	0.0167	-	0.0477	0.0340
Assoc Acoustic Parameter	Pr.3	(MPa)	0.355					
	W _o	(mW)		0.0633	0.719		0.719	0.719
	min of [W _{.3} (z ₁), I _{TA.3} (z ₁)]	(mW)				-		
	z ₁	(cm)				-		
	z _{bp}	(cm)				-		
	z _{sp}	(cm)	1.65				1.22	
	d _{eq} (z _{sp})	(cm)					0.0358	
	f _c	(MHz)	4.80	4.80	4.89	-	4.89	4.89
	Dim of A _{aprt}	X (cm)		0.65	0.5	-	-	0.5
Y (cm)			0.65	0.5	-	-	0.5	
Other Information	PD	(μsec)	0.175					
	PRF	(Hz)	1100					
	p _r @PII _{max}	(MPa)	0.507					
	d _{eq} @PII _{max}	(cm)					0.311	
	Focal Length	FLx (cm)		4.0	5.0	-		
		FLy (cm)		4.0	Inf	-		
I _{PA.3} @MI _{max}	(W/cm ²)	6.48						
Operating Control Conditions	Ustawienie wst pne: okulistyczne		✓					
				✓				
						✓		
Uwaga 1:	Podawanie informacji nie jest konieczne dla dowolnego określenia TIS niedającego wartości maksymalnej TIS dla tego trybu.							
Uwaga 2:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do TIC dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowania przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji dotyczących MI i TI nie jest konieczne, jeżeli spełnia warunki klauzul wyłączeniowych podanych w punktach 51.2aa) oraz 51.2 dd).							

Tabela 48. Butterfly iQ+ Tryb B okulistyczny/Maksymalne warto ci MI, TIS, TIB

Index Label			MI	TIS		TIB		TIC
				At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum Index Value			0.0946	0.000779		0.000779		0.00134
Index Component Value				0.000779	0.000779	0.000779	0.000779	
Assoc Acoustic Parameter	$p_{r,a}$ at Z_{MI}	(MPa)	0.19					
	P	(mW)		0.0394		0.0394		0.0394
	P_{1x1}	(mW)		0.0394		0.0394		
	Z_s	(cm)			1.67			
	Z_b	(cm)					1.55	
	Z_{MI}	(cm)	1.67					
	$Z_{pii,a}$	(cm)	1.67					
	f_{awf}	(MHz)	4.29	4.29		4.29		4.29
Other Information	pr	(Hz)	3750.0					
	sr	(Hz)	12.5					
	n_{pps}		3					
	$I_{pa,a}$ at $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	2.17					
	$I_{spta,a}$ at $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	0.0880					
	I_{spta} at Z_{pii} or Z_{sii}	(mW/cm ²)	0.14					
	p_r at Z_{pii}	(MPa)	0.25					
Operating Control Conditions	Ustawienie wst pne: okulistyczne							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wska nik.							
Uwaga 2:	Dane nale y wprowadzi dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchni ” w obu kolumnach dotycz cych TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odno nie do MI i TI dla ka dego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowa przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Je li wymogi 201.12.4.2a s spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie adnych danych w kolumnach dotycz cych TIS, TIB lub TIC							
Uwaga 5:	Je li wymogi 201.12.4.2b s spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie adnych danych w kolumnach dotycz cych MI.							
Uwaga 6:	Niezacienowane komórki powinny mie przypisan warto liczbow . Ustawienie sprz tu zwi zane ze wska nikiem nale y wprowadzi w sekcji sterowania operacyjnego.							
Uwaga 7:	Gł boko ci Z_{pii} oraz $Z_{pii,a}$ dotycz TRYBÓW NIESKANUJ CYCH, natomiast gł boko ci Z_{sii} oraz $Z_{sii,a}$ dotycz TRYBÓW SKANOWANIA.							

Tabela 49. Butterfly iQ+ Okulistyczne Tryb Dopplera kolorowego/Dopplera mocy + Tryb B/Maksymalne wartości MI, TIS, TIB

Index Label			MI	TIS		TIB		TIC
				At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum Index Value			0.10	0.00700		0.0150		0.0106
Index Component Value				1: 0.000720 2: 0.00628	1: 0.000720 2: 0.00349	1: 0.00720 2: 0.00628	1: 0.00720 2: 0.0143	
Assoc Acoustic Parameter	$p_{r,a}$ at Z_{MI}	(MPa)	1: 0.21					
	P	(mW)		1: 0.0358 2: 0.28		1: 0.0358 2: 0.28		1: 0.0358 2: 0.28
	P_{1x1}	(mW)		1: 0.0358 2: 0.27		1: 0.0358 2: 0.27		
	z_s	(cm)			1: 2.10 2: 1.78			
	z_b	(cm)					1: 1.85 2: 1.50	
	z_{MI}	(cm)	1: 2.10					
	$z_{pii,a}$	(cm)	1: 2.10					
	f_{awf}	(MHz)	1: 4.32		1: 4.32 2: 4.81		1: 4.32 2: 4.80	1: 4.32 2: 4.81
Other Information	pr	(Hz)	1: 1193.1					
	srr	(Hz)	1: 17.3					
	η_{pps}		1: 3					
	$I_{pa,a}$ at $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	1: 2.54					
	$I_{spta,a}$ at $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	3.23					
	I_{spta} at Z_{pii} or Z_{sii}	(mW/cm ²)	5.84					
	p_r at Z_{pii}	(MPa)	1: 0.28					
Operating Control Conditions	Ustawienie wst pne: okulistyczne							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wskaźnik.							
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchni” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do MI i TI dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przeczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Jeśli wymagania 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie żadnych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC.							
Uwaga 5:	Jeśli wymagania 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie żadnych danych w kolumnach dotyczących MI.							
Uwaga 6:	Niezacienione komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbową. Ustawienie sprzeczne ze wskazaniami należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.							
Uwaga 7:	Głębokości z_{pii} oraz $z_{pii,a}$ dotyczą TRYBÓW NIESKANOWANIA, natomiast głębokości z_{sii} oraz $z_{sii,a}$ dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.							
Uwaga 8:	Składnik „1:” odnosi się do trybu B, składnik „2:” odnosi się do Dopplera kolorowego/Dopplera mocy.							

Tabela 50. Butterfly iQ3 Tryb B okulistyczny/Maksymalne wartości MI, TIS, TIB

Etykieta wskaźnika			MI	Ti		TIB		TIC
				Na powierzchni	Pod powierzchni	Na powierzchni	Pod powierzchni	
Maksymalna wartość wskaźnika			0.10	4,37E-03		4,37E-03		7,16E-03
Wartość składnika indeksu				4,37E-03	4,37E-03	4,37E-03	4,37E-03	
Pow. parametr akustyczny	$P_{r,a}$ przy Z_{MI}	(MPa)	0.27					
	P	(mW)		0.13		0.13		0.13
	P_{1x1}	(mW)		0.13		0.13		
	Z_s	(cm)		Nie dotyczy				
	Z_b	(cm)				Nie dotyczy		
	Z_{MI}	(cm)	1.08					
	$Z_{pii,a}$	(cm)	1.08					
$f_{a_{awf}}$	(MHz)	7.15	7.15		7.15		7.15	
Inne informacje	prf	(Hz)	10342.1					
	srf	(Hz)	13.7					
	η_{pps}		12					
	$I_{pa,a}$ przy $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	5.2					
	$I_{spta,a}$ przy $Z_{pii,a}$ or $Z_{sij,a}$	(mW/cm ²)	0.31					
	I_{spta} przy Z_{pii} lub Z_{sij}	(mW/cm ²)	0.52					
	P_r przy Z_{pii}	(MPa)	0.36					
Robocze warunki kontrolne	7,3 MHz – 15,0 mm – tryb B / tryb M							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wskaźnik.							
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchni” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do MI i TI dla każdego ZESPÓŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przeczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Jeśli wymogi 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie żadnych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC							
Uwaga 5:	Jeśli wymogi 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie żadnych danych w kolumnach dotyczących MI.							
Uwaga 6:	Niezacienowane komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbowa. Ustawienie sprzeczne ze wskaźnikiem należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.							
Uwaga 7:	Głębokości Z_{pii} oraz $Z_{pii,a}$ dotyczą TRYBÓW NIESKANUJĄCYCH, natomiast głębokości Z_{sij} oraz $Z_{sij,a}$ dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.							

Tabela 51. Butterfly iQ3 Okulistyczne Tryb Dopplera kolorowego / Dopplera mocy + Tryb B / Maksymalne wartości MI, TIS, TIB

Etykieta wskaźnika			MI	TI		TIB		TIC
				Na powierzchni	Pod powierzchnią	Na powierzchni	Pod powierzchnią	
Maksymalna wartość wskaźnika			0.14	1.18E-02		2.77E-02		2.93E-02
Wartość składnika indeksu				1: 4.21E-03 2: 7,63E-03	1: 4.21E-03 2: 6,46E-03	1: 4.21E-03 2: 7,63E-03	1: 4.21E-03 2: 2,74E-03	
Pow. parametr akustyczny	$P_{r,a}$ przy Z_{MI}	(MPa)	2: 0.32					
	P	(mW)		1: 0.12 2: 0.32		1: 0.12 2: 0.32		1: 0.12 2: 0.32
	P_{1x1}	(mW)		1: 0.12 2: 0.32		1: 0.12 2: 0.32		
	Z_s	(cm)			1: NIE DOTYCZY 2: 0.50			
	Z_b	(cm)					1: NIE DOTYCZY 2: 0.50	
	Z_{MI}	(cm)	2: 0.35					
	$Z_{pii,a}$	(cm)	2: 0.50					
	$f_{a_{awf}}$	(MHz)	2: 5.03		1: 7.41 2: 5.03		1: 7.41 2: 5.03	
Inne informacje	prf	(Hz)	2: 1624.0					
	srf	(Hz)	Nie dotyczy					
	n_{pps}		2: 1					
	$I_{pa,a}$ przy $Z_{pii,a}$	(W/cm ²)	2: 3.42					
	$I_{spta,a}$ przy $Z_{pii,a}$ or $Z_{sii,a}$	(mW/cm ²)	9.24					
	I_{spta} przy Z_{pii} lub Z_{sii}	(mW/cm ²)	19.12					
	P_r przy Z_{pii}	(MPa)	2: 0.32					
Robocze warunki kontrolne	Komponent 1: 3,0 MHz – 285,0 mm – tryb B / tryb M Komponent 2: 5,0 MHz – 60,0 mm – tryb kolorowy							
Uwaga 1:	Tylko jeden warunek działania na wskaźnik.							
Uwaga 2:	Dane należy wprowadzić dla obrazów „na powierzchni” i „pod powierzchnią” w obu kolumnach dotyczących TIS i TIB.							
Uwaga 3:	Podawanie informacji nie jest konieczne odnośnie do MI i TI dla każdego ZESPOŁU PRZETWORNIKA nieprzeznaczonego do zastosowań przezczaszkowych lub cefalicznych u noworodków.							
Uwaga 4:	Jeśli wymagania 201.12.4.2a są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych danych w kolumnach dotyczących TIS, TIB lub TIC							

Etykieta wskaźnika	MI	Ti		TIB		TIC
		Na powierzchni	Pod powierzchni	Na powierzchni	Pod powierzchni	
Uwaga 5:	Jeśli wymogi 201.12.4.2b są spełnione, nie jest konieczne wprowadzenie danych w kolumnach dotyczących MI.					
Uwaga 6:	Niezacienione komórki powinny mieć przypisaną wartość liczbową. Ustawienie sprężytowanej wskaźnikiem należy wprowadzić w sekcji sterowania operacyjnego.					
Uwaga 7:	Głębokości z p _{ij} oraz z p _{ii} , a dotyczą TRYBÓW NIESKANUJĄCYCH, natomiast głębokości z s _{ii} oraz z s _{ii, a} dotyczą TRYBÓW SKANOWANIA.					
Uwaga 8:	Składnik „1:” odnosi się do trybu B, składnik „2:” odnosi się do Dopplera kolorowego/Dopplera mocy.					

20.7. Niezb dna wydajno

Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 zaprojektowano tak, aby zapewni , e limity akustyczne nie zostan przekroczone w adnym trybie obrazowania. Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 zaprojektowano i certyfikowano pod k tem zgodnie z:

- IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 CSV Medyczne urz dzenia elektryczne – cz 1: wymagania ogólne dotycz ce bezpiecze stwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego.
- IEC 60601-2-37:2007 Medyczne urz dzenia elektryczne – cz 2-37: wymagania szczególowe dotycz ce bezpiecze stwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego ultrad wi kowych medycznych urz dze diagnostycznych i monitoruj cych.

20.8. Dokładno pomiaru

Urz dzenie Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 zostało opracowane pod k tem przeprowadzania nast puj cych pomiarów klinicznych:

Tryb M:

- Pomiaru odległo ci z dokładno ci do $\pm 3\%$ warto ci wy wietlanej.
- Pomiaru czasu z dokładno ci do $\pm 3\%$ warto ci wy wietlanej.
- Pomiaru cz sto ci uderze serca płodu z dokładno ci do $\pm 3\%$ warto ci wy wietlanej.

Tryb B:

- Pomiaru odległo ci (osiowej) z dokładno ci do $\pm 3\%$ warto ci wy wietlanej.
- Pomiaru odległo ci (bocznej) z dokładno ci do $\pm 5\%$ warto ci wy wietlanej.
- Pomiaru odległo ci (przek tnej) z dokładno ci do $\pm 4\%$ warto ci wy wietlanej.
- Pomiaru odległo ci (obwodu) z dokładno ci do $\pm 5\%$ warto ci wy wietlanej.
- Pomiaru pola z dokładno ci do $\pm 10\%$ warto ci wy wietlanej.

Widmo Dopplera:

- Pr dko wzgl dna przepływu i kierunek z dokładno ci do $\pm 20\%$ warto ci wy wietlanej.

20.9. Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny

Przekre lony symbol kosza na kólkach umieszczony na tym urz dzeniu oznacza, e ten sprz t został wprowadzony na rynek po 13. sierpnia 2005 r. i jest obj ty dyrektyw 2002/96/WE dotycz c zu ytego sprz tu elektrycznego i elektrycznego (WEEE), a tak e krajowymi rozporz dzeniami, które transponuj postanowienia tej dyrektywy. Po upływie okresu eksploatacji nie mo na niniejszego urz dzenia usuwa wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi; urz dzenie musi by oddane osobno do specjalnie wyznaczonego zakładu unieszkodliwiania odpadów. W przypadku konieczno ci uzyskania pomocy przy recyklingu skontaktowa si z producentem lub autoryzowan firm zajmuj c si utylizacj odpadów.



20.10. Recykling i usuwanie

Butterfly podejmuje działania na rzecz ochrony rodowiska naturalnego. Sprz t mo e zawiera materiały, które stwarzaj zagro enie dla rodowiska, je li nie s przestrzegane odpowiednie procedury ich utylizacji. Głowic

i akcesoria systemu Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 należy poddać recyklingowi po upływie ich zwykłego okresu eksploatacji zgodnie z przepisami lokalnymi, wojewódzkimi i/lub krajowymi.

Przed oddaniem do recyklingu poszczególne elementy powinny być czyste i zdezynfekowane.









21. Symbole















Niniejszy rozdział wymienia oraz opisuje symbole i ikony używane w aplikacji Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3, akcesoria systemu i opakowanie.









21.1. Symbole









Tabela 52, „Symbole” [149] zawiera listę i opis zestawu symboli medycznych urządzeń elektrycznych, które klasyfikują po ostrzeżeniu lub ostrzeżeniu o możliwych niebezpieczeństwach. Symbole wymienione w Tabeli 52, „Symbole” [149] mogą znajdować się na systemie Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3 i jego akcesoriach oraz opakowaniu. Symbole użyte w niniejszym dokumencie, na systemie Butterfly iQ/ iQ+/ iQ3, jego akcesoriach i opakowaniu są zgodne z aktualnymi wersjami podanych norm.

Tabela 52. Symbole

Symbol	Norma	Nr referencyjny	Tytuł	Opis
	ISO 15223-1	5.4.4	Przeostroga	Wskazuje konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi w celu uzyskania ważnych informacji ostrzegawczych, takich jak ostrzeżenia i środki ostrożności, z różnych powodów, nie mogą zostać umieszczone na urządzeniu medycznym.
	ISO 7010	W001	Ostrzeżenie	Oznacza ogólne ostrzeżenie.
	ASTM F2503-1	F2503 - 13 3.1.14	MR Unsafe	Wskazuje element, który stwarza niedopuszczalne ryzyko dla pacjenta, personelu medycznego lub innych osób w środowisku rezonansu magnetycznego.
	ISO 15223-1	5.2.8	Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone	Wskazuje urządzenie medyczne, które nie powinno być używane, jeżeli opakowanie zostało uszkodzone lub otwarte.
	ISO 15223-1	5.1.3	Data produkcji	Wskazuje datę produkcji urządzenia medycznego.
	ISO 15223-1	5.3.1	Kruche; ostrożnie	Wskazuje urządzenie medyczne, które może zostać uszkodzone w przypadku niezachowania ostrożności.
	-	-	Kod wg Globalnej Nomenklatury Wyrobów Medycznych (GMDN)	System wewnętrznie uzgodnionych opisów ogólnych słów do identyfikacji wszystkich produktów będących urządzeniami medycznymi.
	-	-	Globalny Numer Jednostki Handlowej	Identyfikator umożliwiający znalezienie informacji o produkcie w bazie danych, czynniki przez wprowadzenie numeru za pomocą skanera kodów kreskowych skierowanego na dany produkt.

Symbol	Norma	Nr referencyjny	Tytuł	Opis
	IEC 60529	-	Klasyfikacja ochrony przed wnikaniem	System klasyfikacji ochrony przedstawia cy stopnie ochrony przed wnikaniem ciał stałych i cieczy. Urz dzenie Butterfly iQ/ iQ+ jest wyposażone w zabezpieczenie przed skutkami zanurzenia w wodzie poni ej dopuszczalnego poziomu oznaczonego na kablu/głowicy, jak pokazano na rysunku.
	IEC 60529	-	Klasyfikacja ochrony przed wnikaniem	Stopie ochrony przed ciałami stałymi i cieczami. Butterfly iQ3 zapewnia wodoodporno , a całe urz dzenie mo e by w pełni zanurzone w wodzie o gł boko ci 1 metra przez maksymalnie 30 minut; po tym czasie nadal mo e działa prawidłowo.
	IEC 60601-1	20	Cz wchodzący w kontakt z ciałem pacjenta typu BF	Wskazuje izolowane połączenie z ciałem pacjenta (cz wchodzący w kontakt z ciałem pacjenta typu BF).
	ISO 15223-1	5.3.4	Chroni przed deszczem	Wskazuje urz dzenie medyczne, które nale y chroni przed wilgoci .
	ISO 15223-1	5.1.1	Producent	Wskazuje producenta urz dzenia medycznego, zgodnie z definicj w dyrektywach UE 90/385/ EWG, 93/42/EWG i 98/79/WE.
	ISO 15223-1	5.1.11	Kraj produkcji	Identyfikacja kraju produkcji produktów.
	ISO 15223-1	5.1.5	Kod partii	Wskazuje kod partii producenta umo liwiaj cy identyfikacj partii.
	-	-	Nazwa modelu	Nazwa modelu urz dzenia.
	ISO 15223-1	5.2.7	Niesterylne	Wskazuje urz dzenie medyczne, które nie było poddawane sterylizacji.
	ISO 7010	M002	Patrz instrukcja obsługi/broszura	Oznacza to, e nale y przeczyta instrukcj obsługi/broszur
	ISO 15223-1	5.4.3	Instrukcja operatora; instrukcja obsługi	Wskazuje konieczno odniesienia si do instrukcji obsługi.
	ISO 7000	1135	Symbol ogólny odzyskiwania/ przetwarzania	Oznacza, e oznaczony element albo jego materiały s cz ci procesu odzyskiwania lub przetwarzania.
	ISO 15223-1	5.1.6	Numer katalogowy	Wskazuje numer katalogowy stosowany przez producenta umo liwiaj cy identyfikacj urz dzenia medycznego.
	ISO 15223-1	5.1.7	Numer seryjny	Wskazuje numer seryjny stosowany przez producenta umo liwiaj cy identyfikacj urz dzenia medycznego.

Symbol	Norma	Nr referencyjny	Tytuł	Opis
	ISO 15223-1	5.3.2	Chroni przed wiatłem słonecznym	Wskazuje urządzenie medyczne, które należy chronić przed promieniami słonecznymi.
	WEEE Directive 2012/19/EU	-	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	Wymaga osobnego zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z dyrektywą dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Jeżeli stosowany jest symbol Pb lub Hg, elementy urządzenia mogą odpowiednio zawierać ołów lub rtęć, które muszą zostać poddane recyklingowi lub utylizacji zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi lub federalnymi. Szklanki podświetlające monitory LCD mogą zawierać rtęć.
	Rozporządzenie (UE) nr 2017/745	-	Zgodno z normami europejskimi	Głowica Butterfly iQ+/iQ3 spełnia wymagania rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (UE MDR).
	MD 93/42/EEC	-	Zgodno z normami europejskimi	Butterfly iQ spełnia wymagania europejskiej dyrektywy w sprawie wyrobów medycznych.
	-	-	Certyfikacja w USA i Kanadzie	TÜV Rheinland of North America posiada uprawnienia jako krajowe laboratorium badawcze (NRTL) uznawane przez OSHA (Urząd ds. bezpieczeństwa i higieny pracy) w Stanach Zjednoczonych oraz jako jednostka certyfikująca produkty uznawana przez SCC (Kanadyjski Rad ds. Norm) w Kanadzie. Oznaczenie to świadczy o zgodności z przepisami i wymogami Krajowego Kodeksu Elektrycznego, OSHA i SCC.
	Resolution 92/98	-	Argentine Standardization and Certification Institute	Oznaczenie certyfikacji urządzeń elektrycznych na rynek argentyński.
	ISO 15223-1	5.1.2	Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej	Autoryzowany przedstawiciel w Europie: Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem The Netherlands Sponsor australijski: Emergo Australia Level 20, Tower II Darling Park 201 Sussex Street Sydney, NSW 2000 Australia
	ISO 15223-1	5.1.2	Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii	MedEnvoy Switzerland Gotthardstrasse 28 6302 Zug Szwajcaria

Symbol	Norma	Nr referencyjny	Tytuł	Opis
	EUMDR 2017/745 ISO 15223-1:2021	Annex VI, Part C	Informacje, które należy przedłożyć przy rejestracji urządzeń i podmiotów gospodarczych: system UDI	Wskazuje, że Basic UDI-DI jest podstawowym identyfikatorem modelu urządzenia. Jest to identyfikator urządzenia przypisany na poziomie jednostki użytkowej urządzenia. Stanowi on główny klucz dla rekordów w bazie danych UDI i jest wymieniany w odpowiednich certyfikatach i deklaracjach zgodnie z UE.
	EUMDR 2017/745 ISO 15223-1:2021	Annex I, GSPR 23.2	Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności do etykietowania	Wskazuje, że produkt jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny.
	ISO 15223-1	5.3.7	Limit temperatury	Wskazuje limity temperatury, na które urządzenie medyczne może być bezpiecznie narażone.
	ISO 15223-1	5.3.8	Ograniczenie w zakresie wilgotności	Wskazuje zakres wilgotności, na które urządzenie medyczne może być bezpiecznie narażone.
	ISO 15223-1	5.3.9	Ograniczenie w zakresie ciśnienia atmosferycznego	Wskazuje zakres ciśnienia atmosferycznego, na które urządzenie medyczne może być bezpiecznie narażone.
Tylko Rx	FDA 21 CFR cz. 801.109	-	Urządzenia na recept	Wskazuje, że urządzenie ma być używane pod nadzorem lekarza uprawnionego przez prawo do kierowania użyciem takiego urządzenia. Uwaga: prawo federalne ogranicza sprzedaż tego urządzenia przez lub na zlecenie lekarza lub z opisowym oznaczeniem dowolnego innego lekarza licencjonowanego przez prawo stanu, w którym lekarz praktykuje, do używania lub zlecenia używania tego urządzenia.
	ISO 15223-1:2021	5.1.8	Importer	Wskazuje podmiot importujący wyrób medyczny do danej lokalizacji.
	Przepisy dotyczące ochrony przed promieniowaniem (promieniowanie niejonizujące) obowiązujące w Singapurze	Cz. VIII Aparatura ultrasonograficzna, sekcja 29	Uwaga: ultrasonografia	Oznacza ostrzeżenie o promieniowaniu wymagane w przypadku aparatów ultrasonograficznych na rynku singapurskim.
	Program samodzielnego etykietowania (SLP) certyfikowanych urządzeń komunikacyjnych, multimedialnych i hybrydowych w Malezji	-	Znak certyfikacyjny MCMC	Znak certyfikacyjny oznacza, że sprzęt komunikacyjny, multimedialny i hybrydowy został dopuszczony przez wyznaczoną agencję certyfikującą (SIRIM QAS International) jako zgodny z kodami technicznymi / specyfikacjami technicznymi / normami technicznymi / technicznym listem kontrolnym / deklaracją techniczną, wymaganiami certyfikacyjnymi oraz ustawami i rozporządzeniami mającymi zastosowanie do certyfikowanego sprzętu. Znak certyfikacyjny jest powiązany z unikalnym identyfikatorem posiadacza certyfikatu lub zleceniodawcy, wydanym przez SIRIM QAS International w Malezji.

22. Uwagi